


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/09/2025 - 12/10/2025
Dias de utilização	5/30 dias (17%)	
>= 4 horas	5 dias (17%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	27 horas 37 minutos	
Utilização média (total de dias)	55 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 48 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 12/10/2025)	946 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22161609906
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	11 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.7	Percentil 95.º: 10.6	Máximo: 10.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.5	Percentil 95.º: 12.2	Máximo: 22.3	
Eventos por hora	IA: 0.6	IH: 0.3	IAH: 0.9	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

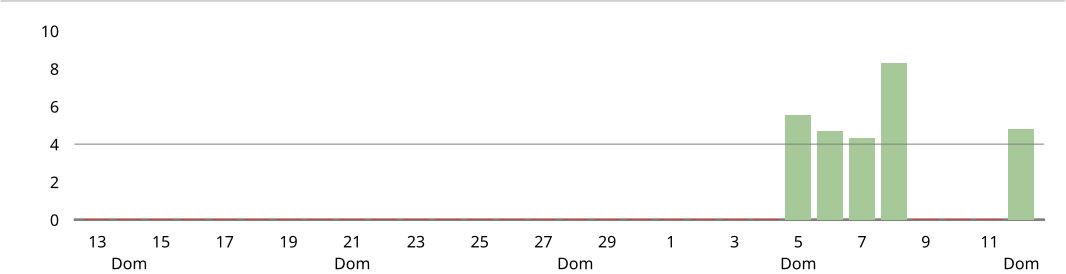


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22161609906


Utilização (horas)

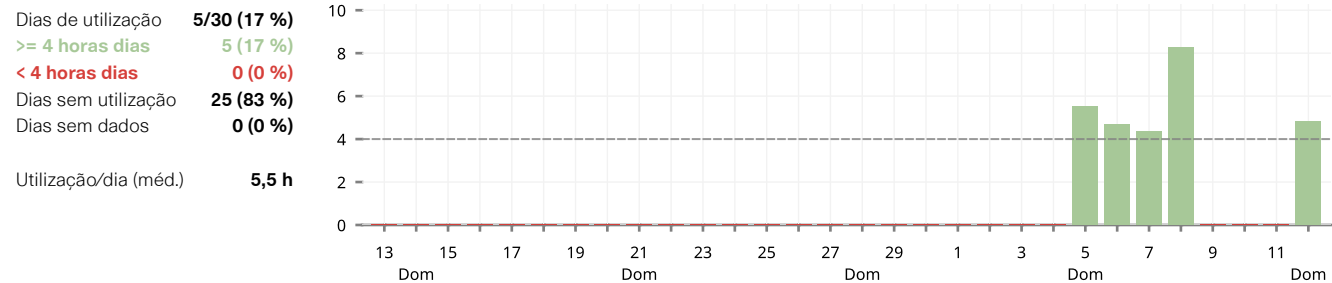

Fuga (l/min)

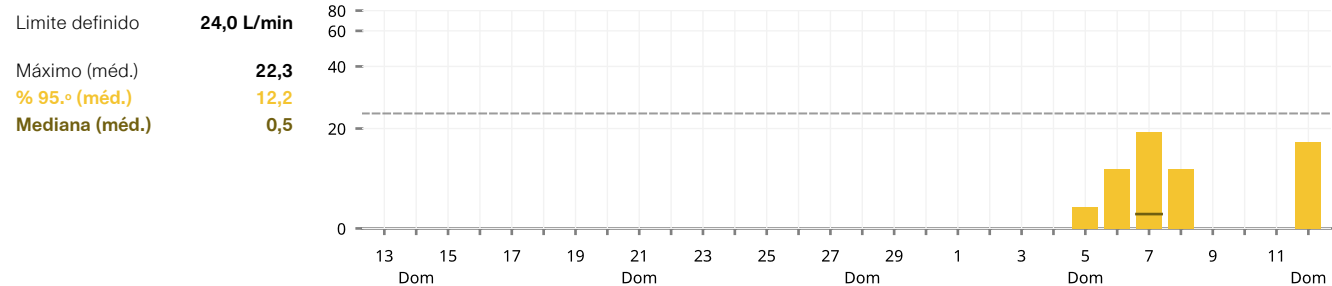

Pressão (cmH2O)

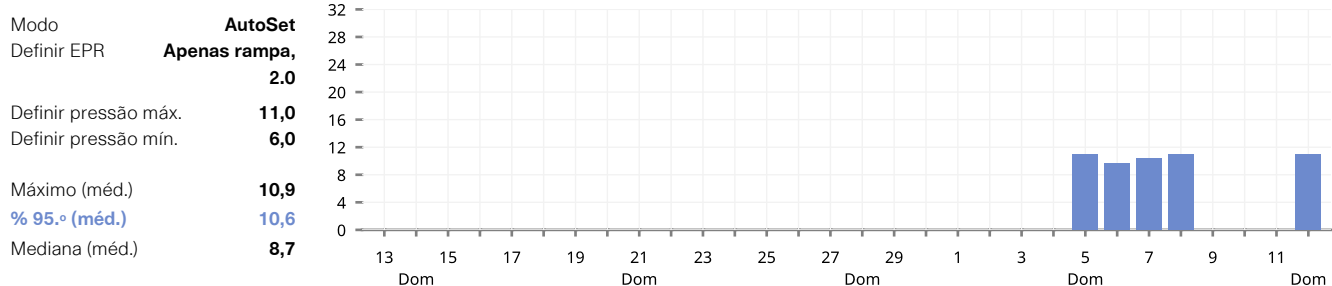

IAH (eventos/hora)

