


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 28/12/2025 - 26/01/2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 29/30 dias (97%)    |                         |
| >= 4 horas                                                   | 28 dias (93%)       |                         |
| < 4 horas                                                    | 1 dias (3%)         |                         |
| Horas de utilização                                          | 173 horas 4 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 5 horas 46 minutos  |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 5 horas 58 minutos  |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 6 horas 12 minutos  |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 26/01/2026) | 6,678 horas         |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22221799962  |
| Modo                | AutoSet      |
| Pressão mín.        | 8 cmH2O      |
| Pressão máx.        | 10 cmH2O     |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 2            |
| Resposta            | Padrão       |

| Terapia                                            |          |     |                 |      |                |      |
|----------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|------|----------------|------|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: | 9.8 | Percentil 95.º: | 10.0 | Máximo:        | 10.0 |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: | 1.9 | Percentil 95.º: | 25.1 | Máximo:        | 33.4 |
| Eventos por hora                                   | IA:      | 0.6 | IH:             | 0.1  | IAH:           | 0.7  |
| Índice de apneia                                   | Central: | 0.0 | Obstrutiva:     | 0.5  | Desconhecid    | 0.0  |
| Índice RERA                                        |          |     |                 |      |                | 0.8  |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) |          |     |                 |      | 0 minutos (0%) |      |

## Horas de utilização

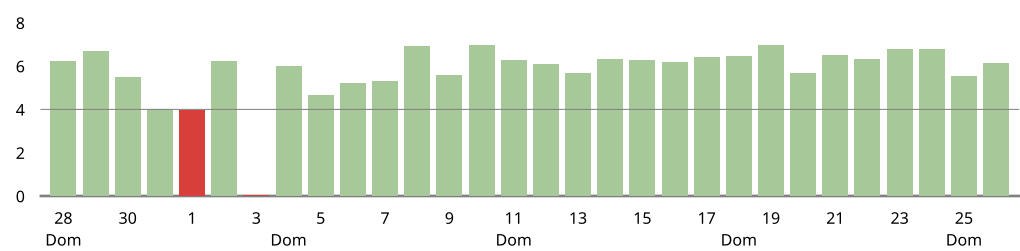

# Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22221799962

## Utilização (horas)

Dias de utilização **29/30 (97 %)**

>= 4 horas dias

28 (93 %)


< 4 horas dias

1 (3 %)

Dias sem utilização **1 (3 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **6,0 h**

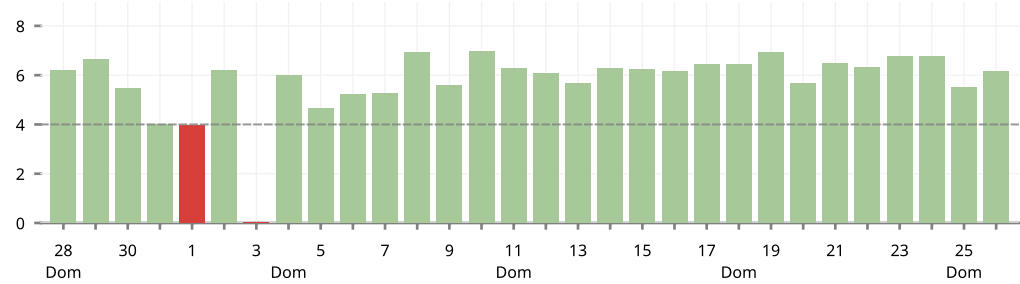

## Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **33,4**

% 95.º (méd.)

25,1

Mediana (méd.) **1,9**

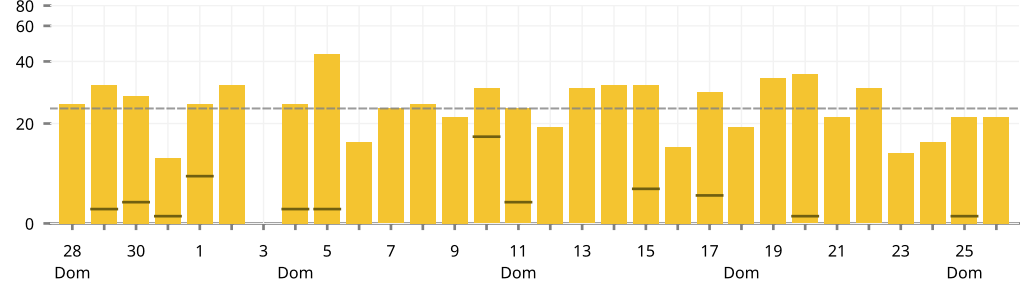

## Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**

Definir EPR **Apenas rampa, 2.0**

Definir pressão máx. **10,0**


Definir pressão mín. **8,0**

Máximo (méd.) **10,0**

% 95.º (méd.)

10,0

Mediana (méd.) **9,8**

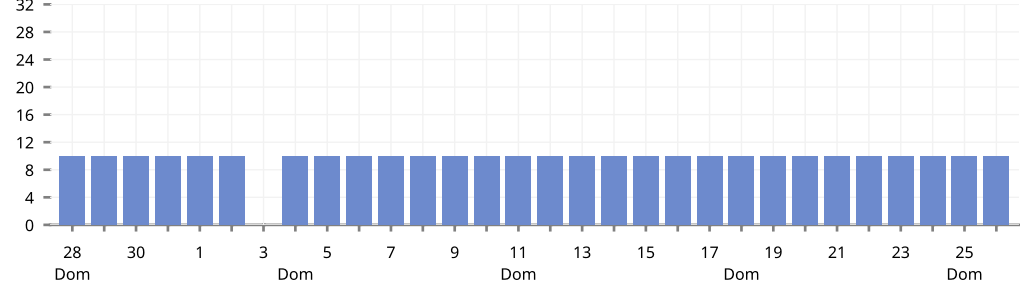

## IAH (eventos/hora)

IAH

□

0.7

IH

■

0.1

IA

■

0.6

IAC

0,0

IAO

0,5

IAD

0,0

RERA

0,8

%RCS (méd.)

0,0

