

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

29/03/2026 - 27/04/2026

Dias de utilização		30/30 dias (100%)	
>= 4 horas		30 dias (100%)	
< 4 horas		0 dias (0%)	
Horas de utilização		190 horas 39 minutos	
Utilização média (total de dias)		6 horas 21 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 21 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 29 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/04/2026)		7,226 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22221799962	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		8 cmH2O	
Pressão máx.		10 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		2	
Resposta		Padrão	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 9.8	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0
Fugas — l/min	Mediana: 2.9	Percentil 95.º: 27.0	Máximo: 32.2
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.1	IAH: 0.4
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.5		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização

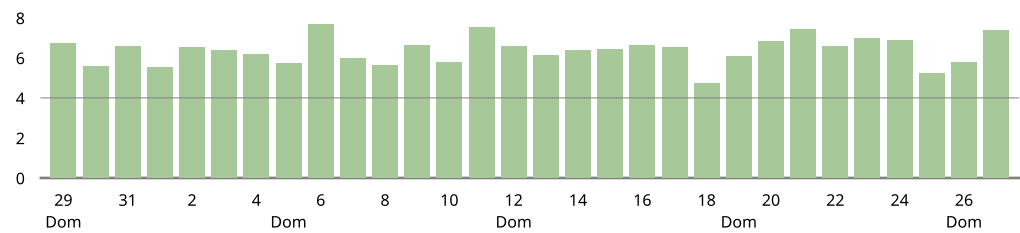


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221799962


Utilização (horas)

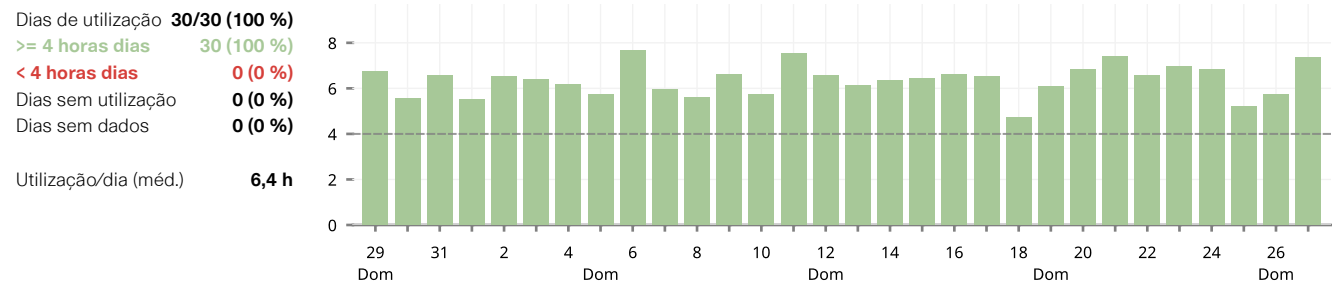

Fuga (l/min)

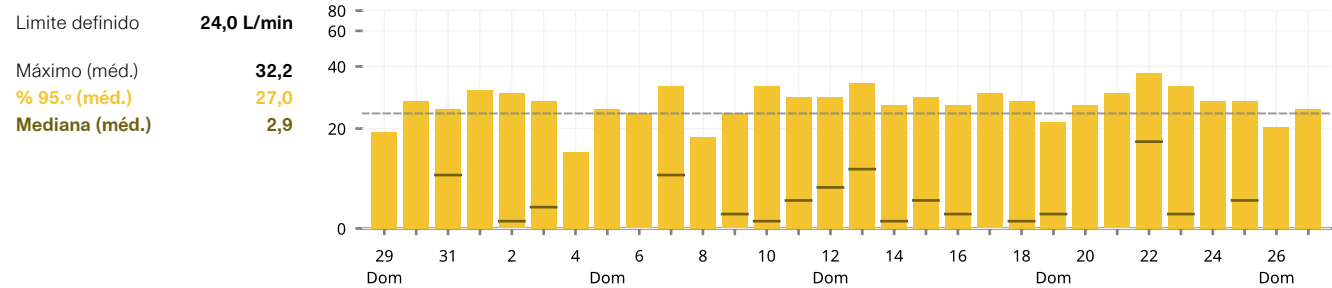

Pressão (cmH2O)

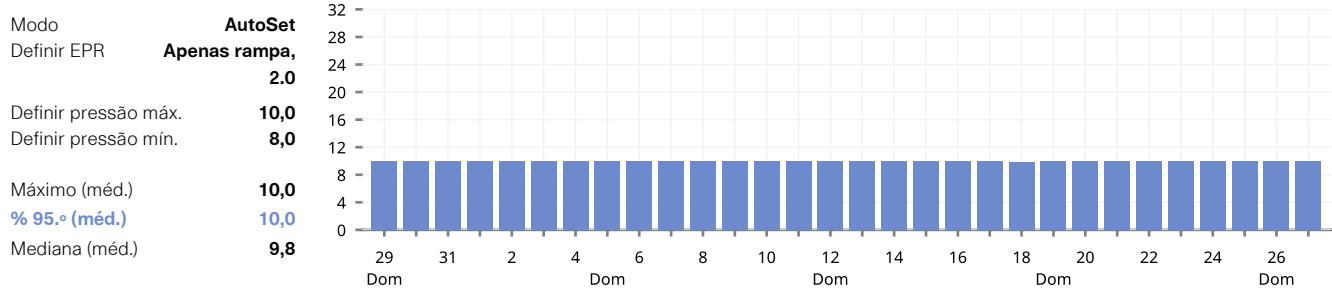

IAH (eventos/hora)

