


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/10/2025 - 26/10/2025
Dias de utilização		14/17 dias (82%)
>= 4 horas		14 dias (82%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		110 horas 3 minutos
Utilização média (total de dias)		6 horas 28 minutos
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 52 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 54 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/10/2025)		4,470 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211840650
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.1	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 2.0	Percentil 95.º: 19.0	Máximo: 28.0	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.1	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.6
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

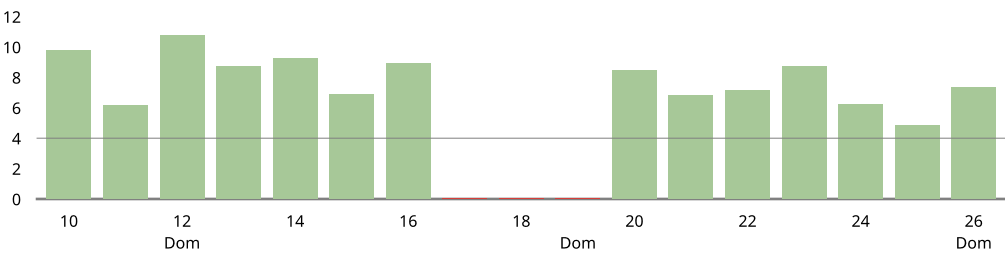


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211840650


Utilização (horas)

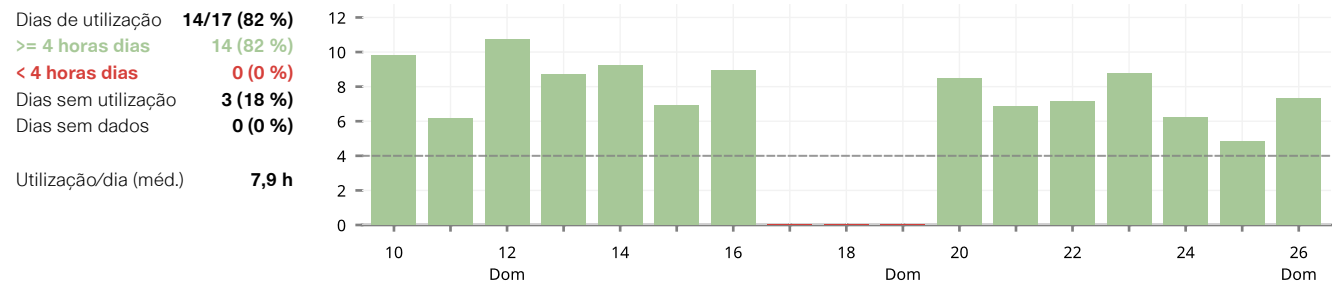

Fuga (l/min)

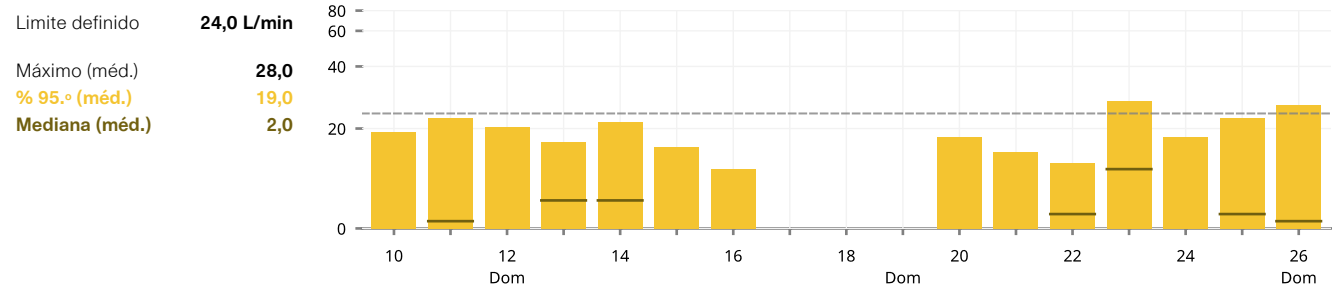

Pressão (cmH2O)

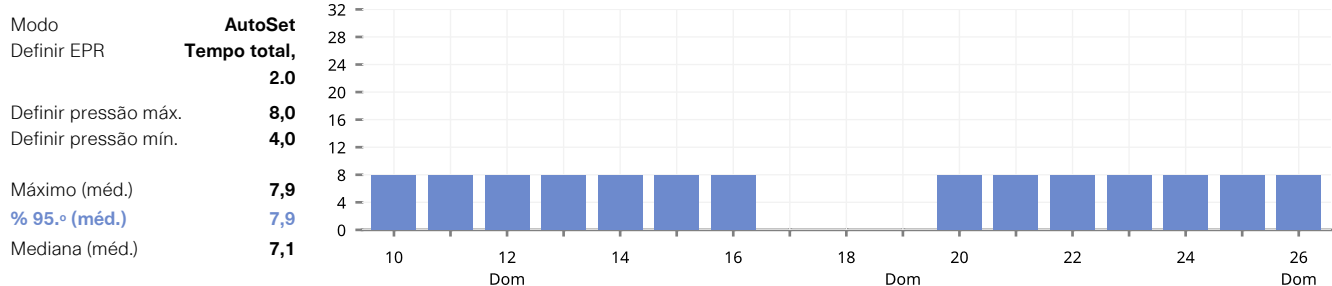

IAH (eventos/hora)

