


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/09/2025 - 14/10/2025
Dias de utilização	20/30 dias (67%)	
>= 4 horas	15 dias (50%)	
< 4 horas	5 dias (17%)	
Horas de utilização	98 horas 27 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 17 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 55 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 29 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/10/2025)	2,859 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024703
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.4	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 6.2	Percentil 95.º: 22.9	Máximo: 42.9	
Eventos por hora	IA: 2.0	IH: 0.9	IAH: 2.9	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 1.7	Desconhecid	0.2
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

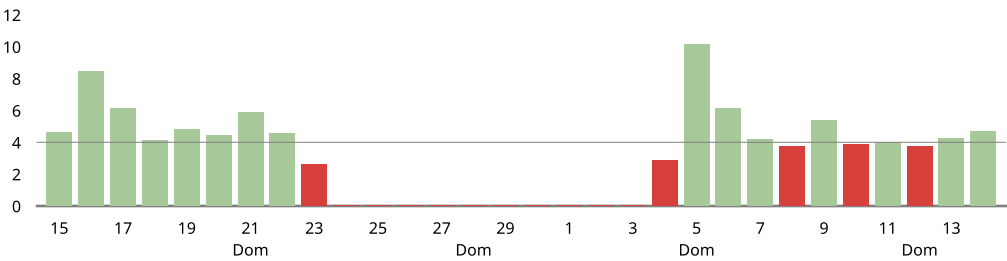


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024703


Utilização (horas)

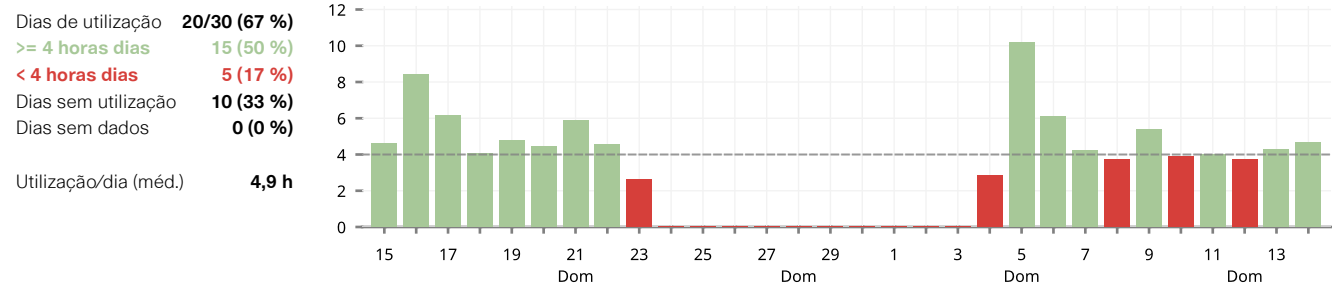

Fuga (l/min)

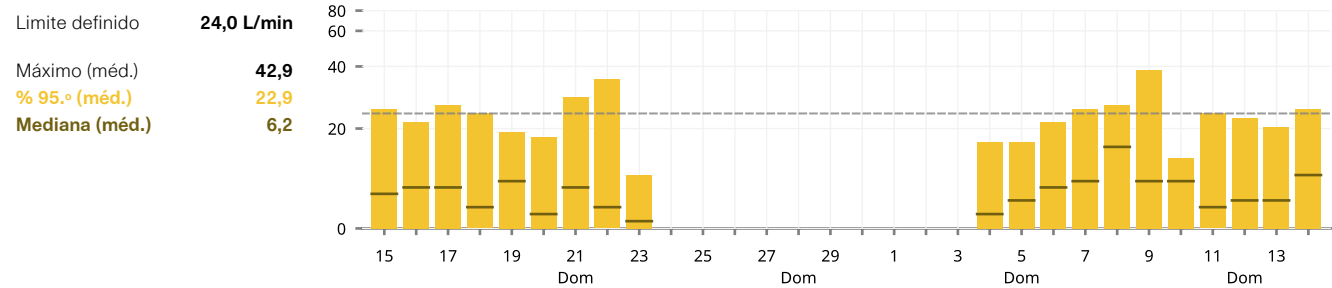

Pressão (cmH2O)

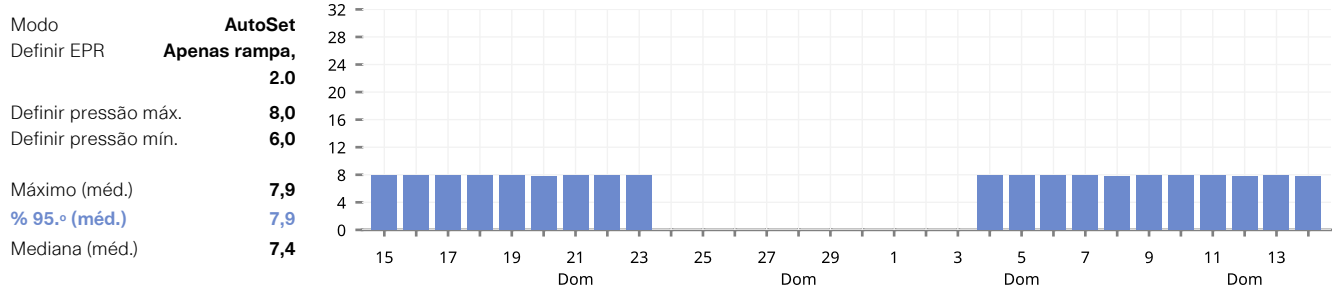

IAH (eventos/hora)

