


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/10/2025 - 19/10/2025
Dias de utilização	6/7 dias (86%)	
>= 4 horas	1 dias (14%)	
< 4 horas	5 dias (71%)	
Horas de utilização	12 horas 54 minutos	
Utilização média (total de dias)	1 horas 51 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	2 horas 9 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	1 horas 39 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/10/2025)	1,996 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653863
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 4.6	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 8.5	
Fugas — l/min	Mediana: 0.2	Percentil 95.º: 5.6	Máximo: 24.0	
Eventos por hora	IA: 11.7	IH: 0.6	IAH: 12.3	
Índice de apneia	Central: 7.8	Obstrutiva: 3.8	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

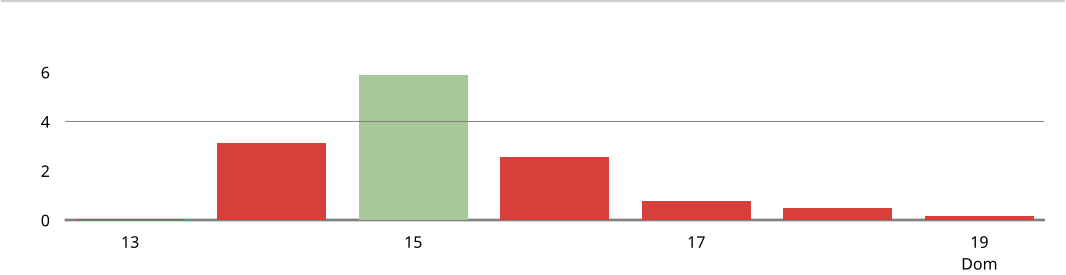


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653863


Utilização (horas)

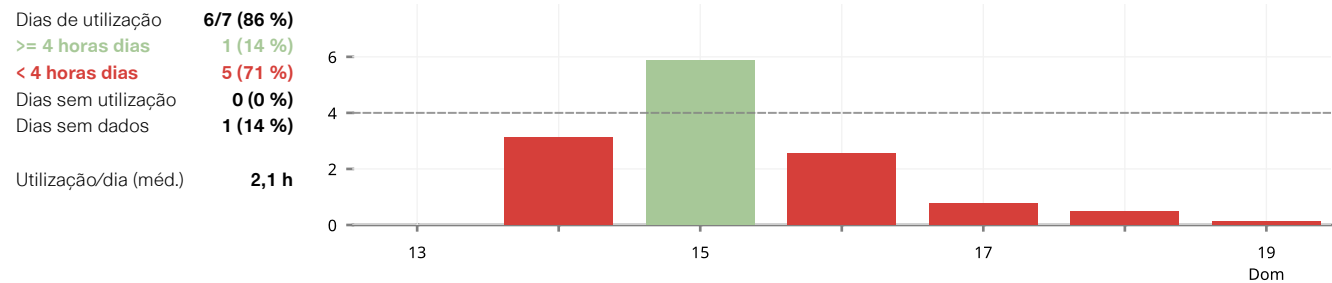

Fuga (l/min)

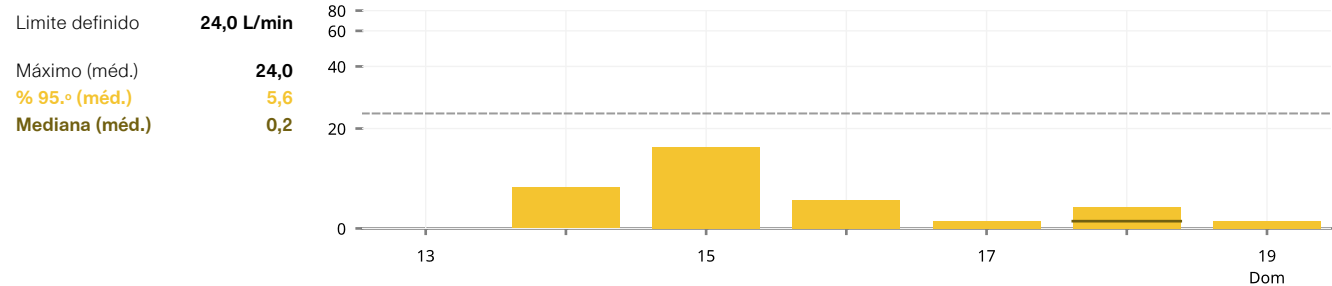

Pressão (cmH2O)

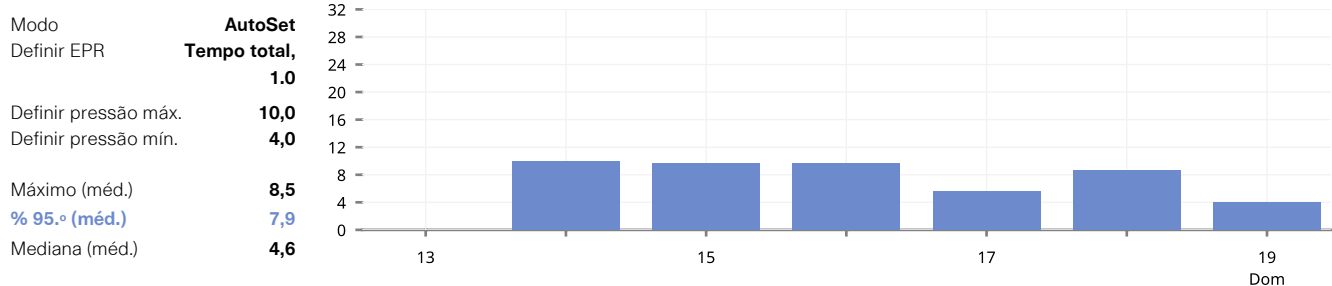

IAH (eventos/hora)

