


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/02/2026 - 04/03/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	13 dias (43%)	
< 4 horas	17 dias (57%)	
Horas de utilização	127 horas 15 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 15 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 15 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	3 horas 35 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/03/2026)	2,179 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882369
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.3	Percentil 95.º: 6.9	Máximo: 7.0	
Fugas — l/min	Mediana: 5.4	Percentil 95.º: 20.2	Máximo: 27.5	
Eventos por hora	IA: 1.9	IH: 1.6	IAH: 3.5	
Índice de apneia	Central: 1.4	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

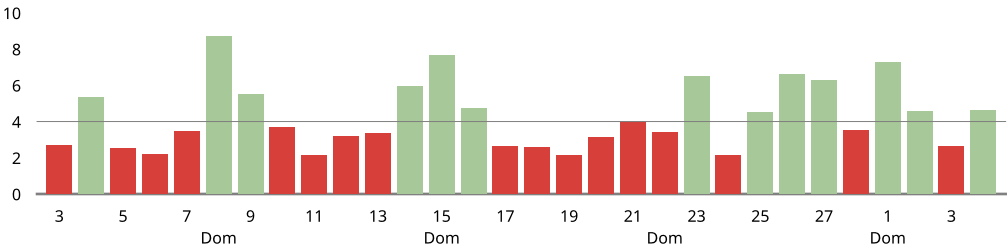


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882369


Utilização (horas)

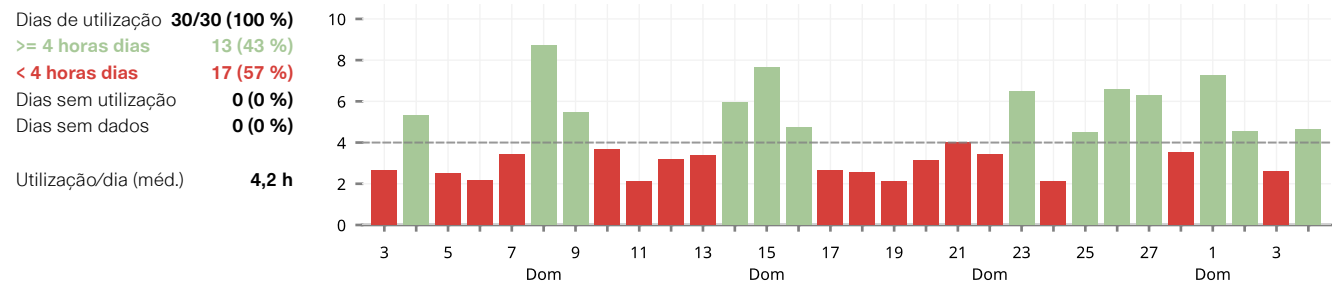

Fuga (l/min)

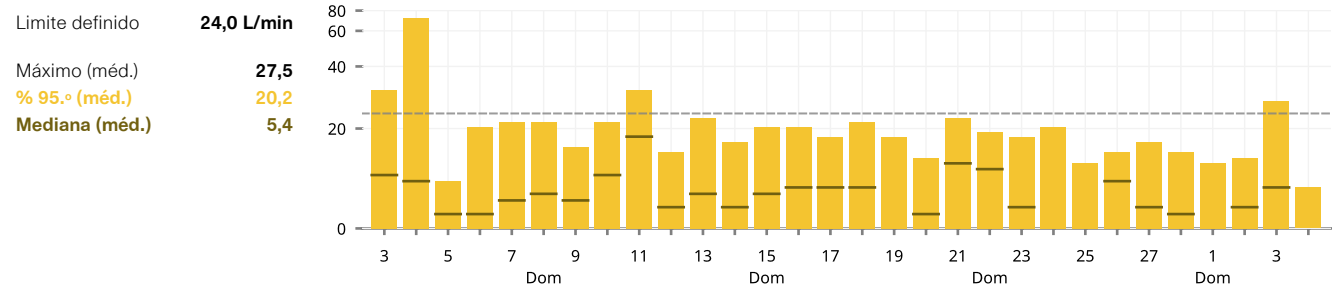

Pressão (cmH2O)

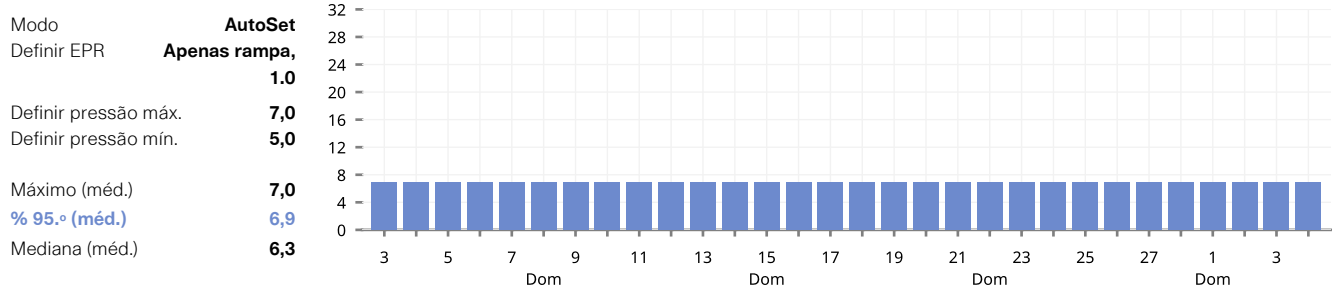

IAH (eventos/hora)

