


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/12/2025 - 20/01/2026	
Dias de utilização		30/30 dias (100%)	
>= 4 horas		19 dias (63%)	
< 4 horas		11 dias (37%)	
Horas de utilização		142 horas 1 minutos	
Utilização média (total de dias)		4 horas 44 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 44 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		4 horas 45 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 20/01/2026)		1,991 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22232882369	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		5 cmH2O	
Pressão máx.		7 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Padrão	
Terapia			
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.0	Percentil 95.º: 6.8	Máximo: 6.9
Fugas — l/min	Mediana: 11.6	Percentil 95.º: 26.7	Máximo: 37.5
Eventos por hora	IA: 2.0	IH: 1.7	IAH: 3.7
Índice de apneia	Central: 1.3	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid 0.4
Índice RERA	0.5		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)			0 minutos (0%)

Horas de utilização

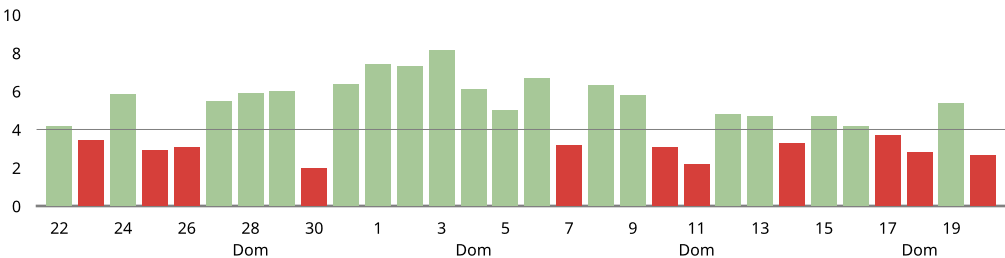


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882369


Utilização (horas)

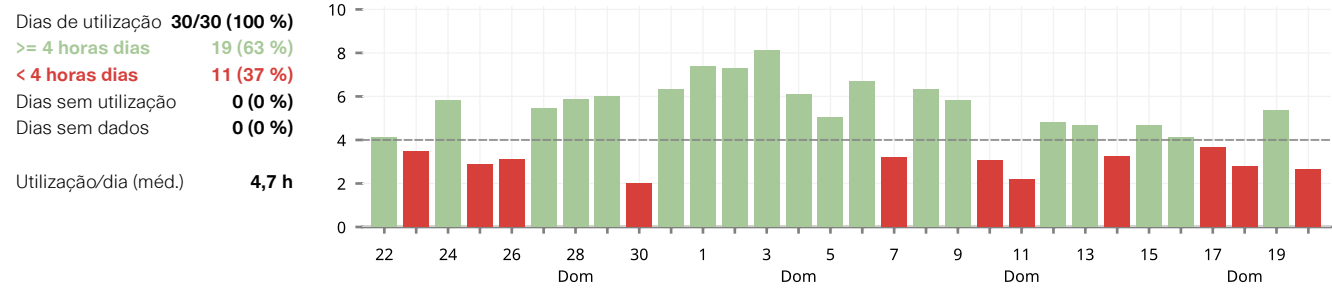

Fuga (l/min)

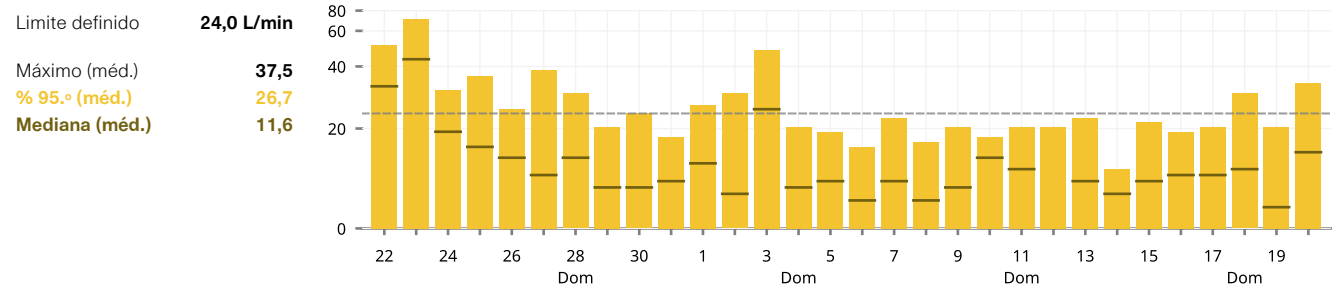

Pressão (cmH2O)

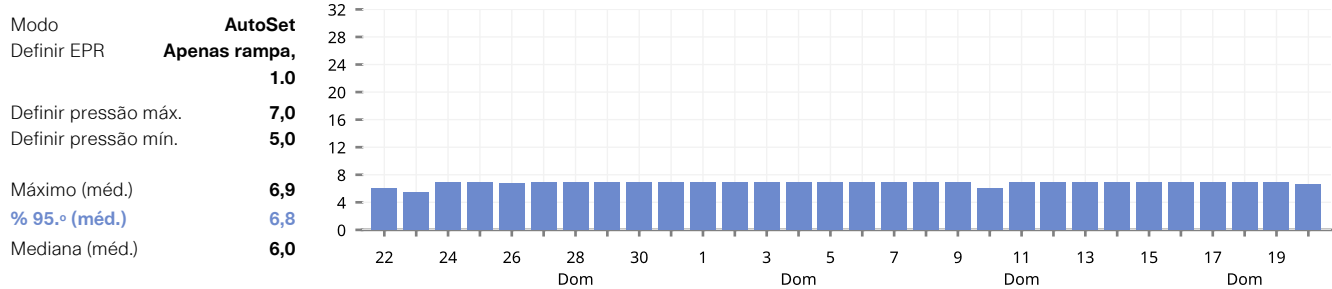

IAH (eventos/hora)

