


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 16/10/2025 - 22/10/2025 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 7/7 dias (100%)     |                         |
| >= 4 horas                                                   | 7 dias (100%)       |                         |
| < 4 horas                                                    | 0 dias (0%)         |                         |
| Horas de utilização                                          | 52 horas 29 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 7 horas 30 minutos  |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 7 horas 30 minutos  |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 7 horas 10 minutos  |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 22/10/2025) | 301 horas           |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22242260594  |
| Modo                | AutoSet      |
| Pressão mín.        | 5 cmH2O      |
| Pressão máx.        | 10 cmH2O     |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 1            |
| Resposta            | Suave        |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: 8.5   | Percentil 95.º: 10.0 | Máximo: 10.0 |     |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 0.3   | Percentil 95.º: 12.2 | Máximo: 30.0 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 4.5        | IH: 0.6              | IAH: 5.1     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 3.2   | Obstrutiva: 1.2      | Desconhecid  | 0.1 |
| Índice RERA                                        | 0.3            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

## Horas de utilização

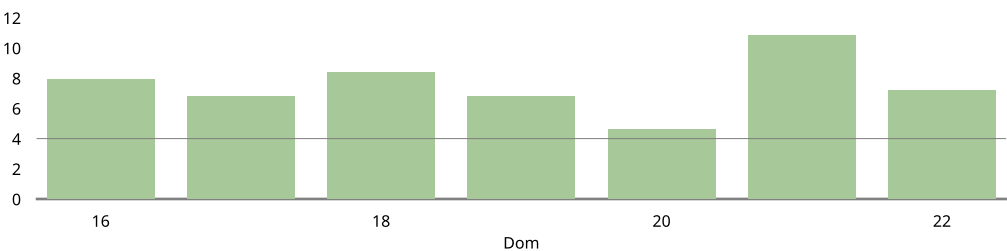


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260594


## Utilização (horas)

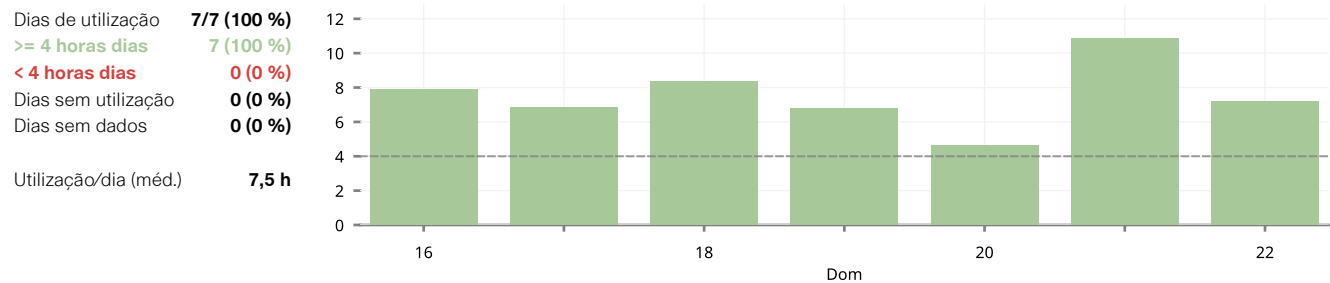

## Fuga (l/min)

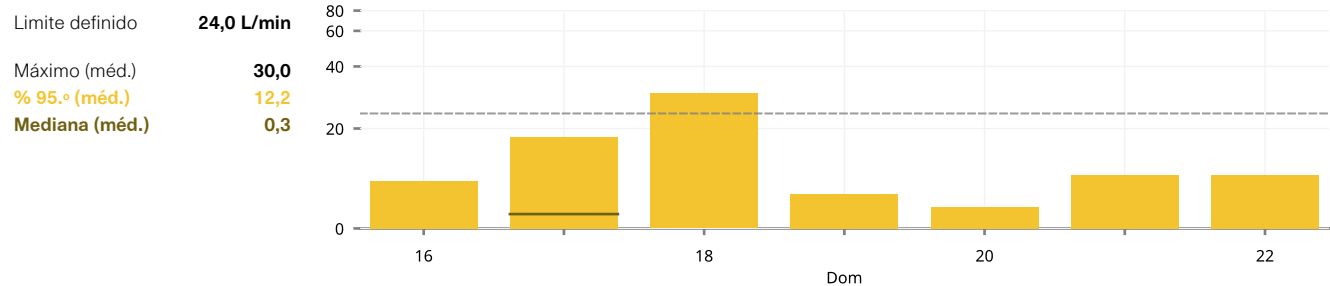

## Pressão (cmH2O)

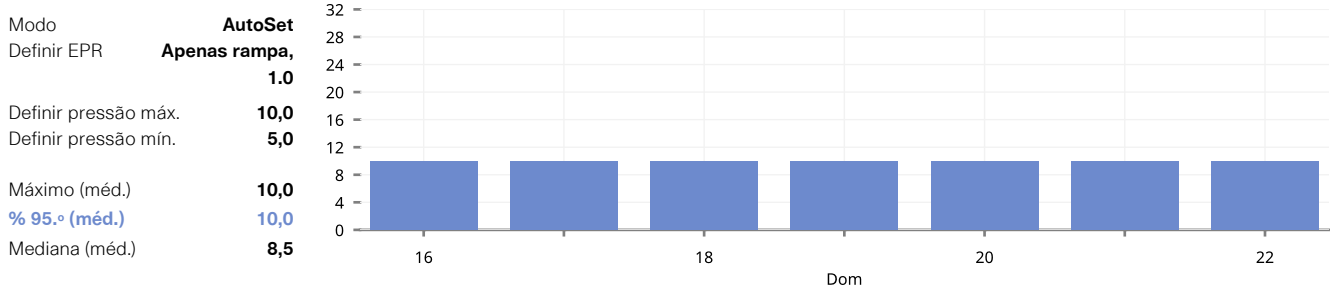

## IAH (eventos/hora)

