


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/10/2025 - 27/10/2025
Dias de utilização	12/12 dias (100%)	
>= 4 horas	10 dias (83%)	
< 4 horas	2 dias (17%)	
Horas de utilização	57 horas 19 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 47 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 47 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 34 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/10/2025)	1,105 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882307
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.6	Percentil 95.º: 10.4	Máximo: 11.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 10.5	Máximo: 32.9	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.3	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

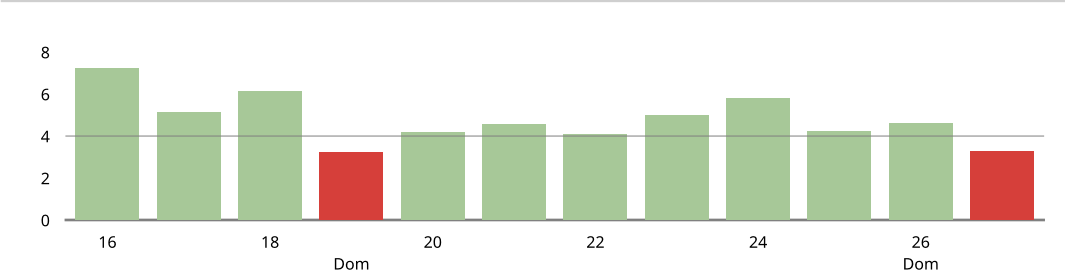


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882307


Utilização (horas)

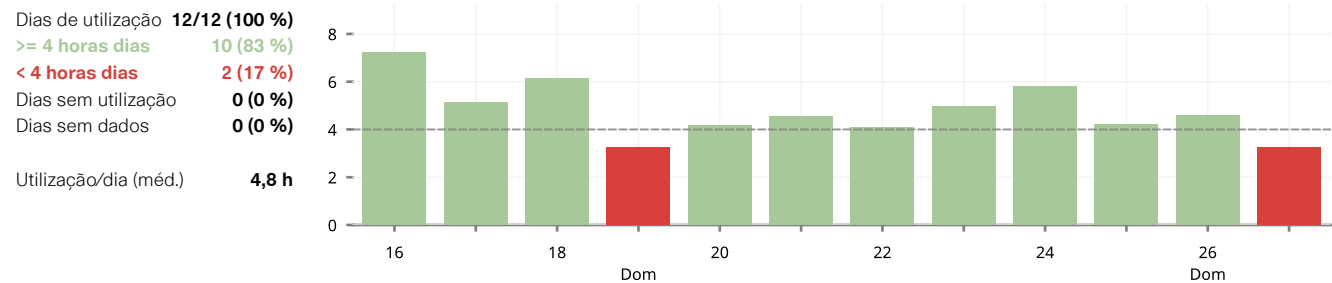

Fuga (l/min)

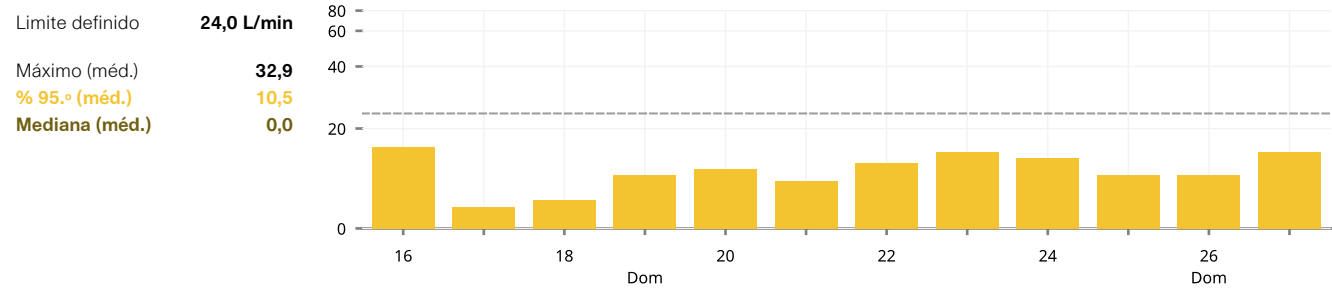

Pressão (cmH2O)

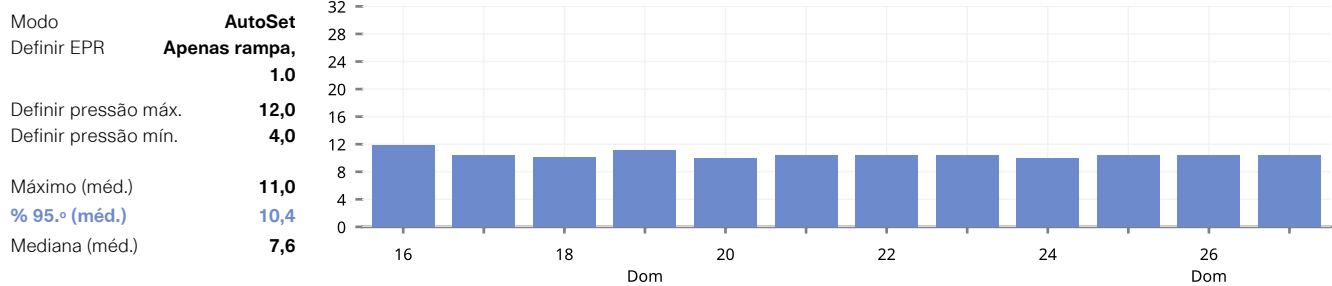

IAH (eventos/hora)

