


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/10/2025 - 21/10/2025
Dias de utilização	5/5 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	40 horas 4 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 1 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 1 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 31 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/10/2025)	2,960 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22191678992
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.8	Percentil 95.º: 9.9	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 12.2	Máximo: 25.0	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.2	IAH: 0.5	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

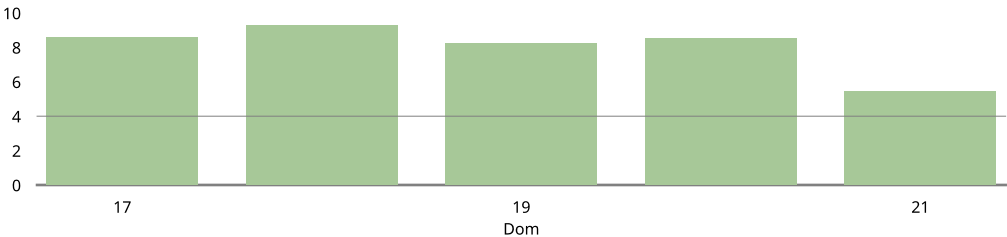


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22191678992


Utilização (horas)

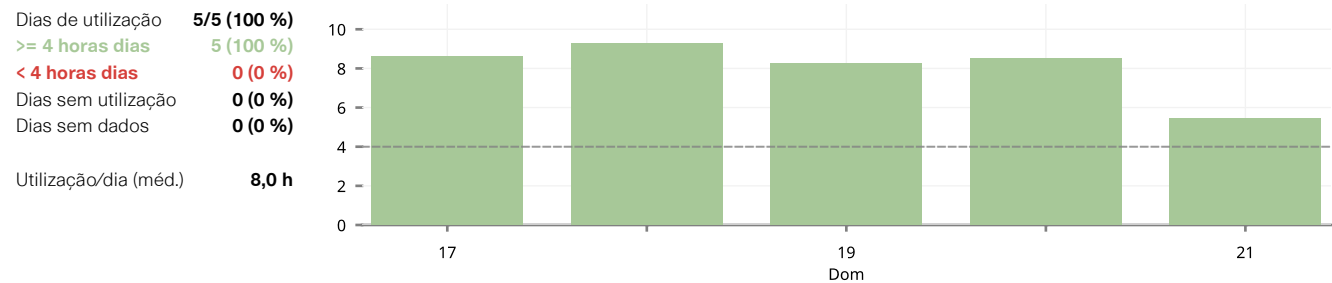

Fuga (l/min)

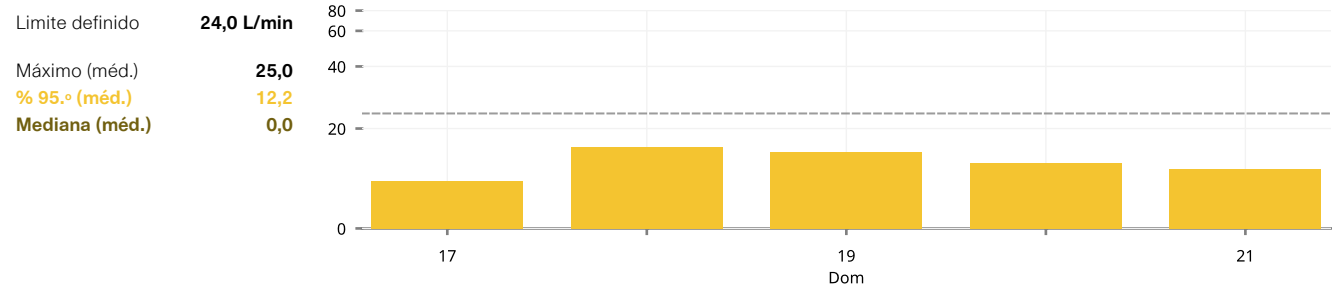

Pressão (cmH2O)

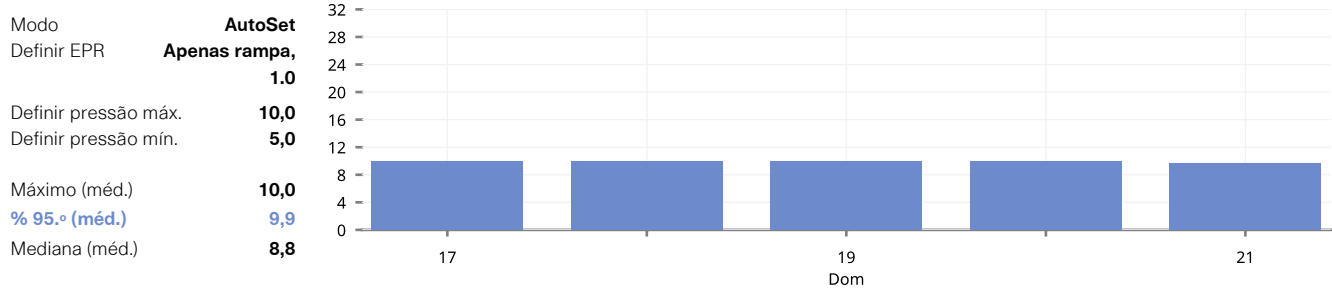

IAH (eventos/hora)

