


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/07/2025 - 03/08/2025
Dias de utilização	16/18 dias (89%)	
>= 4 horas	14 dias (78%)	
< 4 horas	2 dias (11%)	
Horas de utilização	113 horas 11 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 17 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 4 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 39 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 03/08/2025)	3,728 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549729
Modo	AutoSet
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	14 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.5	Percentil 95.º: 11.5	Máximo: 12.6	
Fugas — l/min	Mediana: 12.5	Percentil 95.º: 29.3	Máximo: 38.0	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.2	IAH: 0.6	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

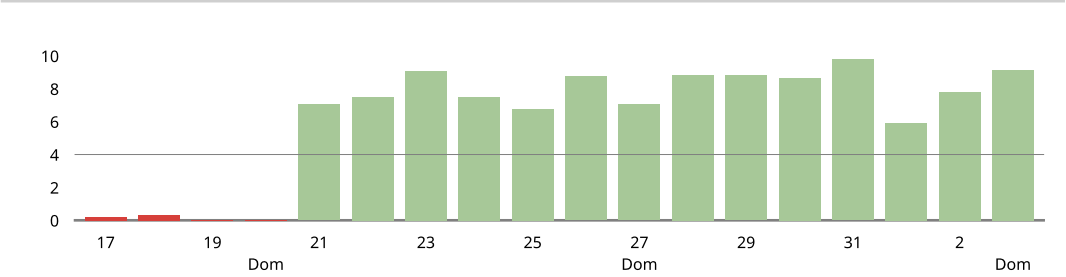


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549729


Utilização (horas)

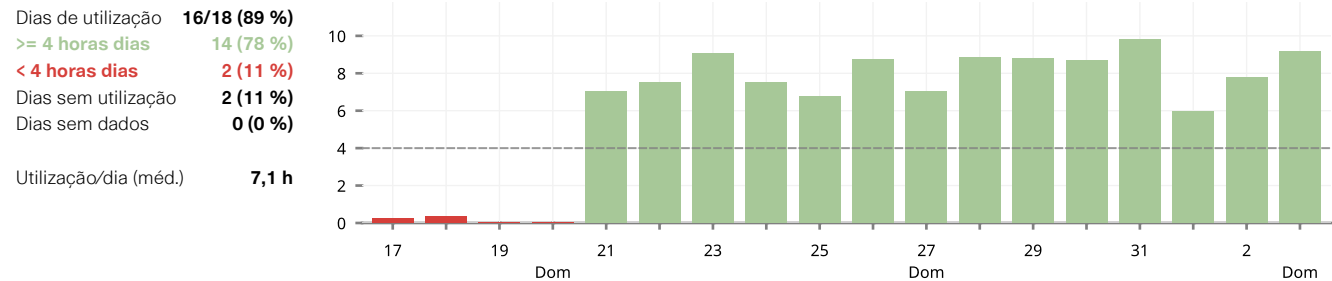

Fuga (l/min)

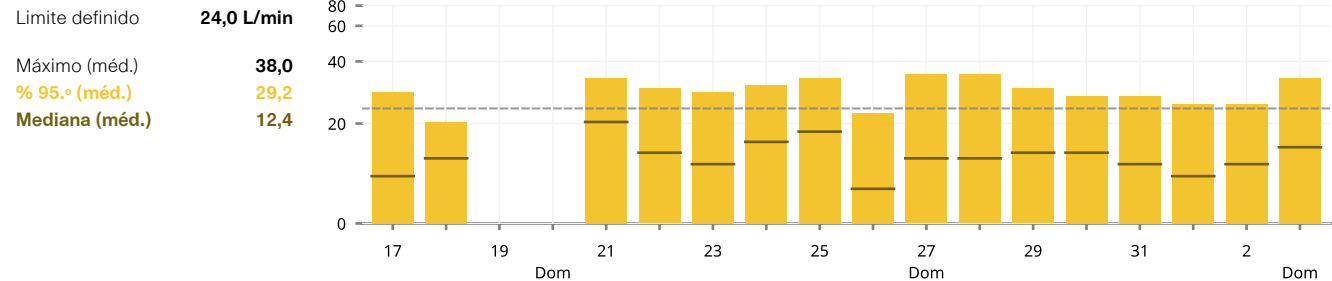

Pressão (cmH2O)

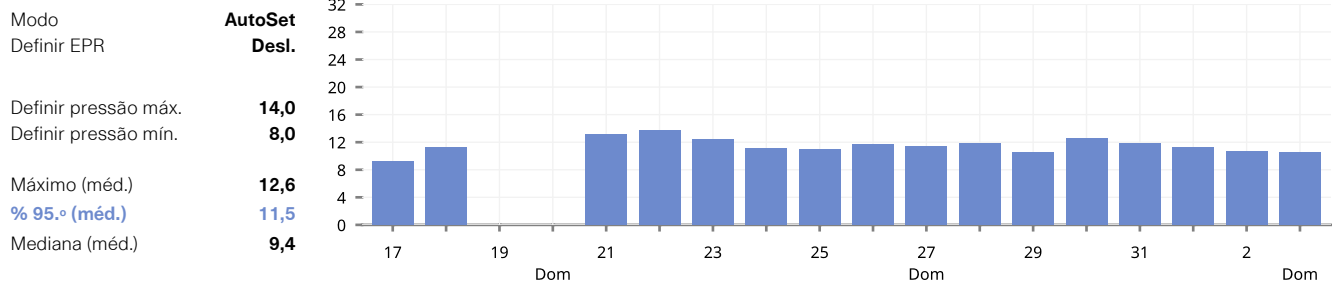

IAH (eventos/hora)

