

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/10/2025 - 25/10/2025
Dias de utilização		4/4 dias (100%)
>= 4 horas		4 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		34 horas 3 minutos
Utilização média (total de dias)		8 horas 31 minutos
Utilização média (dias de utilização)		8 horas 31 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		8 horas 47 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/10/2025)		3,710 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292573
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.2	Percentil 95.º: 9.8	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 19.2	Percentil 95.º: 44.1	Máximo: 81.9	
Eventos por hora	IA: 7.0	IH: 2.4	IAH: 9.4	
Índice de apneia	Central: 5.1	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	1.6
Índice RERA				1.7
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292573


Utilização (horas)

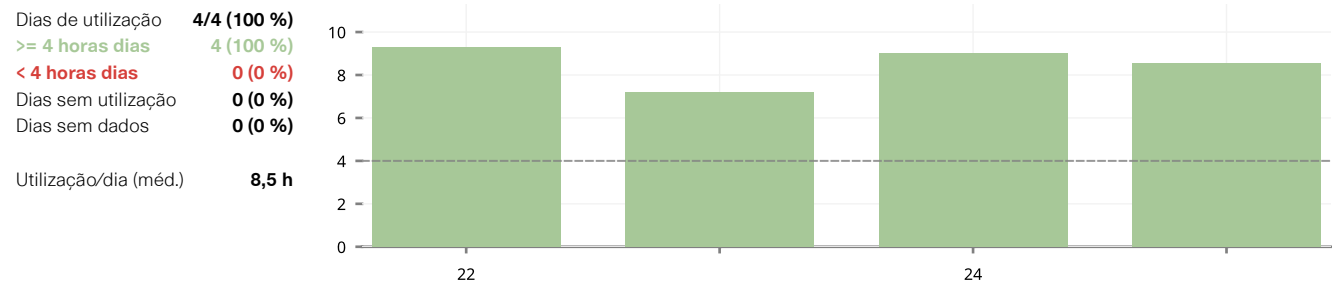

Fuga (l/min)

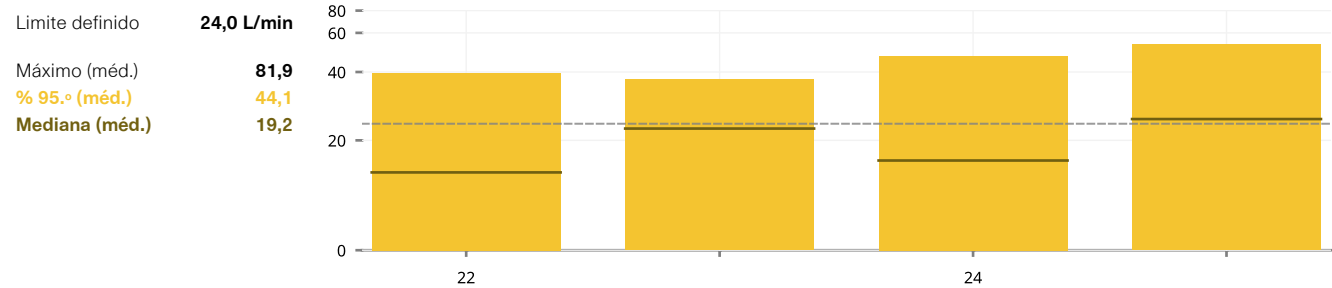

Pressão (cmH2O)

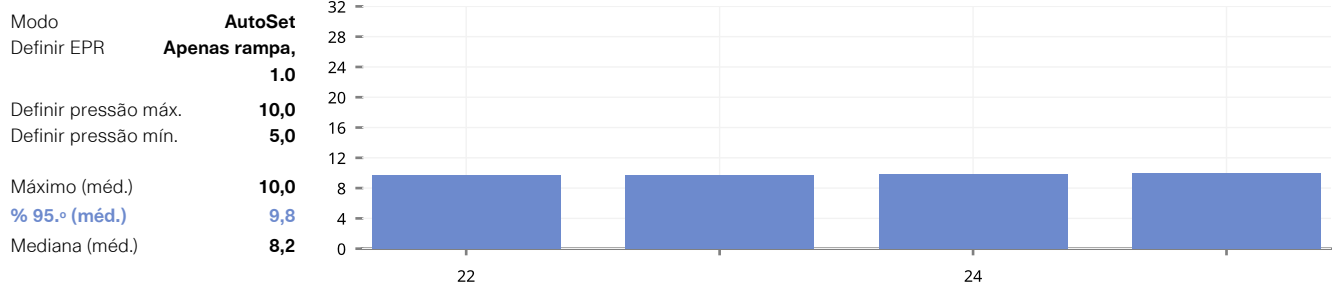

IAH (eventos/hora)

