


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/10/2025 - 28/10/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (86%)	
< 4 horas	1 dias (14%)	
Horas de utilização	44 horas 31 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 22 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 22 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 9 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/10/2025)	5,989 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221830369
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.3	Percentil 95.º: 9.6	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 0.5	Máximo: 23.3	
Eventos por hora	IA: 2.7	IH: 0.3	IAH: 3.0	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 1.7	Desconhecid	0.5
Índice RERA	0.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

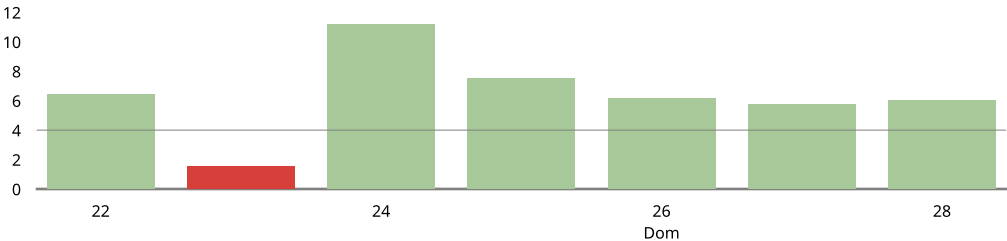

Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22221830369

Utilização (horas)

Dias de utilização7/7 (100 %)


>= 4 horas dias6 (86 %)

< 4 horas dias1 (14 %)

Dias sem utilização0 (0 %)

Dias sem dados0 (0 %)

Utilização/dia (méd.)6,4 h

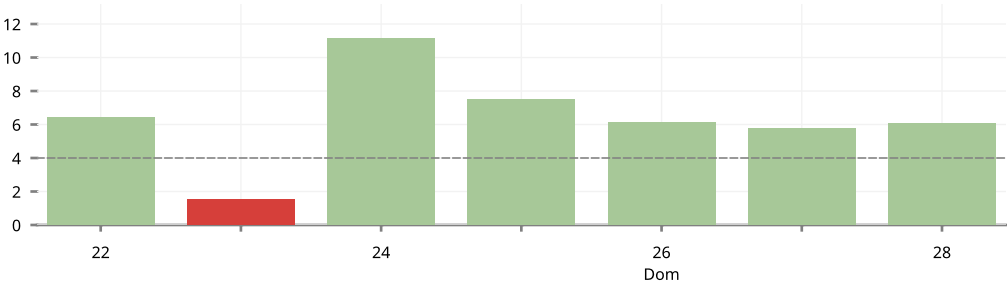


Fuga (l/min)

Limite definido24,0 L/min

Máximo (méd.)23,3

% 95.º (méd.)0,5

Mediana (méd.)0,0

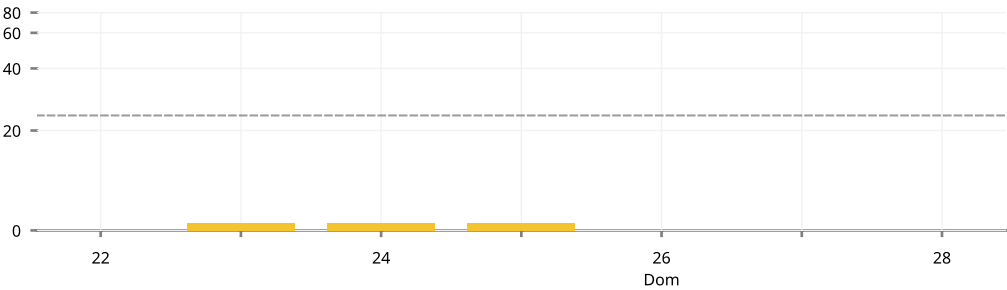

Pressão (cmH2O)

ModoAutoSet

Definir EPRApenas rampa, 1.0


Definir pressão máx.10,0

Definir pressão mín.4,0

Máximo (méd.)10,0

% 95.º (méd.)9,6

Mediana (méd.)8,3

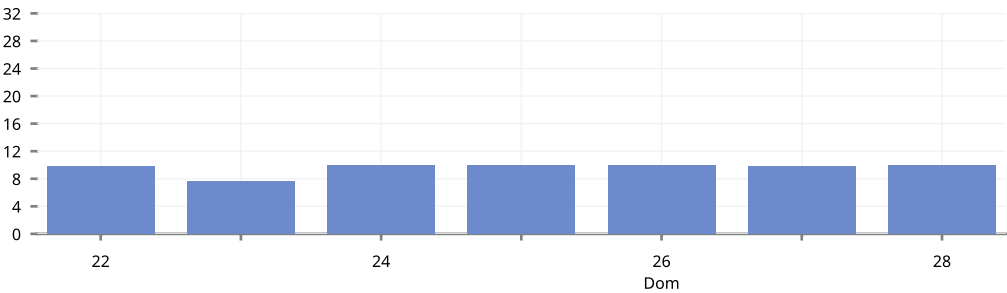

IAH (eventos/hora)

IAH3.0

IH0.3

IA2.7

IAC0.4

IAO1.7

IAD0.5

RERA0.7

%RCS (méd.)0.0

