


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/11/2025 - 22/11/2025
Dias de utilização	8/13 dias (62%)	
>= 4 horas	8 dias (62%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	57 horas 4 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 23 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 8 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 57 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/11/2025)	56 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260548
Modo	CPAP
Pressão definida	8.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.7	Percentil 95.º: 14.0	Máximo: 23.3	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.6	IAH: 1.3	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

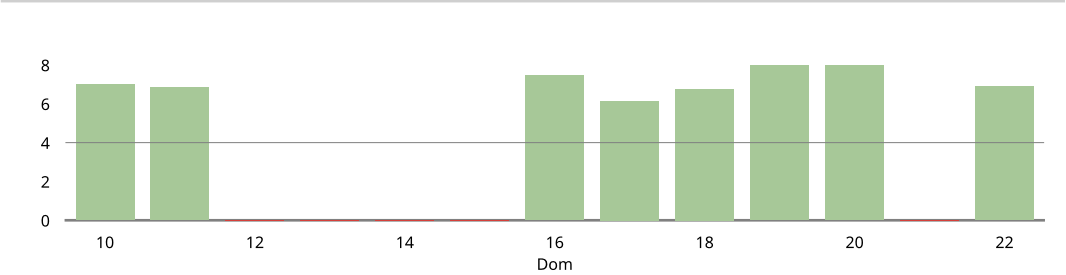

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260548

Utilização (horas)


Dias de utilização **8/13 (62 %)**
>= 4 horas dias **8 (62 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **5 (38 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **7,1 h**

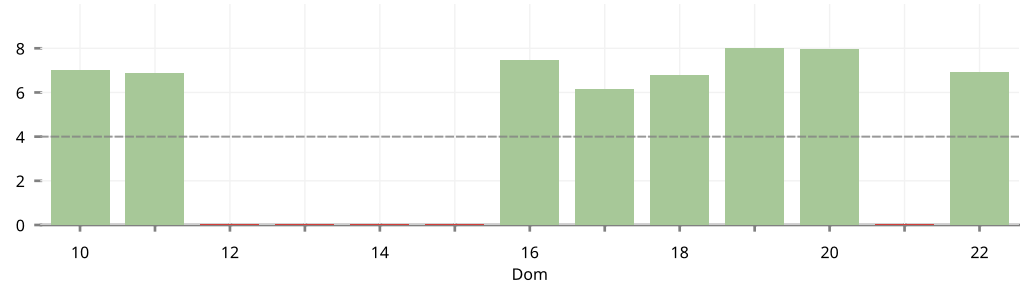

Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **23,2**
% 95.º (méd.) **14,0**
Mediana (méd.) **1,6**

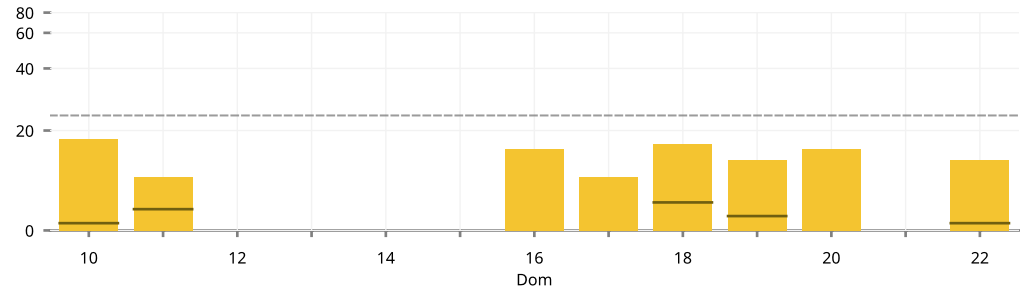

Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa,**
1.0

Pressão definida **8,4**

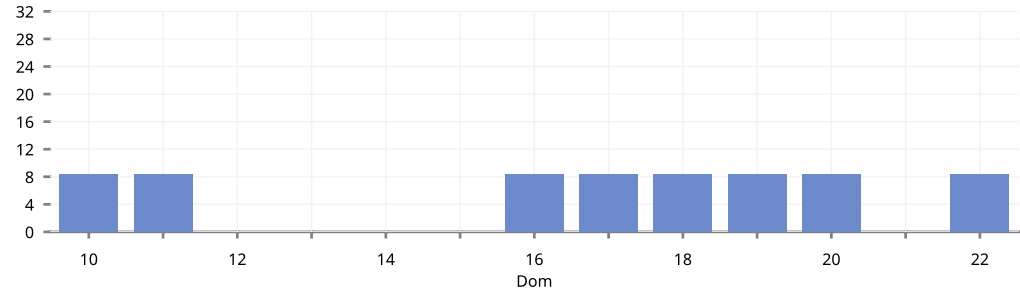

IAH (eventos/hora)

IAH ☐

IH ☐

IA ☐

IAC

IAO

IAD

RERA

%RCS (méd.)

1.3

0.6

0.7

0.5

0.1

0.0

0.2

0.0

