


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		27/10/2025 - 09/11/2025
Dias de utilização	13/14 dias (93%)	
>= 4 horas	13 dias (93%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	92 horas 52 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 38 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 9 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 52 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 09/11/2025)	4,037 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039537
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.4	Percentil 95.º: 9.8	Máximo: 9.9	
Fugas — l/min	Mediana: 3.5	Percentil 95.º: 17.4	Máximo: 31.9	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.7	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

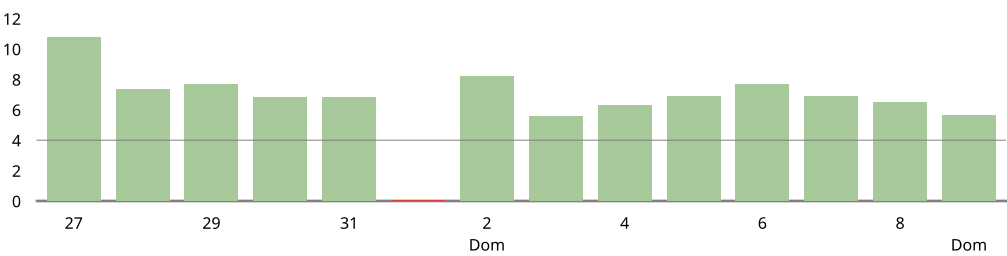


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039537


Utilização (horas)

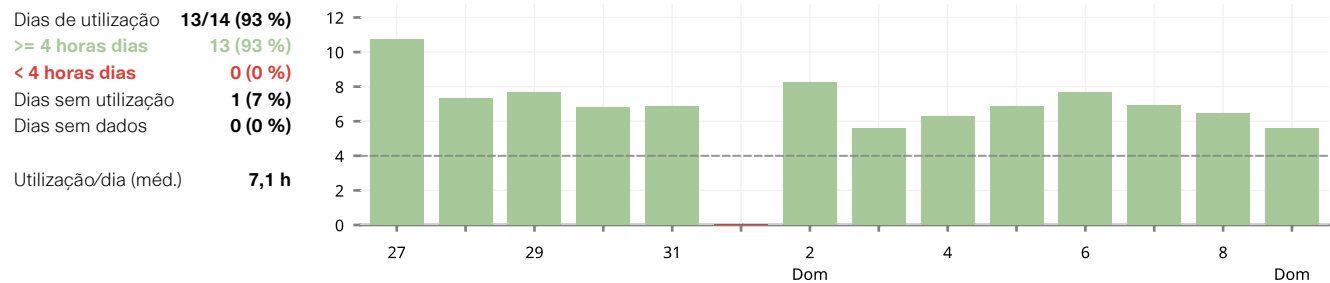

Fuga (l/min)

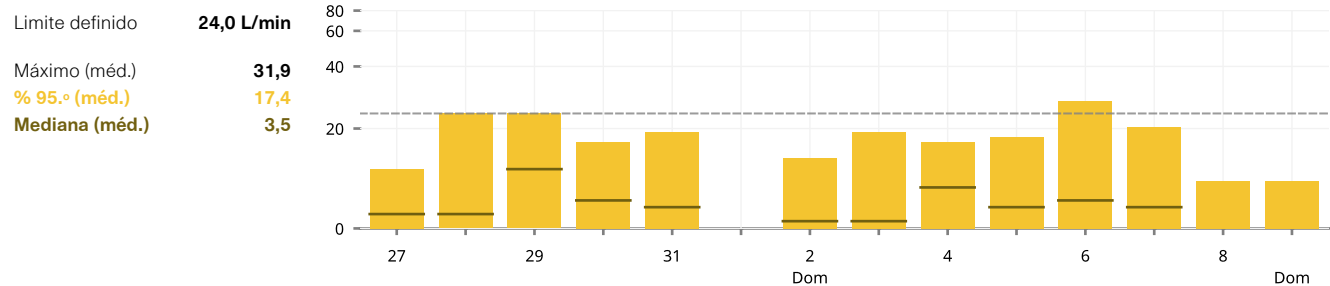

Pressão (cmH2O)

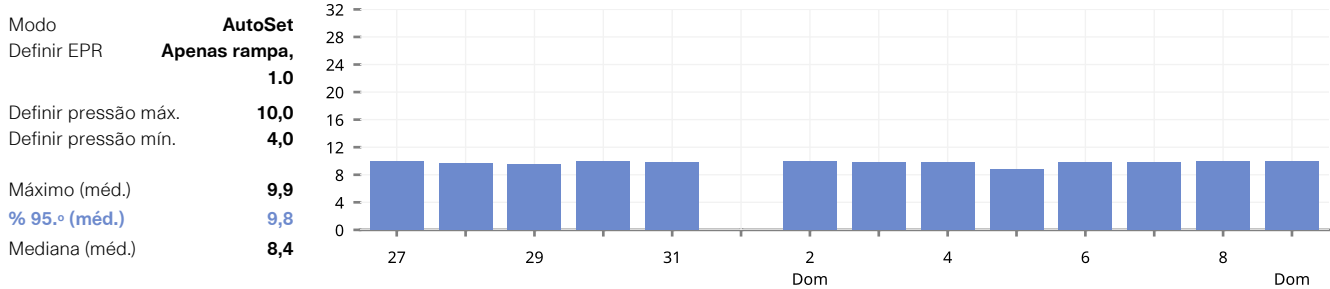

IAH (eventos/hora)

