

DADOS DO PACIENTE

Nome: PEDRO LUIZ MAXIMO Telefone: —
 Identificação Paciente: — E-mail: —
 Data de Nascimento: 31 mai 1958 Sexo: —

Médico: — Telefone: —

Média de IAHL: 1,5 Média de Utilização (h:min): 0:45 Adesão Tto.*: 13 %
 * Últimos 30 Dias
 % noites de utilização CPAP ≥4 horas a partir de 25 abr 2025

EQUIPAMENTOS

EM 24 mai 2025

Modelo: SleepStyle Auto Umidif.: 6,0
 Nº de Série: 200536W74 Alívio Expiratório: 3 cmH₂O
 Modo: Auto SensAwake: Ligado
 Pressão Mín. Ajustada: 7,0 cmH₂O Pressão do SensAwake: 5,0 cmH₂O
 Pressão Máx. Ajustada: 9,0 cmH₂O



ADESÃO AO TRATAMENTO

PERÍODO DE 30 DIAS
 25 abr 2025 - 24 mai 2025

INÍCIO DA TERAPIA
 22 abr 2021 - 24 mai 2025

Total de Dias:
 Utilização: 5 (17 %) 940 (63 %)
 Utilização ≥ 4 horas: 4 (13 %) 781 (52 %)
 Não Utilizado: 25 (83 %) 554 (37 %)
 Média de Utilização (Dias em Terapia): 4:32 5:56
 Média de Utilização (Todos os Dias): 0:45 3:44
 Total Func.: 22:48 5634:54

EFICÁCIA**

IAHL: 1,5 Duração das Apneias: 13 s IAC: 0,3
 Pressão: 5,5 cmH₂O Pressão de 90º Percentil: 6,5 cmH₂O À Pressão Máxima: 1 %
 Vazamento do Sistema: 28 L/min Vazamento no 90º Percentil: 33 L/min Vazamento Alto: 0 %
 Nº de Ativações do SensAwake: 5 por noite SensAwake Ligado: 100 %

AMBIENTE


Temperatura Ambiente: 23 °C

UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 0:45
 Dias de Utilização: 17 %

■ Total Func.
 ■ Total de Utilização
 ■ Utilização <4 h
 Umidif.

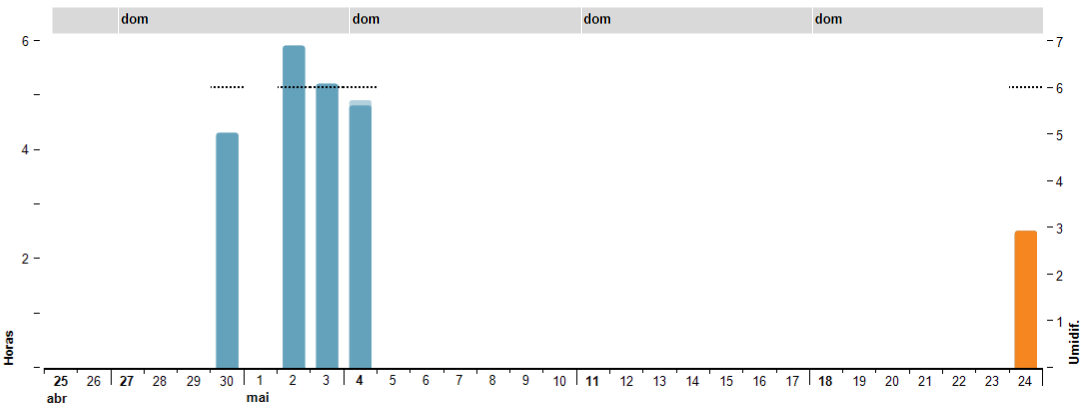

DADOS DO PACIENTE

Nome: PEDRO LUIZ MAXIMO Telefone: —
 Identificação Paciente: — E-mail: —
 Data de Nascimento: 31 mai 1958 Sexo: —


IAH

Eventos por hora

IAH: 1,5
 IAC: 0,3
 IAO: 0,5
 IH: 0,7

IAH Total

IAH = 5

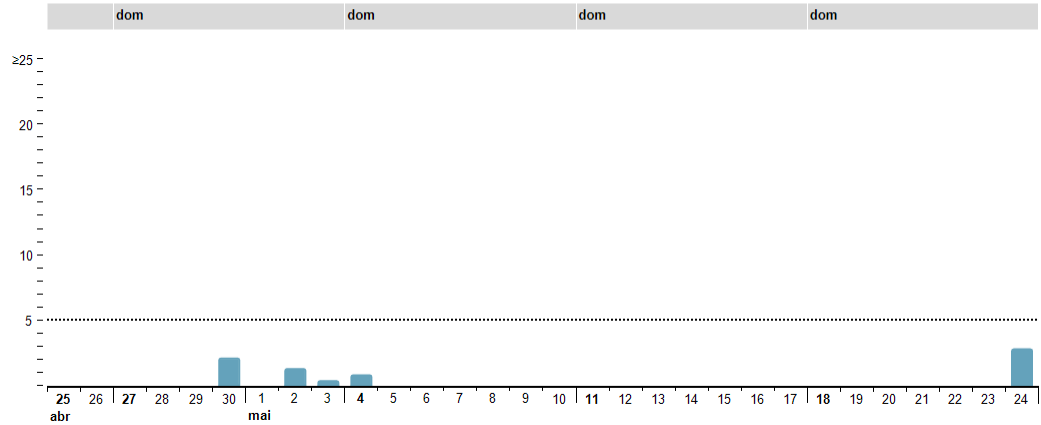

PRESSÃO

cmH₂O


Média: 5,5
 90º Percentil: 6,5

Média

90º Percentil

Pressão Máxima Atingida

Mín / Máx

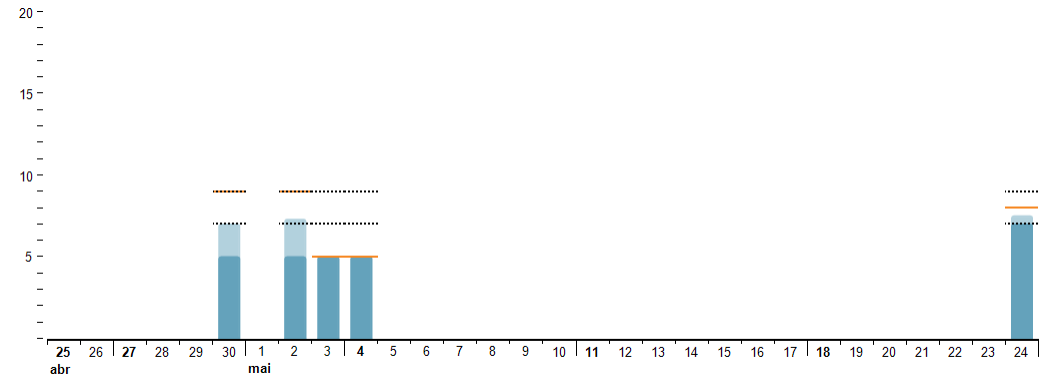

VAZAMENTO SIST.


l/min

Média: 28
 90º Percentil: 33

Média

90º Percentil

Vazamento Alto

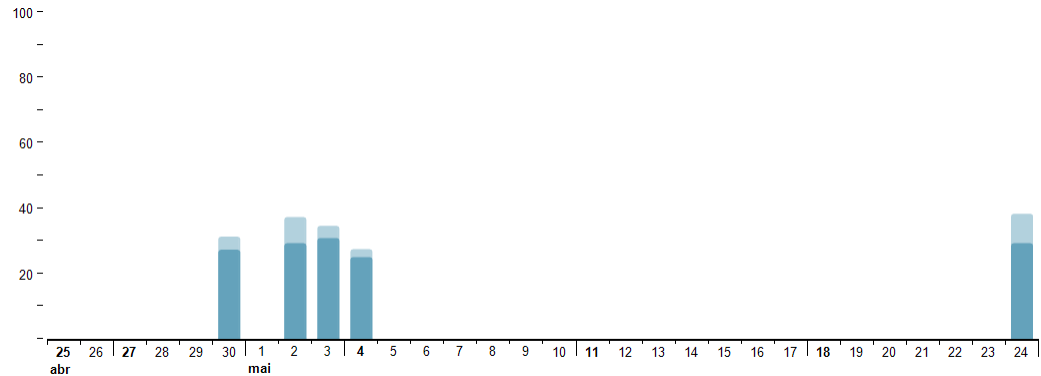

UTILIZAÇÃO

Horas


Média: 0:45
 Dias de Utilização: 17 %

Total Func.

Total de Utilização

Utilização <4 h

Umidif.

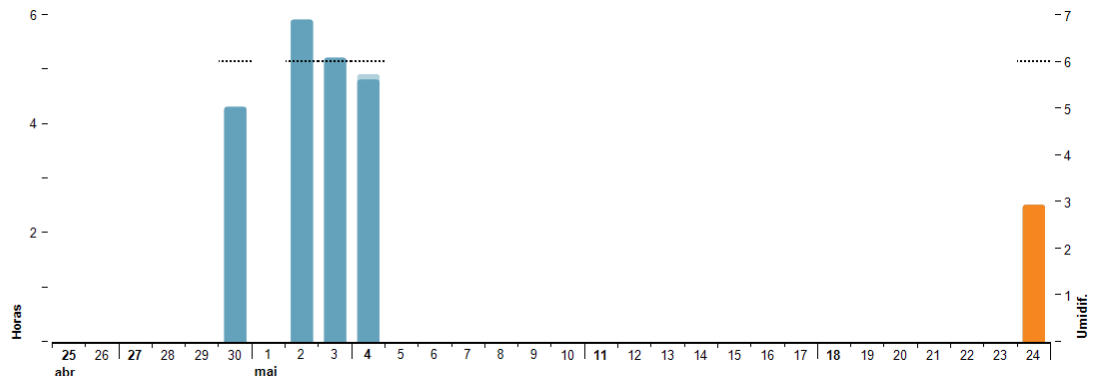

RESUMO DA ADESÃO AO TRATAMENTO

Nome: PEDRO LUIZ MAXIMO

Telephone: _____


Identificação Paciente: _____

E-mail: _____

Data de Nascimento: 31 mai 1958

Sexo: _____

Histórico de Prescrições

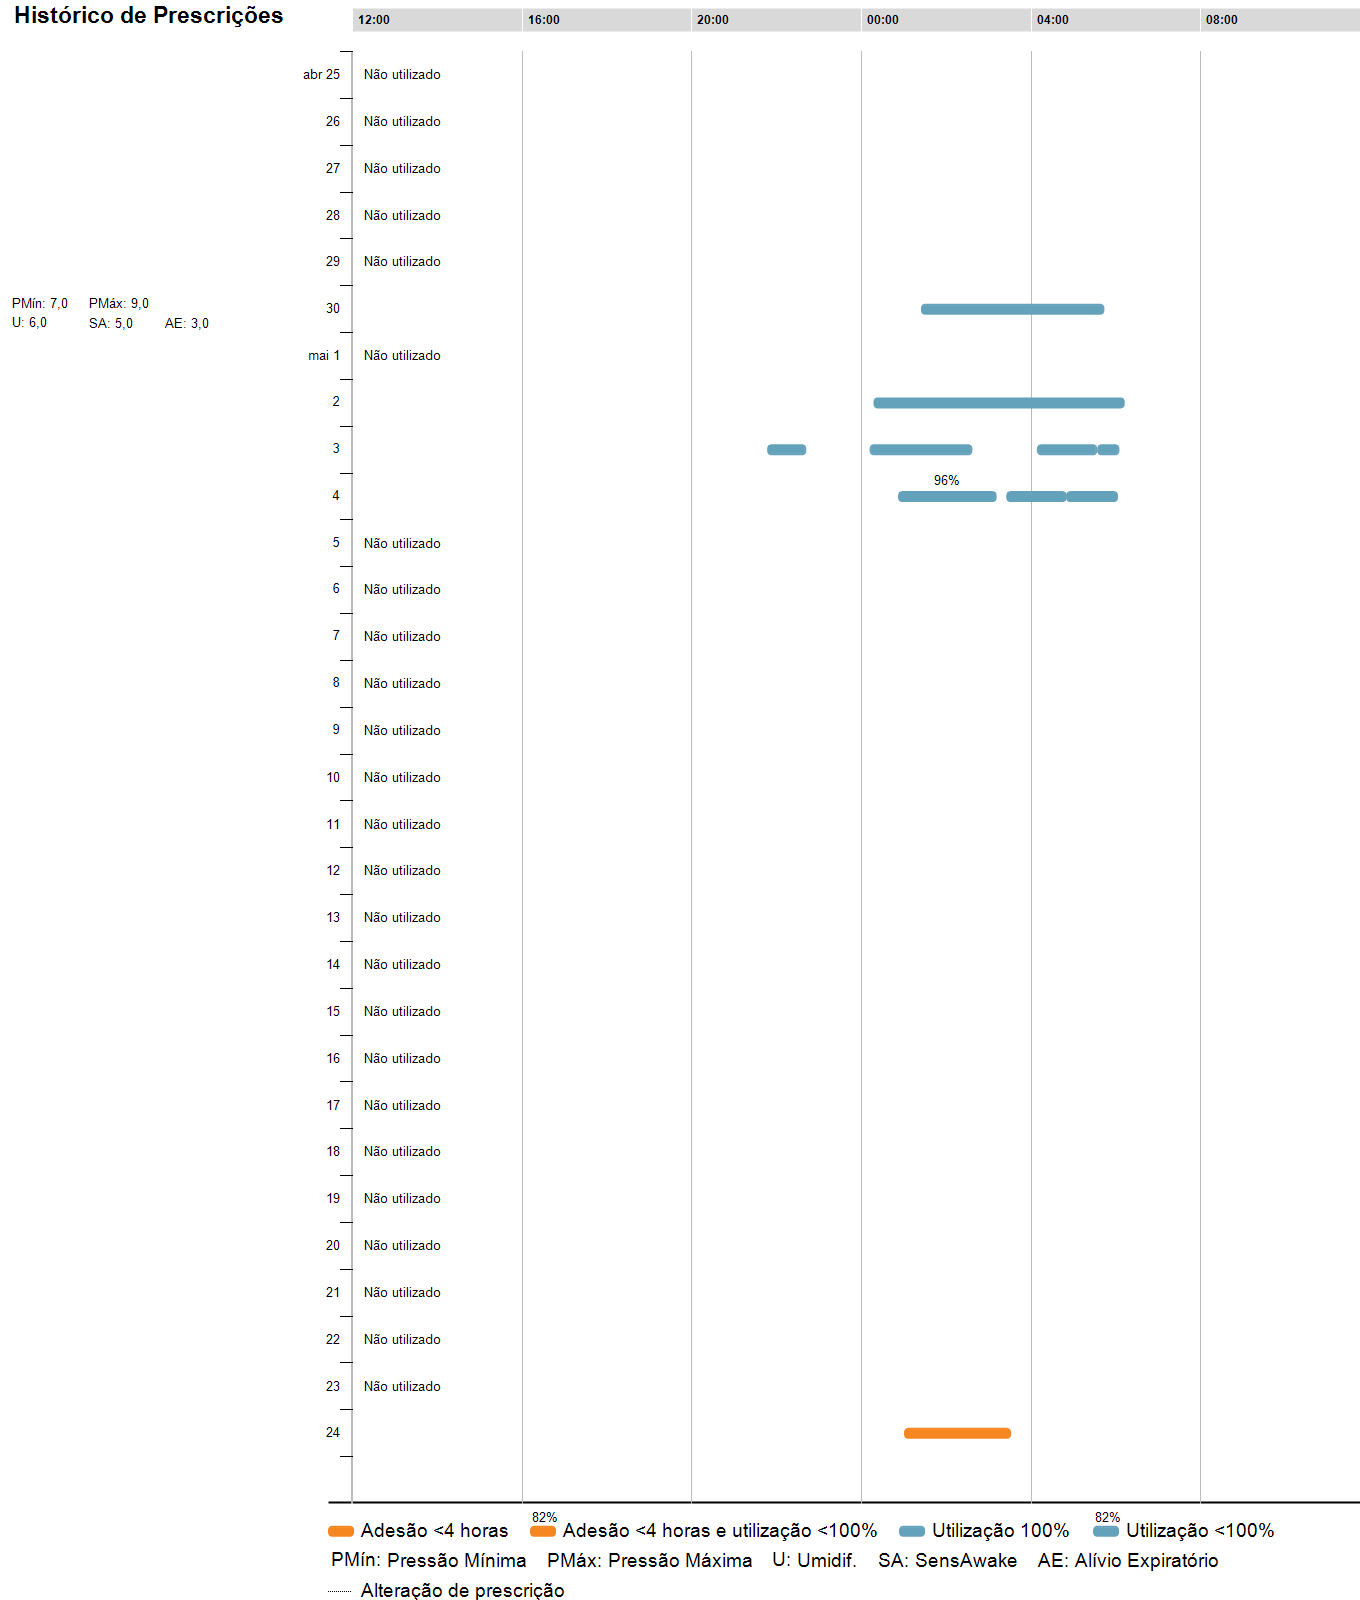


24 mai 2025

dom 25 mai 2025 01:00 -
dom 25 mai 2025 03:30

Nome: PEDRO LUIZ MAXIMO
Telefone: —
Identificação Paciente: —
E-mail: —
Data de Nascimento: 31 mai 1958
Sexo: —


TEMPO FUNC.

Total Func.: 2:30
% de Utilização: 100 %



EVENTOS


IAH: 2,8
Apneia obstrutiva: 3
IAO: 1,2
Hipopneias: 3
IH: 1,2
Apneias centrais: 1
IAC: 0,4
Limitações de Fluxo: 2
Limitações de Fluxo (/h): 0,8
SensAwake-Total: 3
SensAwake (/h): 1,2

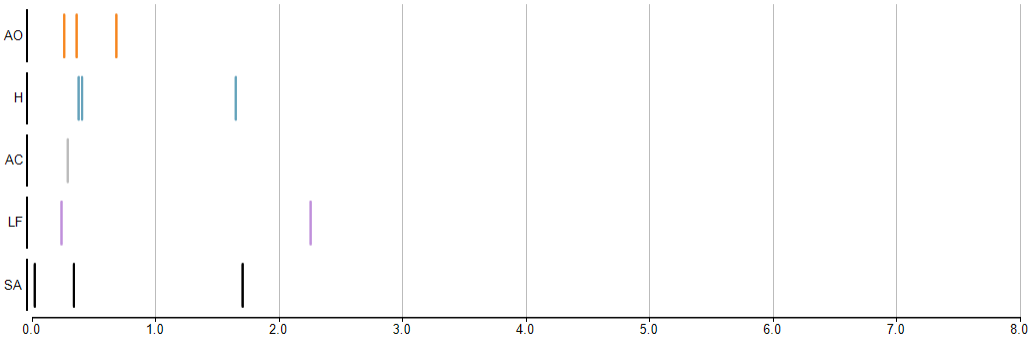

PRESSÃO

cmH₂O


Mediana: 7,0
90° Percentil: 7,5
Tempo de Rampa
Min / Máx

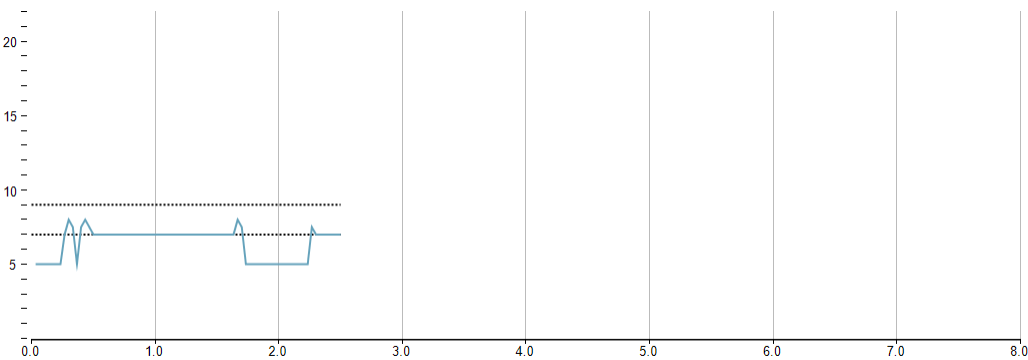

VAZAMENTO SIST.

l/min

Mediana: 29
90° Percentil: 38
Vazamento Alto*: 0 %

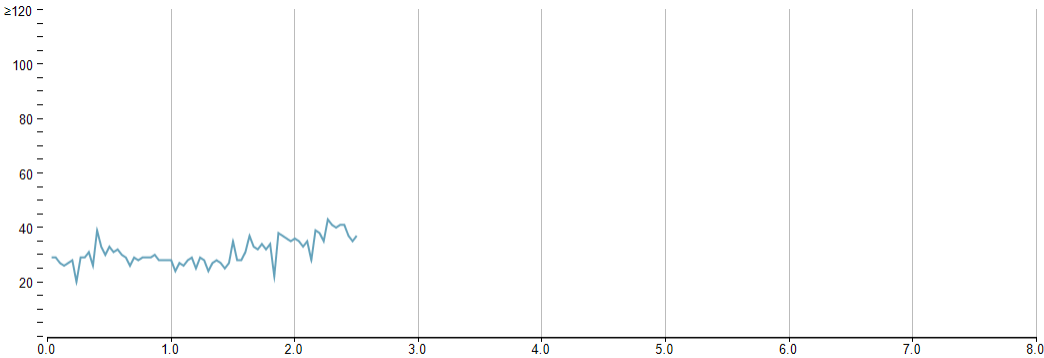

TEMPO E EVENTOS À PRESSÃO

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H (min)	0	48	0	86	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LF	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANÁLISE DE 5 DIAS

Nome:

PEDRO LUIZ MAXIMO

Telefone:

—

Identificação Paciente:

—

E-mail:

—

Data de Nascimento:

31 mai 1958

Sexo:

—

Data	Modo	Pressão Ajustada (cmH ₂ O)	Umidif.	Ativações da Rampa	Tempo Func. (h:min)	Tempo de Utilização (h:min)	IAH	IAC	Ativações do SensAwake	Pressão do SensAwake (cmH ₂ O)	Alívio Expiratório	Pressão de 90º Percentil (cmH ₂ O)	Pressão Máx Atingida (cmH ₂ O)	Vazamento no 90º Percentil (L/min)
30 abr 2025	Auto	Min. 7,0 Máx. 9,0	6,0	0	4:18	4:18	2,1	0,7	6	5,0	3	7,0	9,0	31
02 mai 2025	Auto	Min. 7,0 Máx. 9,0	6,0	0	5:54	5:54	1,3	0,3	4	5,0	3	7,5	9,0	37
03 mai 2025	Auto	Min. 7,0 Máx. 9,0	6,0	0	5:12	5:12	0,4	0,2	5	5,0	3	5,0	5,0	34
04 mai 2025	Auto	Min. 7,0 Máx. 9,0	6,0	0	4:54	4:48	0,8	0,0	5	5,0	3	5,0	5,0	27
24 mai 2025	Auto	Min. 7,0 Máx. 9,0	6,0	0	2:30	2:30	2,8	0,4	3	5,0	3	7,5	8,0	38