

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sra. MARIA ANGELA SCARPA DA SILVEIRA ALMEIDA**

Identificação do paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **21 junho 1956** Idade: **69**
Sexo: **Feminino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **15/04/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
		Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

21/05/2025 - 19/07/2025		Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22181271253)	
Parâmetros do dispositivo			
Modo de terapia: CPAP	Pressão programada: 8,0 cmH20	APE: RAMP_ONLY	
Nível APE: 1,0 cmH20	Activar APE: ON	Activação paciente APE: ON	
Activação subida: ON	Tempo de rampa: 5,0 Minutos	Acesso: LIGADO	
Fuga - l/min			
Mediana: 9,6	Percentil 95: 26,4	Máximo/a: 37,2	
Índices respiratórios - eventos/hora			
Índice de apneia: 0,5	Índice de hipopneia: 0,9	AHI: 1,4	
Obstrutiva: 0,3	Central: 0,0	Desconhecida: 0,0	
Índice RERA: 1,4	% tempo em CSR: 0,0		
Utilização Total			
Dias de Uso >= 4 horas : 15	Dias de Uso < 4 horas : 32	% Dias de Uso >= 4 horas : 25	
Dias de não utilização: 13	Totalidade de dias: 60	Horas de utilização: 165:46	
Mediana do uso diário: 3:06	Média de uso diário: 2:45		


Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário


21/05/2025 - 19/07/2025

Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22181271253)


Pressão

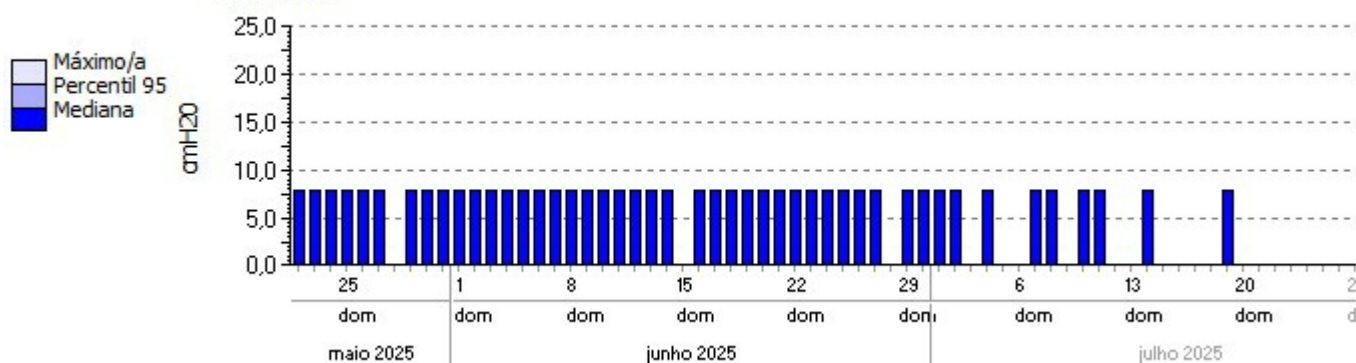


Fuga

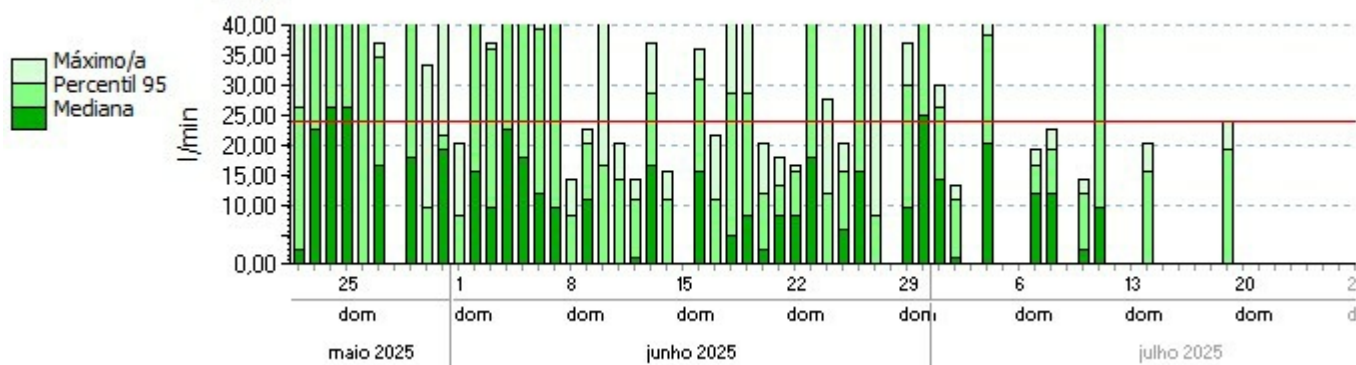

IAH & IA

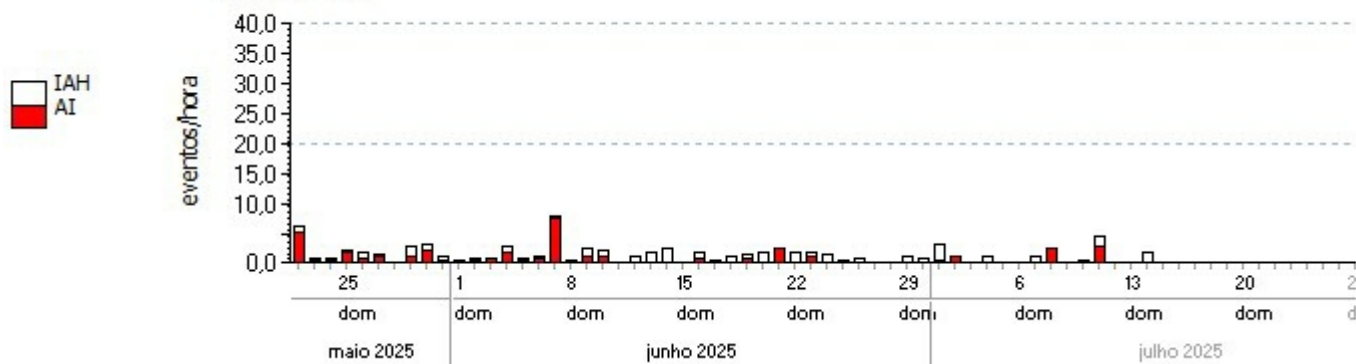

Uso

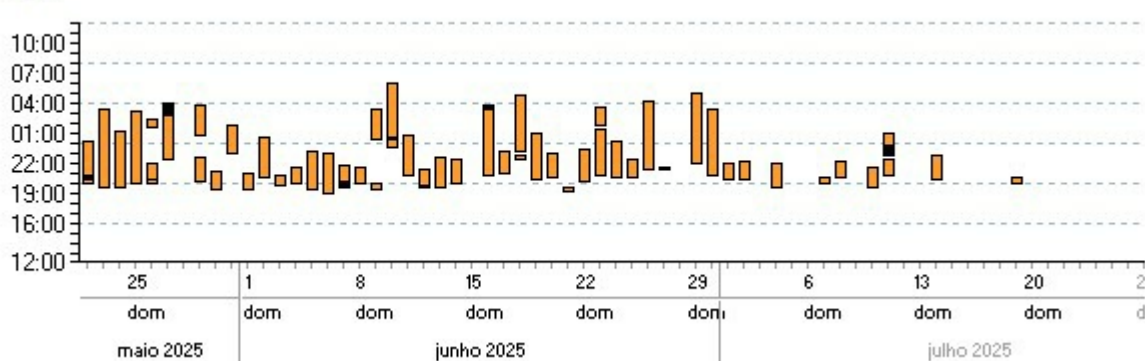

Utilização total e Cheyne-Stokes

