


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/10/2025 - 05/11/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	196 horas 59 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 34 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 34 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 22 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/11/2025)	9,642 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211126619
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	7.1	Percentil 95.º:	7.6	Máximo:	7.6
Fugas — l/min	Mediana:	0.5	Percentil 95.º:	11.2	Máximo:	21.4
Eventos por hora	IA:	1.0	IH:	0.1	IAH:	1.1
Índice de apneia	Central:	0.5	Obstrutiva:	0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA						0.2
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização

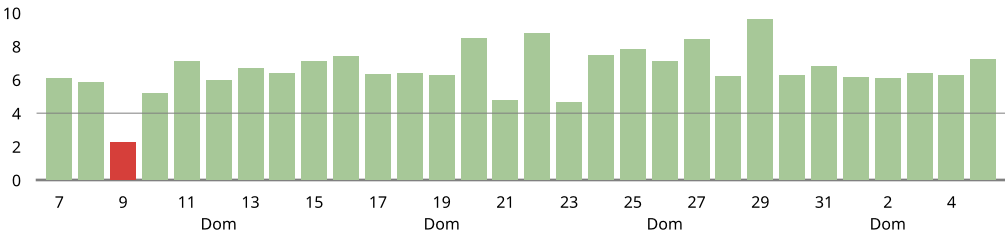


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211126619


Utilização (horas)

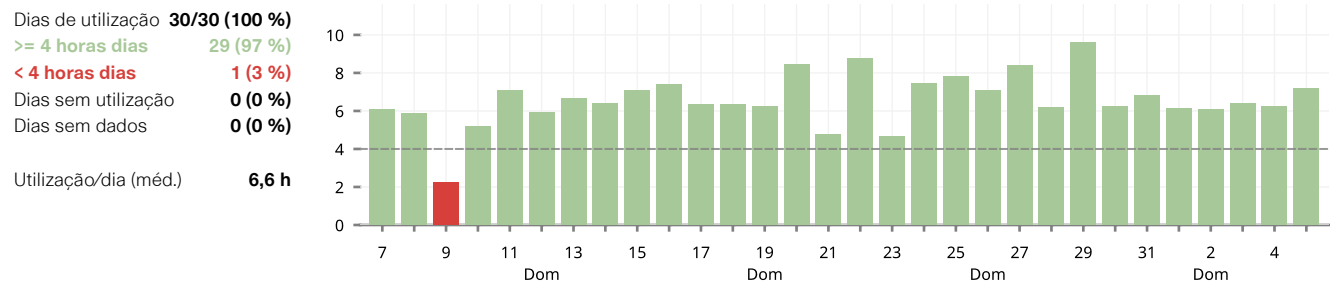

Fuga (l/min)

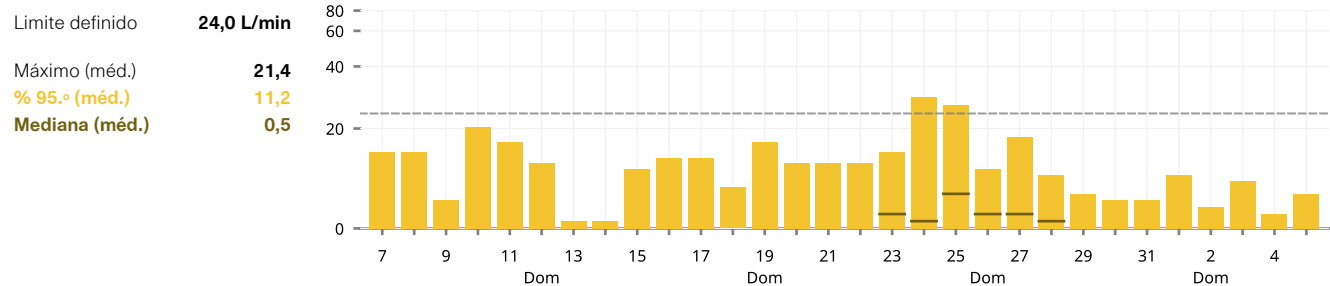

Pressão (cmH2O)

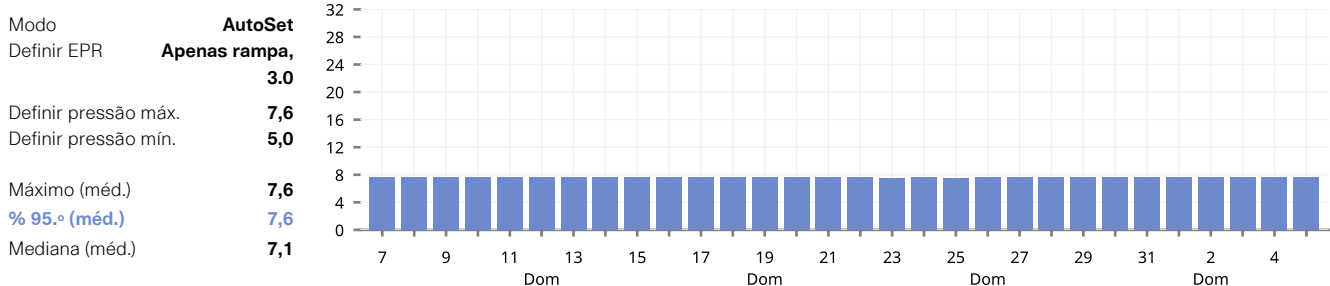

IAH (eventos/hora)

