


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/01/2026 - 10/02/2026	
Dias de utilização		30/30 dias (100%)	
>= 4 horas		29 dias (97%)	
< 4 horas		1 dias (3%)	
Horas de utilização		214 horas 16 minutos	
Utilização média (total de dias)		7 horas 9 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 9 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 8 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/02/2026)		10,320 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22211126619	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		5 cmH2O	
Pressão máx.		7.6 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		3	
Resposta		Suave	
Terapia			
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.0	Percentil 95.º: 7.6	Máximo: 7.6
Fugas — l/min	Mediana: 0.4	Percentil 95.º: 8.9	Máximo: 16.3
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.1	IAH: 0.9
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.2		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)			0 minutos (0%)

Horas de utilização

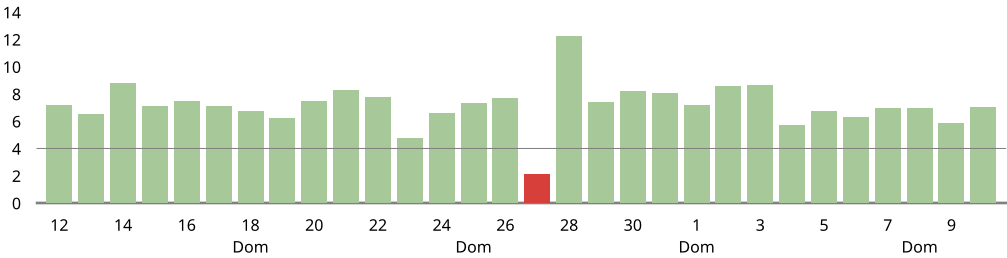


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211126619


Utilização (horas)

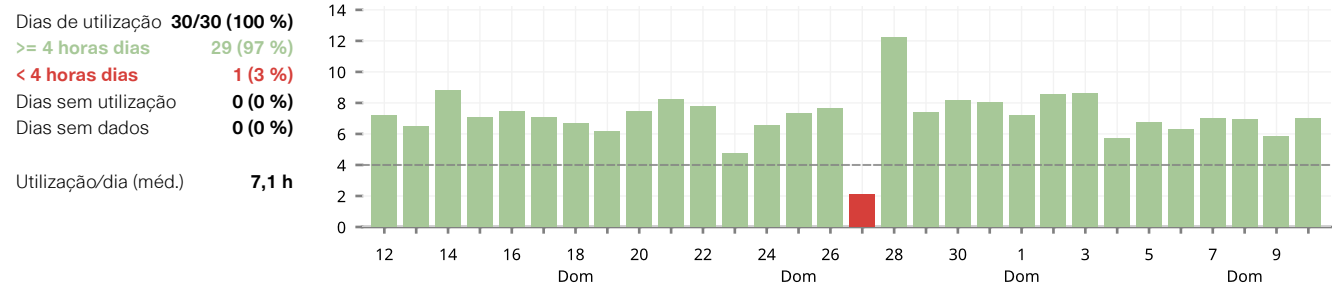

Fuga (l/min)

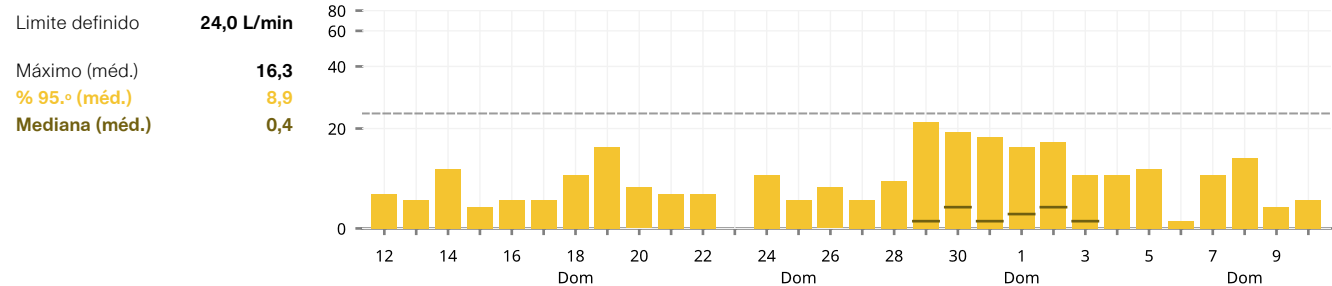

Pressão (cmH2O)

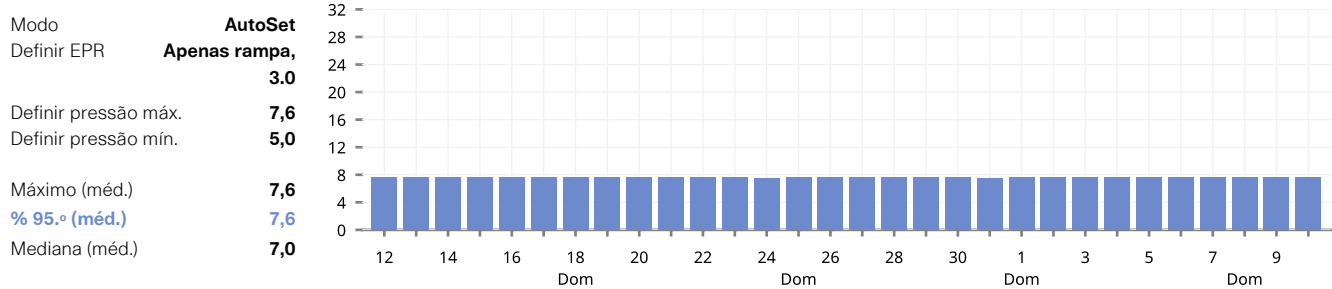

IAH (eventos/hora)

