


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/11/2025 - 28/11/2025
Dias de utilização		4/19 dias (21%)
>= 4 horas		2 dias (11%)
< 4 horas		2 dias (11%)
Horas de utilização		15 horas 24 minutos
Utilização média (total de dias)		49 minutos
Utilização média (dias de utilização)		3 horas 51 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		4 horas 2 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/11/2025)		2,189 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653865
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.1	Percentil 95.º: 11.6	Máximo: 11.9	
Fugas — l/min	Mediana: 3.6	Percentil 95.º: 18.6	Máximo: 36.9	
Eventos por hora	IA: 1.4	IH: 1.9	IAH: 3.3	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 1.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA				1.5
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

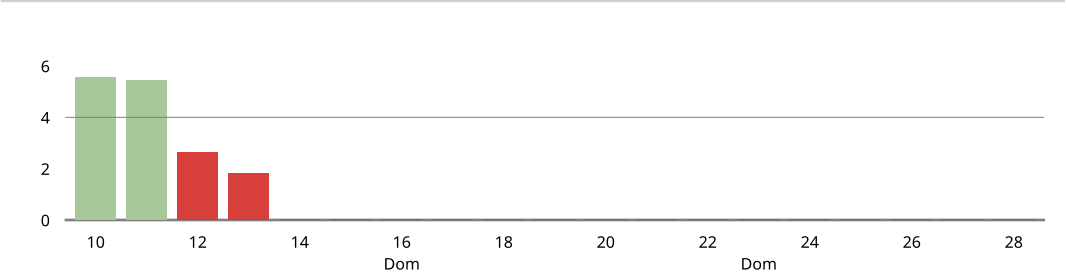


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653865


Utilização (horas)

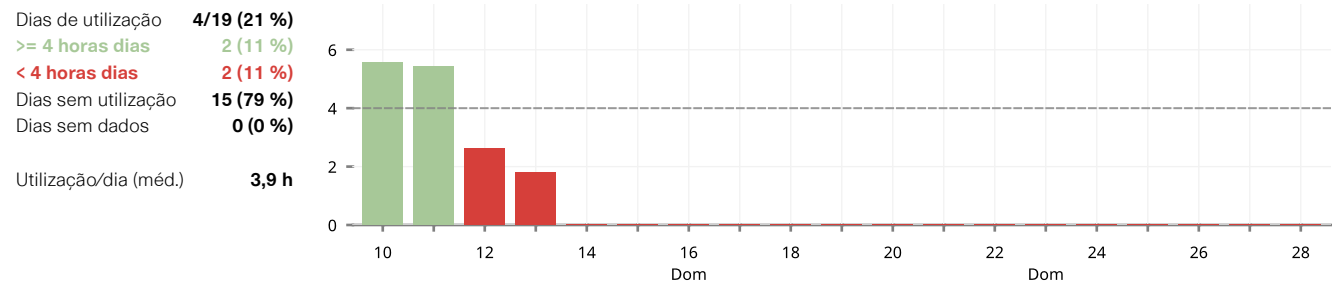

Fuga (l/min)

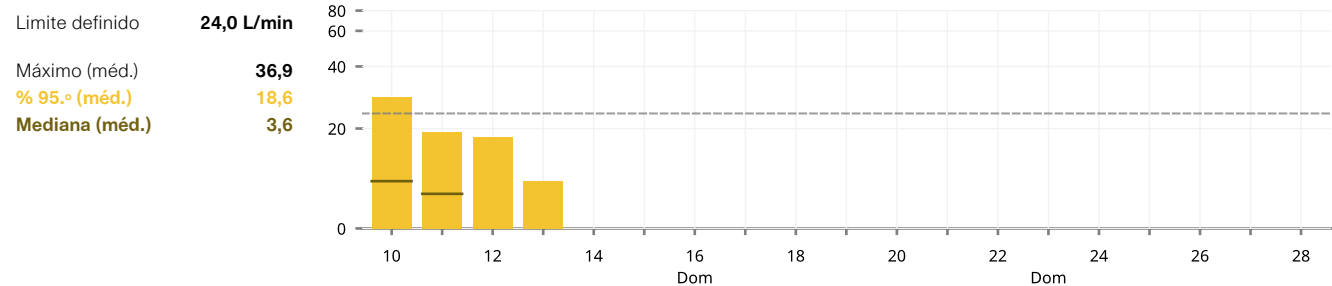

Pressão (cmH2O)

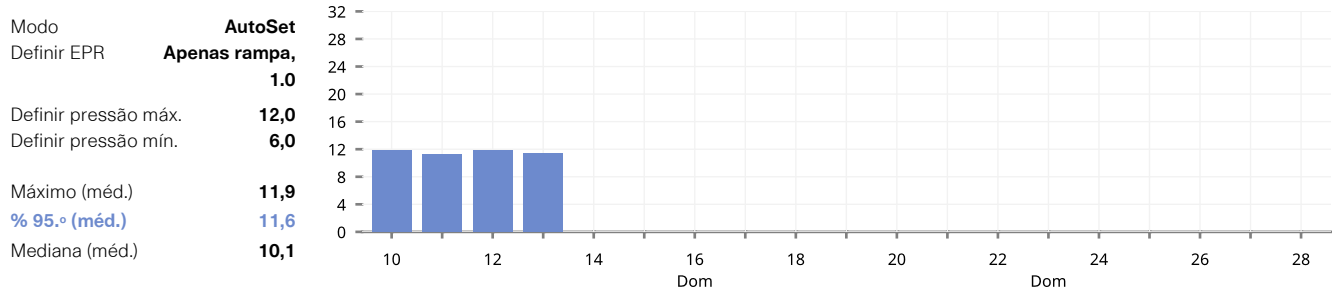

IAH (eventos/hora)

