


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		14/11/2025 - 16/11/2025
Dias de utilização	3/3 dias (100%)	
>= 4 horas	2 dias (67%)	
< 4 horas	1 dias (33%)	
Horas de utilização	16 horas 5 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 22 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 22 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 20 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/11/2025)	3,777 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292573
Modo	CPAP
Pressão definida	8.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 11.2	Máximo: 18.4	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.1	IAH: 0.9	
Índice de apneia	Central: 0.7	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

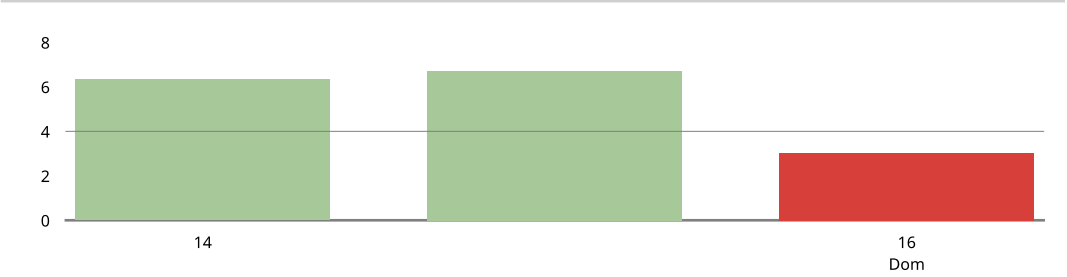


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292573


Utilização (horas)

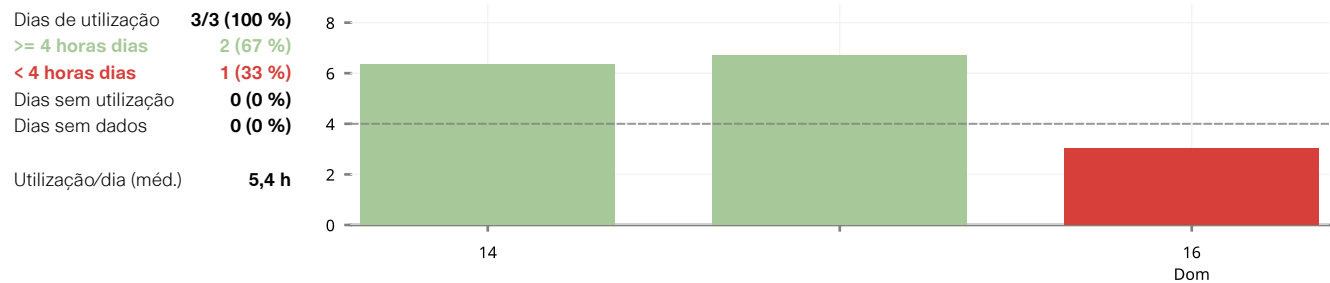

Fuga (l/min)

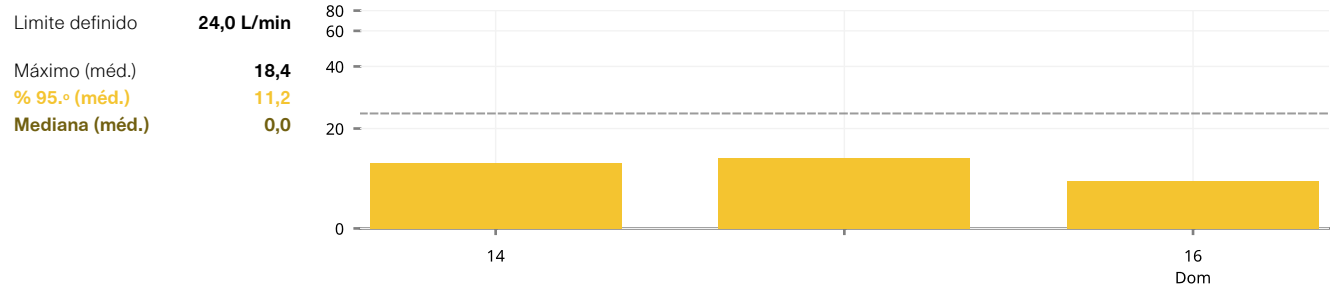

Pressão (cmH2O)

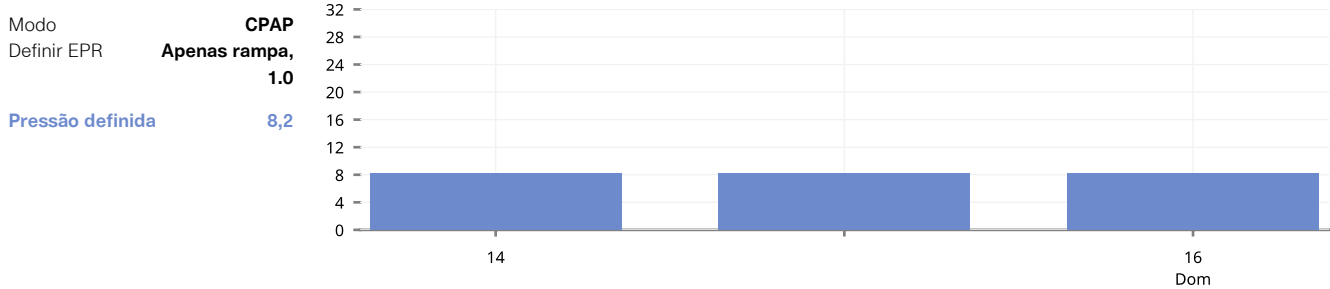

IAH (eventos/hora)

