

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

13/10/2025 - 11/11/2025

Dias de utilização		28/30 dias (93%)	
>= 4 horas		11 dias (37%)	
< 4 horas		17 dias (57%)	
Horas de utilização		93 horas 54 minutos	
Utilização média (total de dias)		3 horas 8 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		3 horas 21 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		3 horas 25 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/11/2025)		7,045 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série	22211126018		
Modo	AutoSet		
Pressão mín.	4 cmH2O		
Pressão máx.	6 cmH2O		
EPR	Apenas rampa		
Nível de EPR	2		
Resposta	Padrão		

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 5.5	Percentil 95.º: 5.8	Máximo: 5.9
Fugas — l/min	Mediana: 0.4	Percentil 95.º: 7.2	Máximo: 10.2
Eventos por hora	IA: 0.0	IH: 0.0	IAH: 0.0
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.0		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização

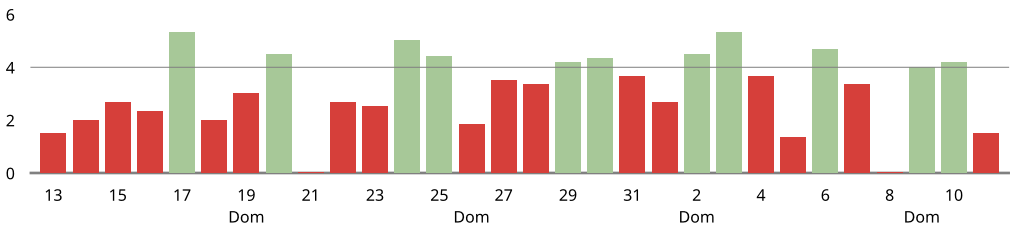


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211126018


Utilização (horas)

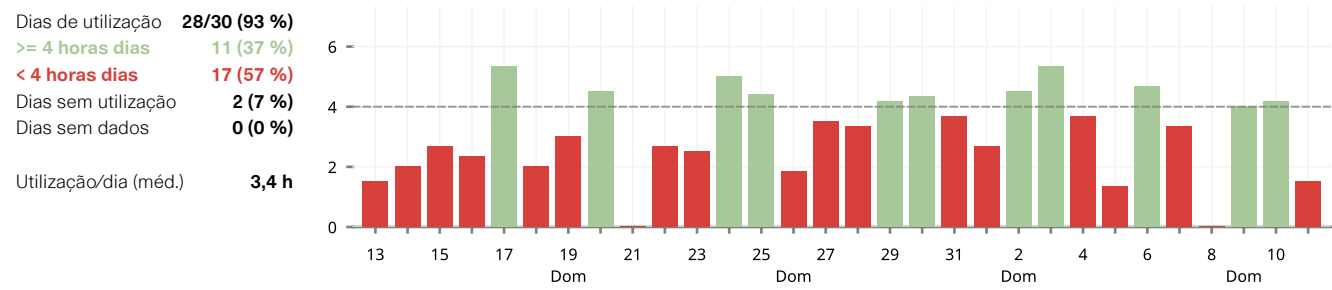

Fuga (l/min)

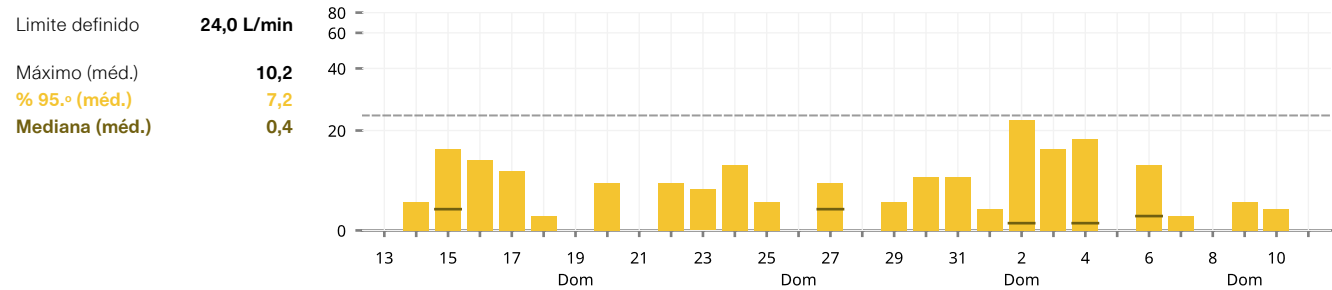

Pressão (cmH2O)

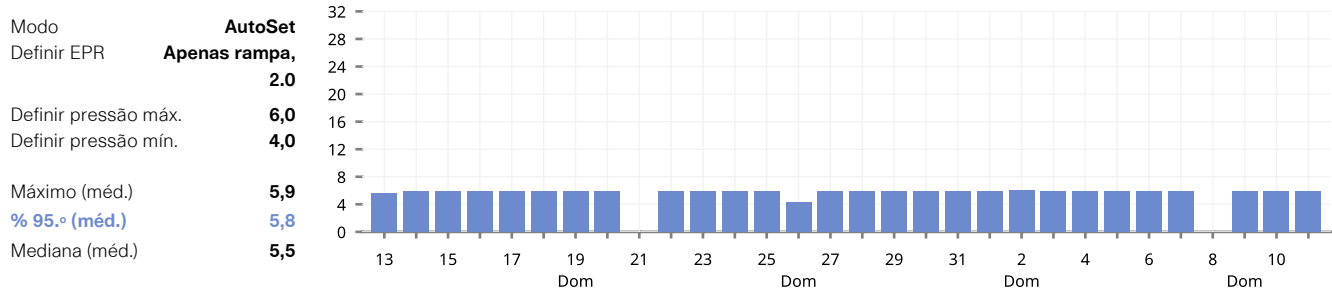

IAH (eventos/hora)

