


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		01/11/2025 - 30/11/2025
Dias de utilização	26/30 dias (87%)	
>= 4 horas	22 dias (73%)	
< 4 horas	4 dias (13%)	
Horas de utilização	150 horas 0 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 0 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 46 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 7 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 30/11/2025)	162 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260649
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.3	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 8.8	
Fugas — l/min	Mediana: 6.8	Percentil 95.º: 29.7	Máximo: 48.9	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 3.5	IAH: 4.0	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

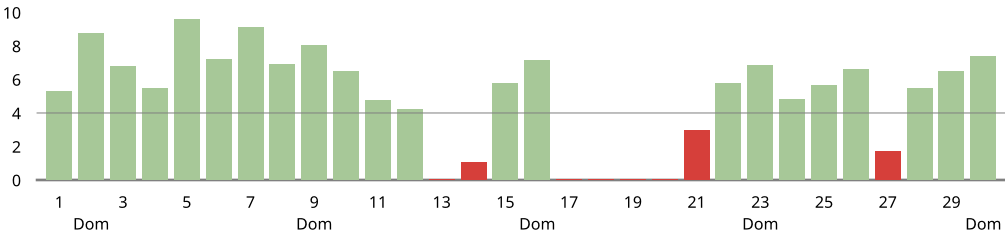


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260649


Utilização (horas)

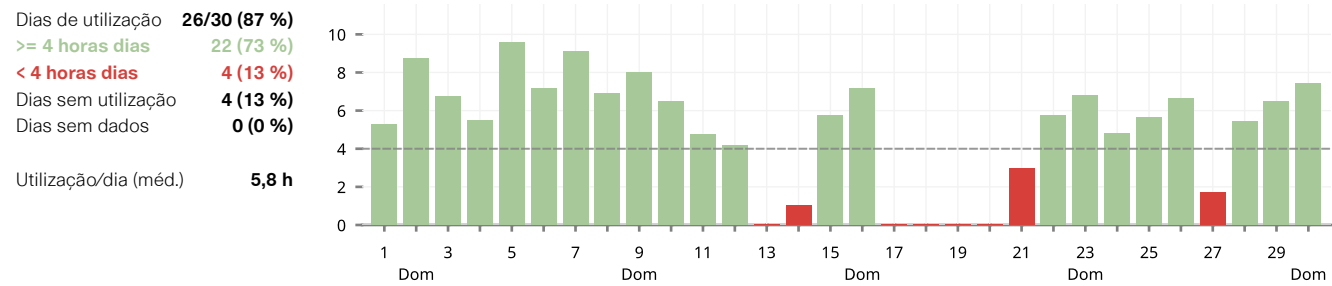

Fuga (l/min)

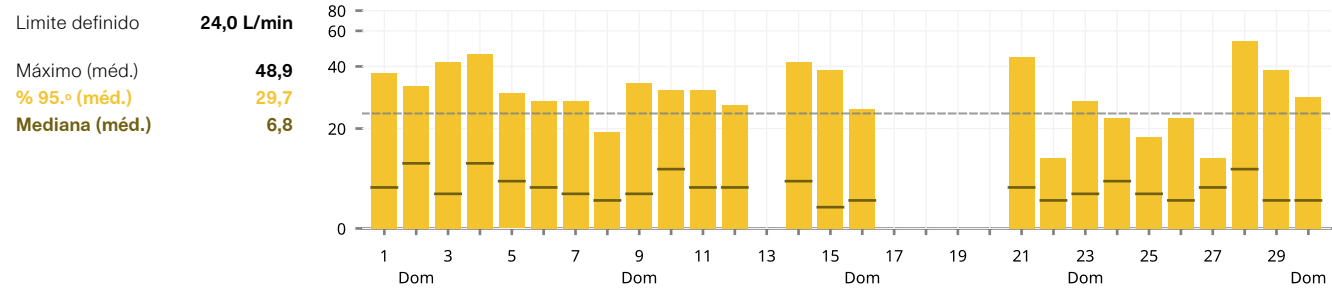

Pressão (cmH2O)

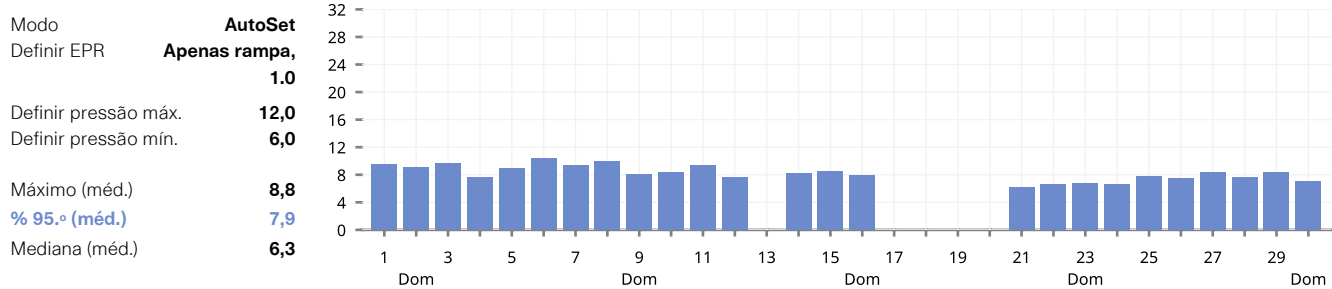

IAH (eventos/hora)

