


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/11/2025 - 24/11/2025
Dias de utilização	12/13 dias (92%)	
>= 4 horas	9 dias (69%)	
< 4 horas	3 dias (23%)	
Horas de utilização	62 horas 33 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 49 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 13 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 24 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 24/11/2025)	2,009 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882368
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.5	Percentil 95.º: 9.5	Máximo: 9.7	
Fugas — l/min	Mediana: 5.5	Percentil 95.º: 17.9	Máximo: 30.5	
Eventos por hora	IA: 5.0	IH: 1.4	IAH: 6.4	
Índice de apneia	Central: 0.7	Obstrutiva: 4.2	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

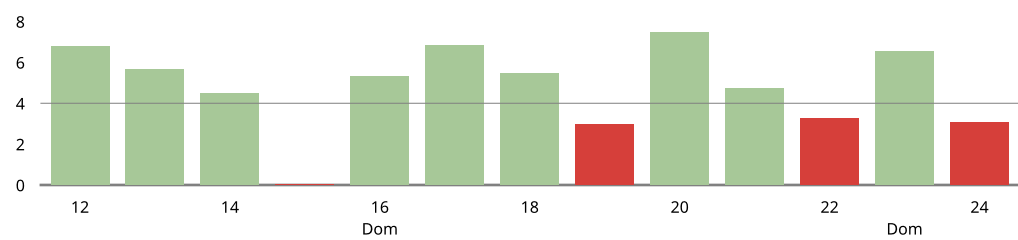


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882368


Utilização (horas)

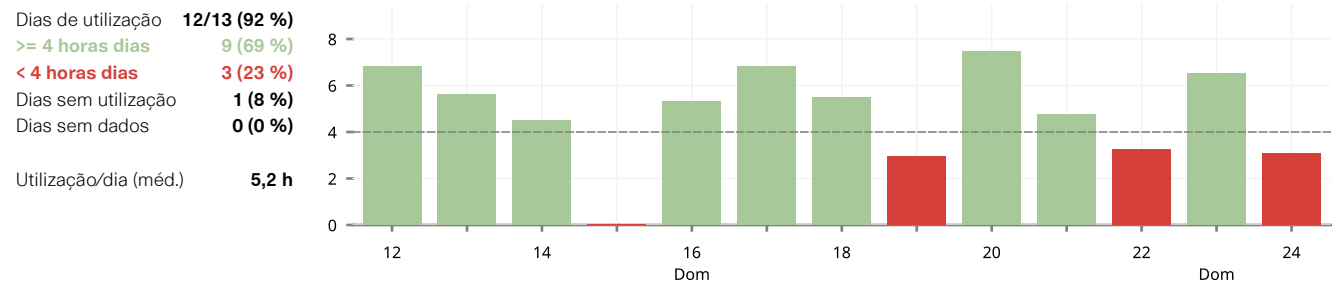

Fuga (l/min)

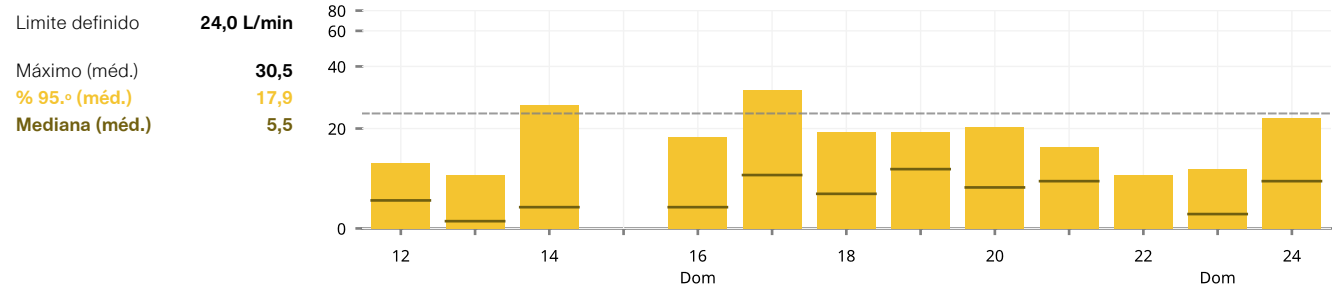

Pressão (cmH2O)

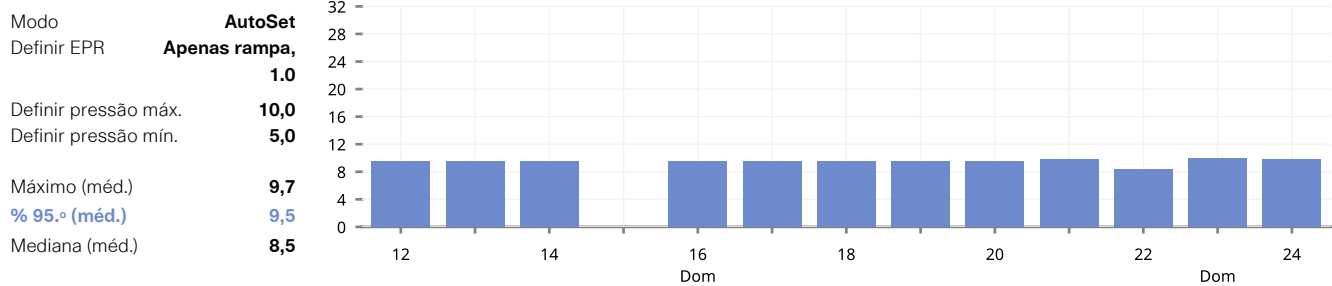

IAH (eventos/hora)

