


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/11/2025 - 13/11/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (86%)	
< 4 horas	1 dias (14%)	
Horas de utilização	50 horas 46 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 15 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 15 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 56 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/11/2025)	5,545 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291736
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.6	Percentil 95.º: 7.0	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.5	Percentil 95.º: 5.3	Máximo: 12.7	
Eventos por hora	IA: 1.0	IH: 0.1	IAH: 1.1	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

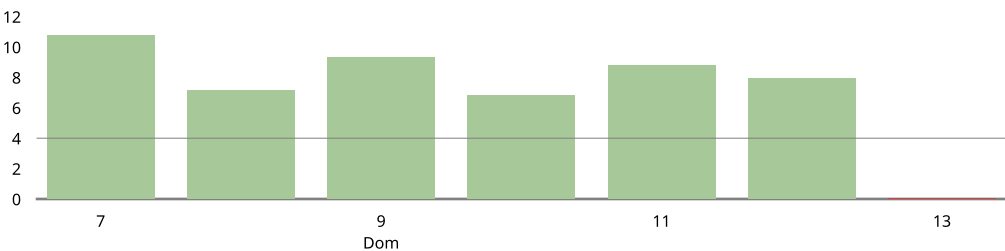


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291736


Utilização (horas)

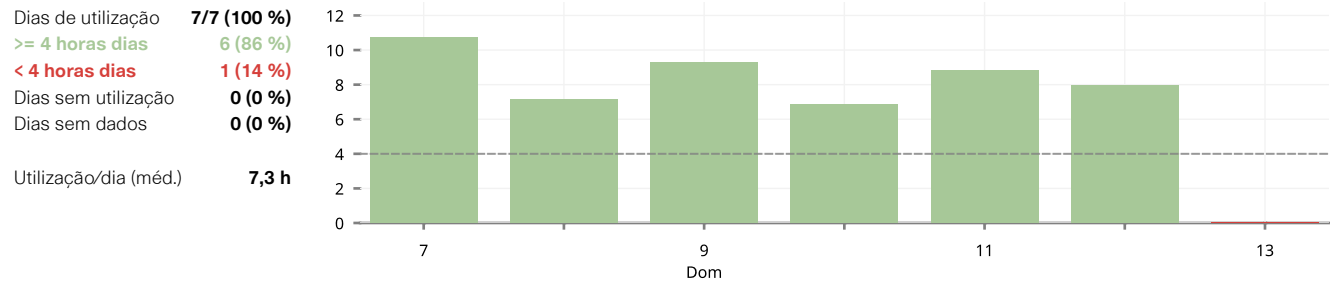

Fuga (l/min)

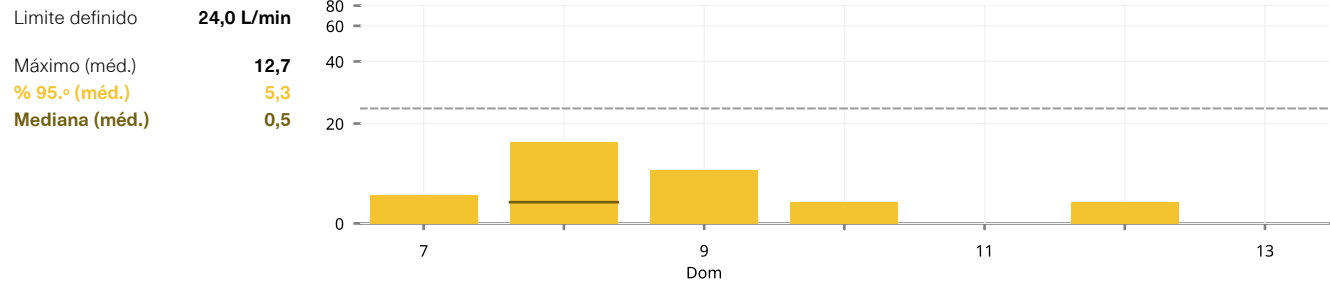

Pressão (cmH2O)

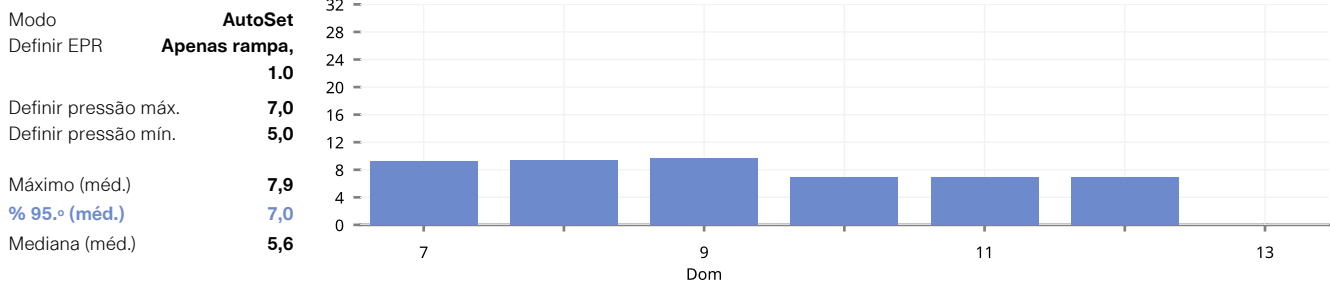

IAH (eventos/hora)

