


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/11/2025 - 22/11/2025
Dias de utilização		7/10 dias (70%)
>= 4 horas		6 dias (60%)
< 4 horas		1 dias (10%)
Horas de utilização		32 horas 52 minutos
Utilização média (total de dias)		3 horas 17 minutos
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 42 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		4 horas 40 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/11/2025)		4,071 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039537
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.5	Percentil 95.º: 9.0	Máximo: 9.5	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 3.6	Máximo: 17.7	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.4	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.2
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

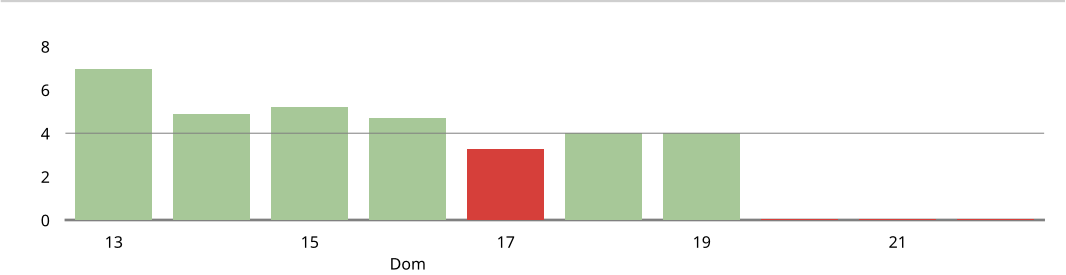


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039537


Utilização (horas)

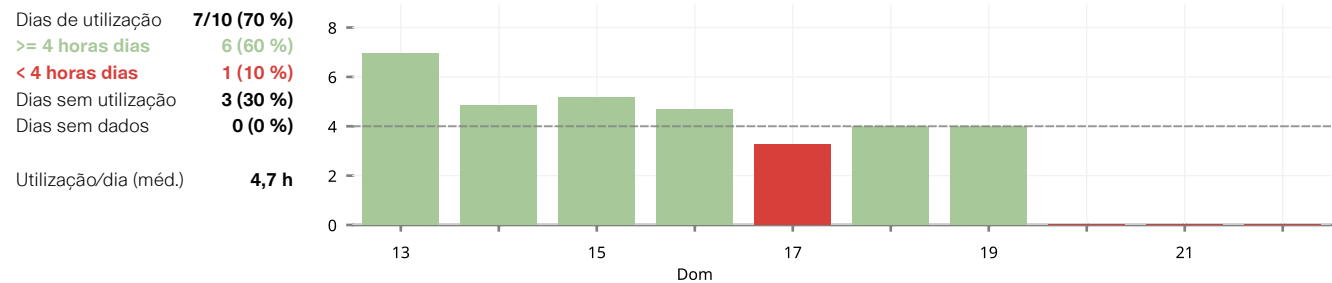

Fuga (l/min)

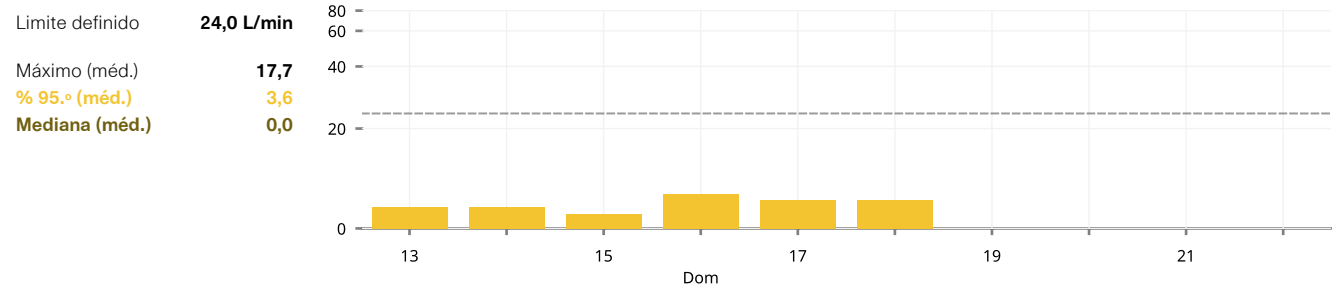

Pressão (cmH2O)

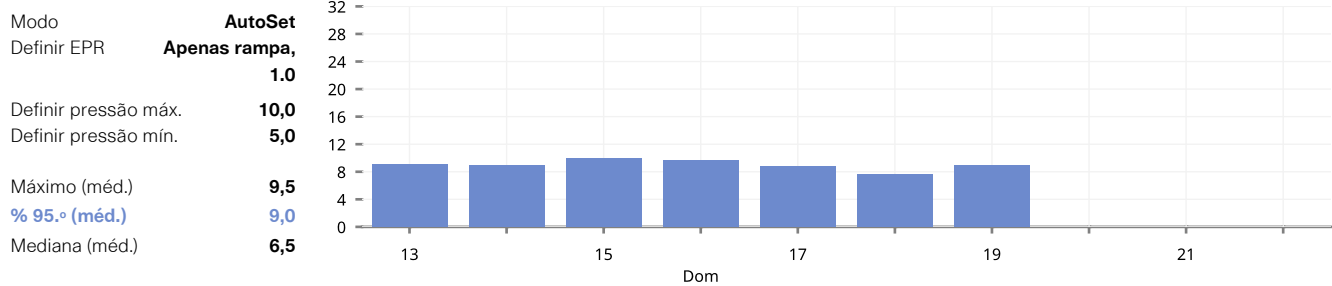

IAH (eventos/hora)

