


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/11/2025 - 17/12/2025
Dias de utilização	27/27 dias (100%)	
>= 4 horas	23 dias (85%)	
< 4 horas	4 dias (15%)	
Horas de utilização	192 horas 10 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 7 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 7 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 17 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/12/2025)	1,482 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881622
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.5	Percentil 95.º: 9.0	Máximo: 9.1	
Fugas — l/min	Mediana: 10.4	Percentil 95.º: 27.0	Máximo: 43.2	
Eventos por hora	IA: 1.3	IH: 0.4	IAH: 1.7	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.7	Desconhecid	0.2
Índice RERA	0.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

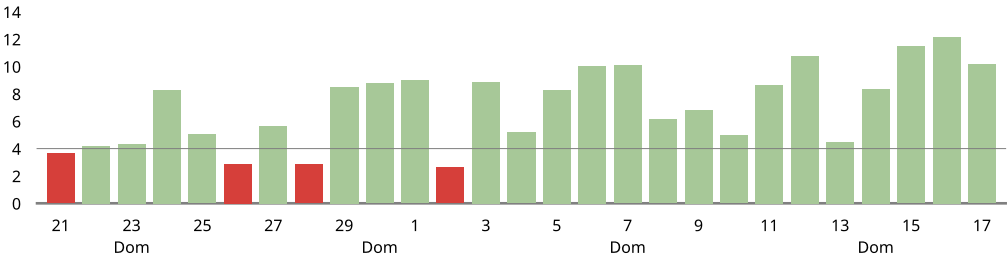


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881622


Utilização (horas)

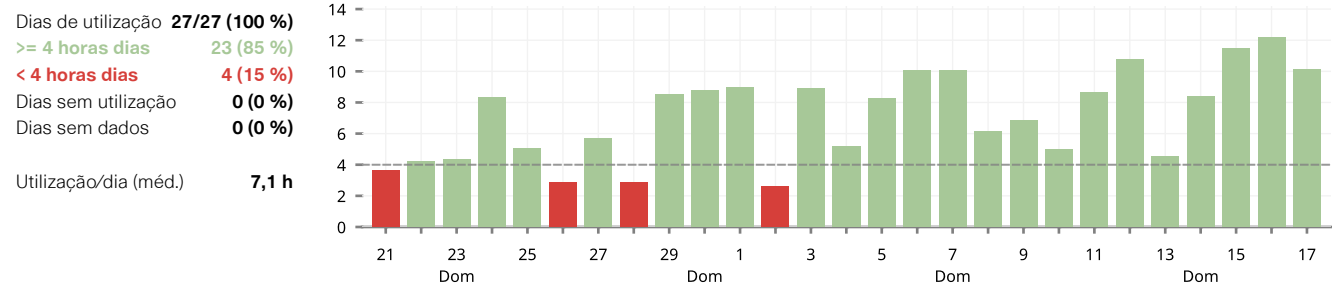

Fuga (l/min)

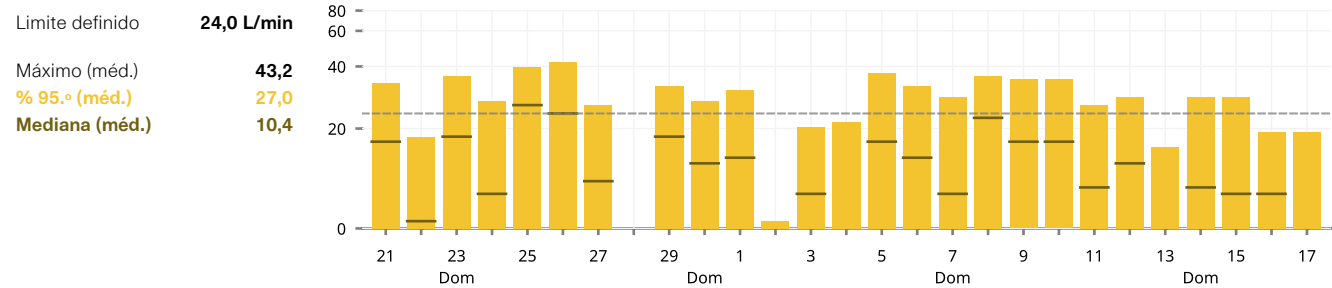

Pressão (cmH2O)

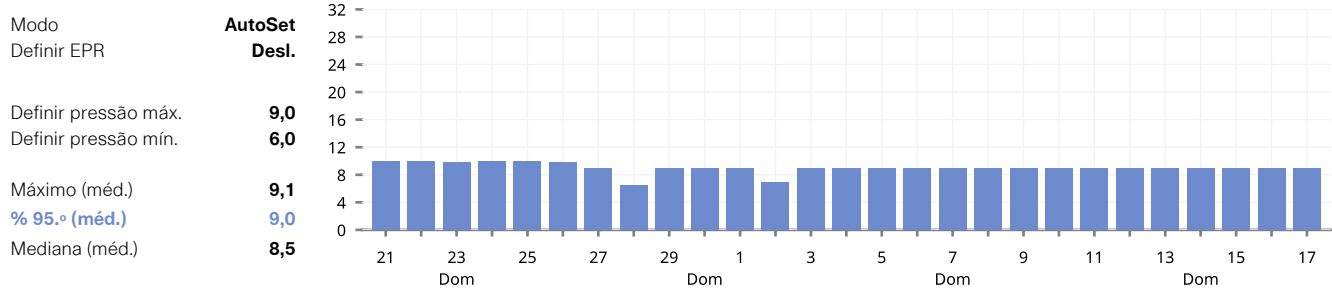

IAH (eventos/hora)

