


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		14/11/2025 - 16/11/2025
Dias de utilização	3/3 dias (100%)	
>= 4 horas	3 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	22 horas 14 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 25 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 25 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 10 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/11/2025)	1,268 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881622
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.7	Percentil 95.º: 9.8	Máximo: 9.9	
Fugas — l/min	Mediana: 16.8	Percentil 95.º: 37.6	Máximo: 71.6	
Eventos por hora	IA: 5.7	IH: 1.0	IAH: 6.7	
Índice de apneia	Central: 1.0	Obstrutiva: 2.7	Desconhecid	1.9
Índice RERA	1.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

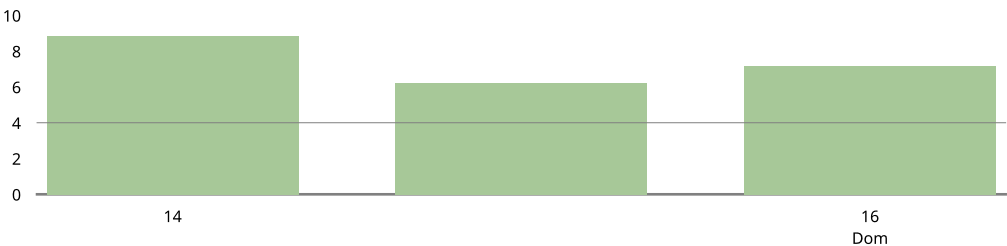

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881622

Utilização (horas)

Dias de utilização **3/3 (100 %)**
>= 4 horas dias **3 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **7,4 h**

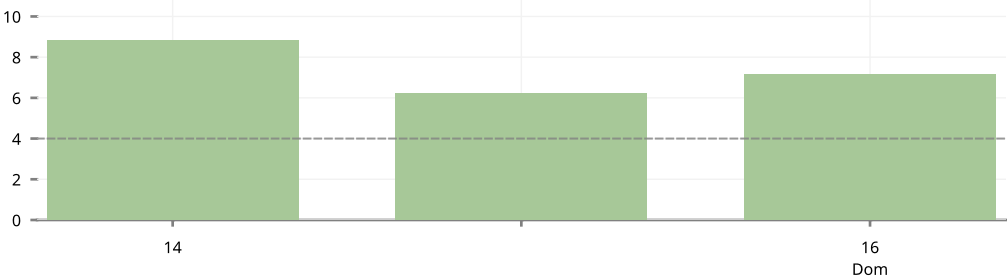

Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **71,6**
% 95.º (méd.) **37,6**
Mediana (méd.) **16,8**

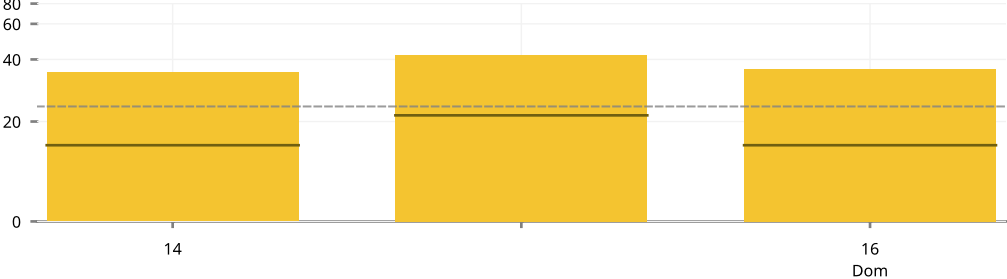


Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Desl.**

Definir pressão máx. **10,0**
Definir pressão mín. **4,0**

Máximo (méd.) **9,9**
% 95.º (méd.) **9,8**
Mediana (méd.) **8,7**

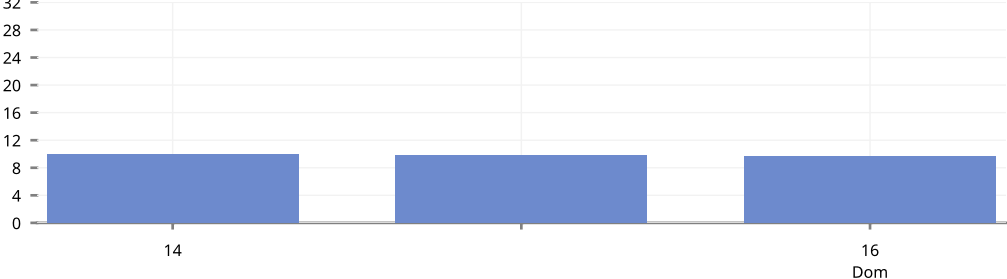

IAH (eventos/hora)

IAH **6.7**
IH **1.0**
IA **5.7**
IAC **1.0**
IAO **2.7**
IAD **1.9**
RERA **1.1**
%RCS (méd.) **0.0**

