

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. FABINIO PRADO**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **27 março 1972** Idade: **53**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **18/11/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas


18/11/2025 - 09/12/2025		Dispositivo: AutoSet II AMER (S/N: 20111560521)	
Parâmetros do dispositivo			
Modo de terapia: AutoSet	APE: SETTLE	Nível APE: 1,0 cmH20	
Pressão mínima: 6,0 cmH20			
Pressão - cmH20			
Mediana: 7,9	Percentil 95: 10,1	Máximo/a: 11,5	
Fuga - l/min			
Mediana: 0,0	Percentil 95: 7,2	Máximo/a: 18,0	
Índices respiratórios - eventos/hora			
Índice de apneia: 0,4	Índice de hipopneia: 4,4	AHI: 4,8	
% de tempo em apneia: 0,1			
Utilização Total			
Dias de Uso >= 4 horas : 22	Dias de Uso < 4 horas : 0	% Dias de Uso >= 4 horas : 100	
Dias de não utilização: 0	Totalidade de dias: 22	Horas de utilização: 159:44	
Mediana do uso diário: 7:05	Média de uso diário: 7:15		

Gráficos em sumário


18/11/2025 - 09/12/2025

Dispositivo: AutoSet II AMER (S/N: 20111560521)


Pressão

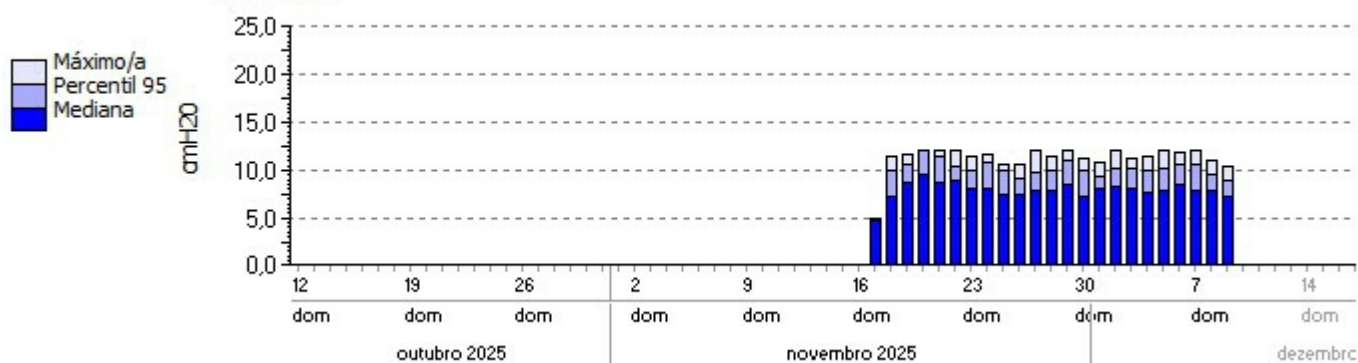


Fuga

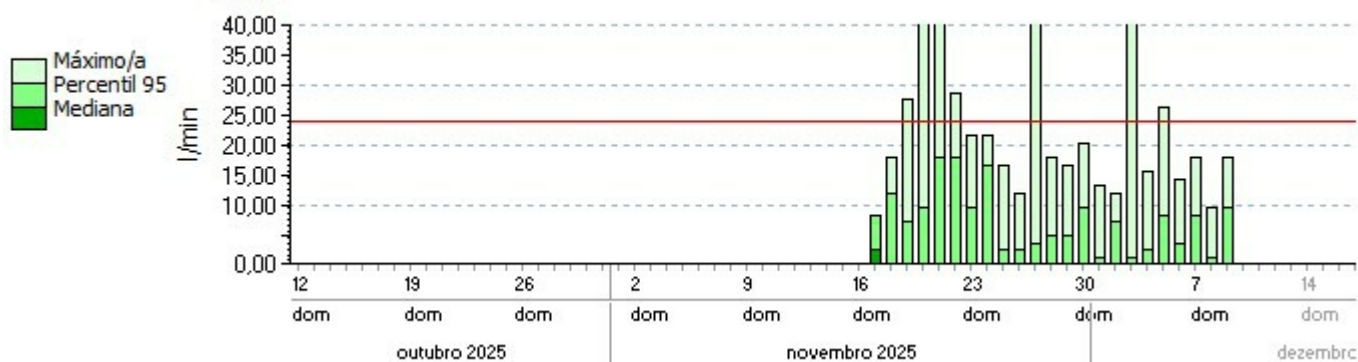

IAH & IA

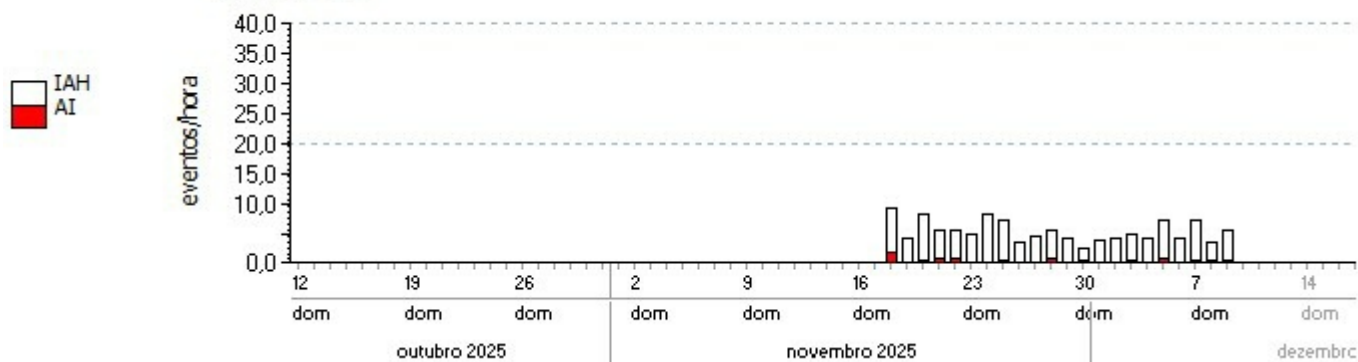

Uso

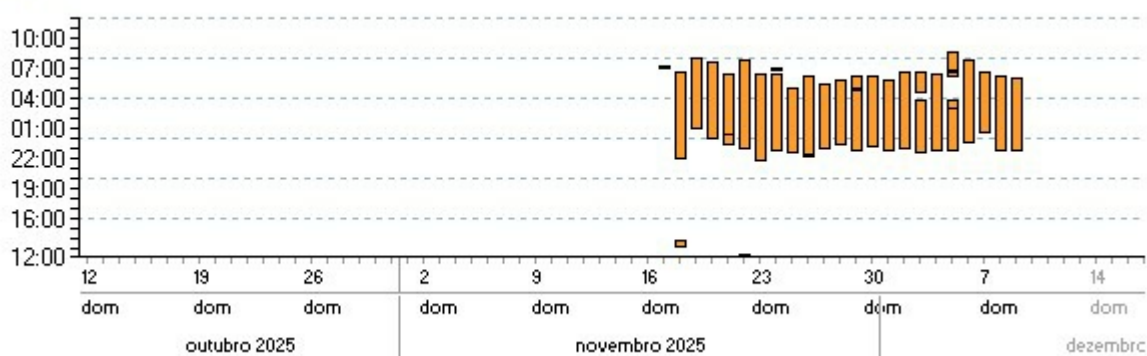

Utilização Total

