

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

27/10/2025 - 25/11/2025

Dias de utilização		27/30 dias (90%)	
>= 4 horas		19 dias (63%)	
< 4 horas		8 dias (27%)	
Horas de utilização		113 horas 30 minutos	
Utilização média (total de dias)		3 horas 47 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 12 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		4 horas 29 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/11/2025)		4,131 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22221549726	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		7 cmH2O	
Pressão máx.		8 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Suave	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 7.7	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 7.9
Fugas — l/min	Mediana: 1.2	Percentil 95.º: 17.5	Máximo: 23.5
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.2	IAH: 1.0
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.3		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização

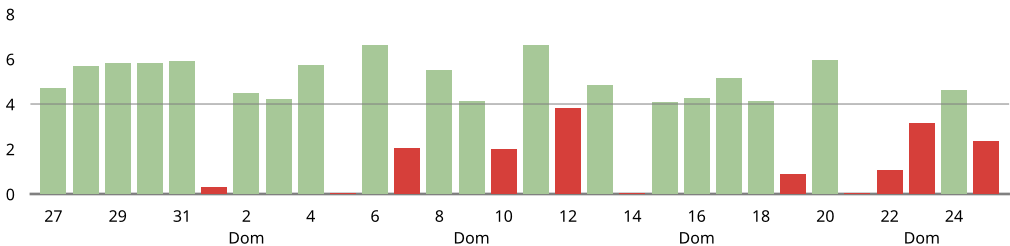


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549726


Utilização (horas)

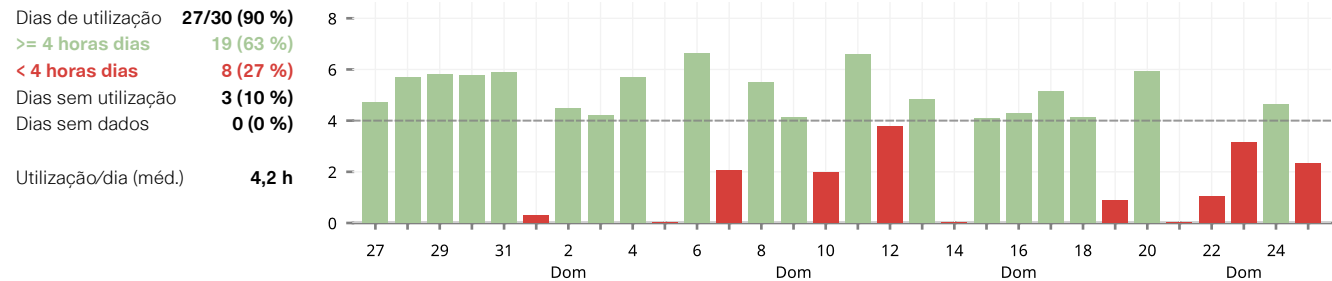

Fuga (l/min)

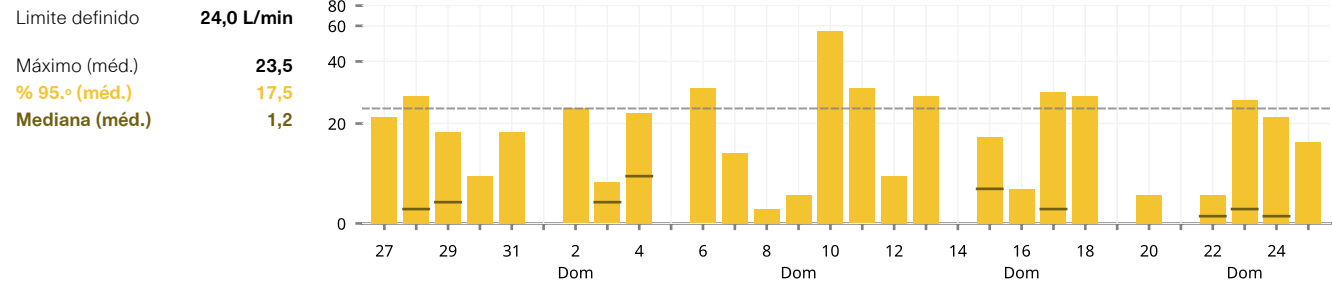

Pressão (cmH2O)

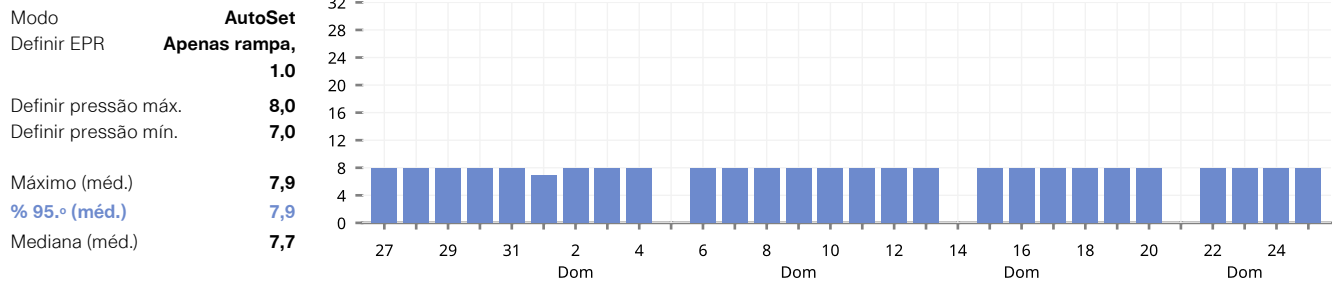

IAH (eventos/hora)

