

DADOS DO PACIENTE

Nome: JOAQUIM SEABRA Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 10 dez 1958 Sexo: —

Médico: — Telefone: —

Média de IAHL: **1,3** Média de Utilização (h:min): **6:27** Adesão Tto.*: **100 %**
* Últimos 30 Dias
% noites de utilização CPAP ≥4 horas a partir de 26 jan 2026

EQUIPAMENTOS

EM 24 fev 2026

Modelo: SleepStyle Auto Umidif.: 4,0
Nº de Série: 201228B7H Alívio Expiratório: Desligado
Modo: CPAP SensAwake: Desligado
Ajuste de Pressão: 8,0 cmH₂O



ADESÃO AO TRATAMENTO

PERÍODO DE 30 DIAS
26 jan 2026 - 24 fev 2026

INÍCIO DA TERAPIA
17 jun 2021 - 24 fev 2026

Total de Dias:

Utilização: 30 (100 %) 1689 (99 %)
Utilização ≥ 4 horas: 30 (100 %) 1683 (98 %)
Não Utilizado: 0 (0 %) 25 (1 %)

Média de Utilização (Dias em Terapia): 6:27 6:53
Média de Utilização (Todos os Dias): 6:27 6:47
Total Func.: 194:48 11685:06

EFICÁCIA**

IAH: 1,3 Duração das Apnéias: 11 s IAC: 0,0
Pressão: 8 cmH₂O Pressão de 90º Percentil: 8 cmH₂O À Pressão Máxima: 0 %
Vazamento do Sistema: 36 L/min Vazamento no 90º Percentil: 57 L/min Vazamento Alto: 15 %
Nº de Ativações do SensAwake: 0 por noite SensAwake Ligado: 0 %


AMBIENTE

Temperatura Ambiente: 26 °C

UTILIZAÇÃO

Horas

Média: 6:27
Dias de Utilização: 100 %
Total Func.
Total de Utilização
Utilização <4 h
Umídif.

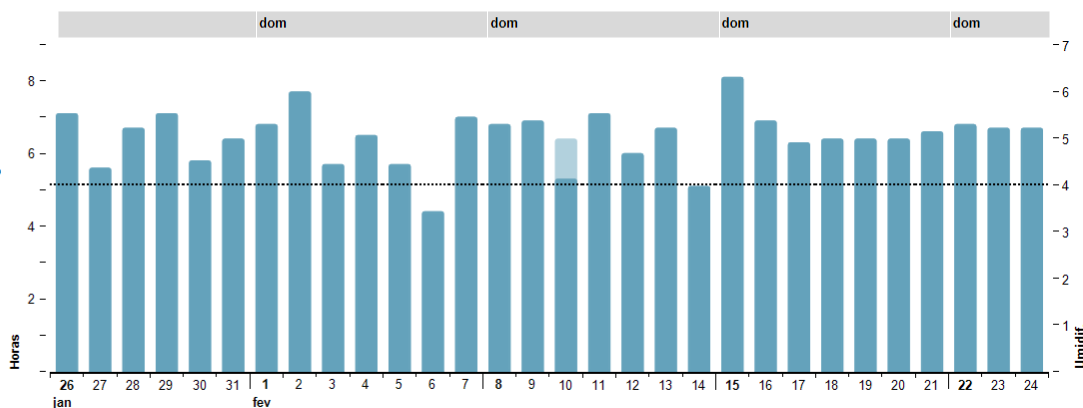

DADOS DO PACIENTE

Nome: JOAQUIM SEABRA Telefone: —
 Identificação Paciente: — E-mail: —
 Data de Nascimento: 10 dez 1958 Sexo: —


IAH

Eventos por hora

IAH: 1,3
 IAC: 0,0
 IAO: 0,0
 IH: 1,3

IAH Total

IAH = 5

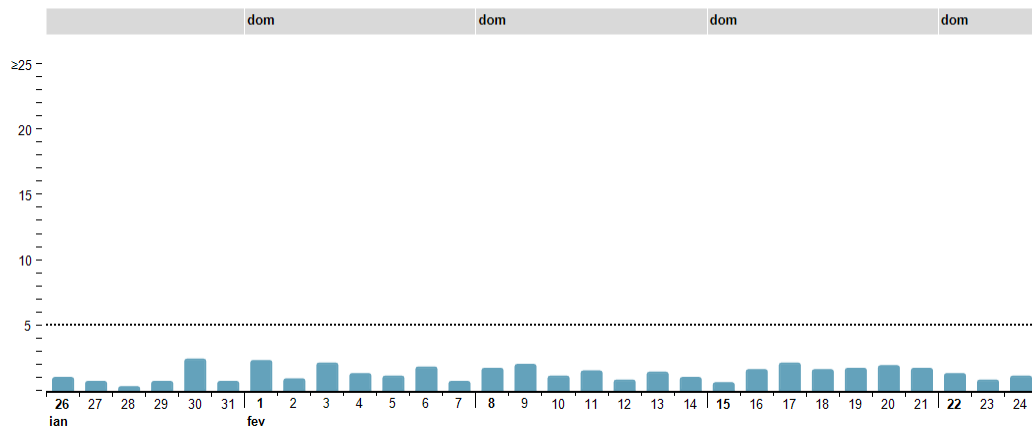

PRESSÃO


cmH₂O

Média: 8,0
 90º Percentil: 8,0

Média

90º Percentil

Pressão Máxima Atingida

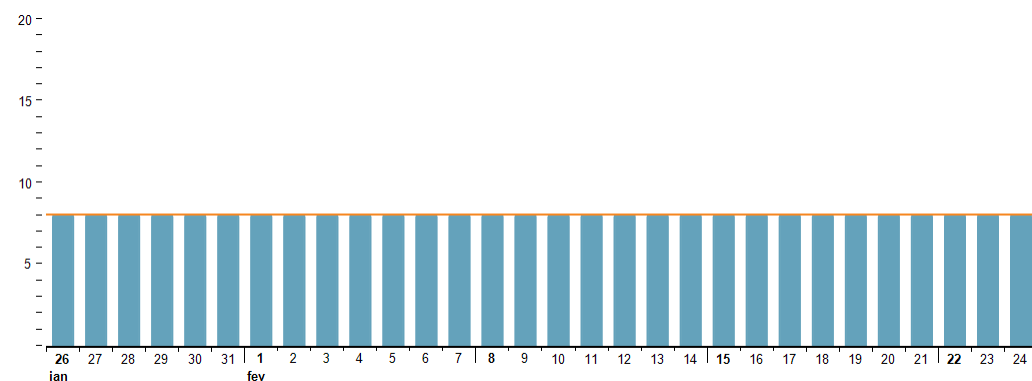

VAZAMENTO SIST.


l/min

Média: 36
 90º Percentil: 57

Média

90º Percentil

Vazamento Alto

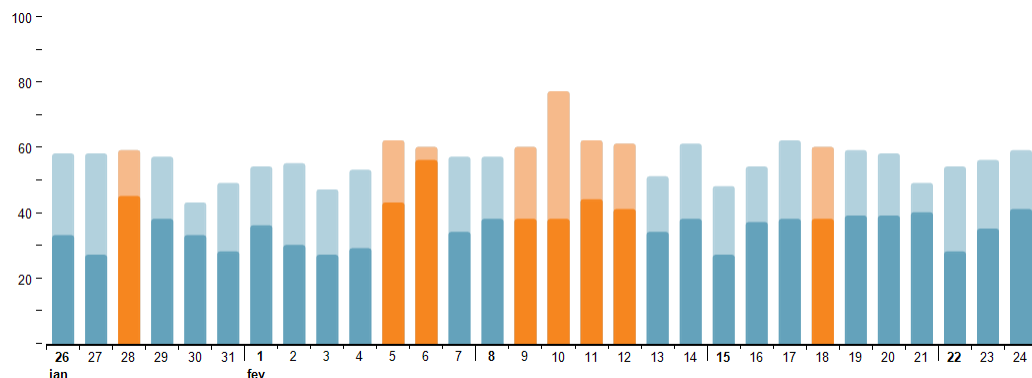

UTILIZAÇÃO

Horas


Média: 6:27
 Dias de Utilização: 100 %

Total Func.

Total de Utilização

Utilização <4 h


Umidif.

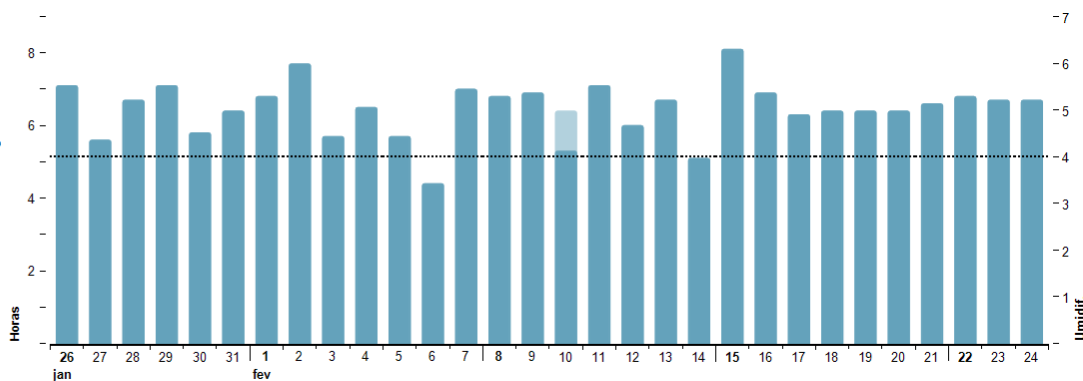

RESUMO DA ADESÃO AO TRATAMENTO

Nome:	JOAQUIM SEABRA	Telefone:	—
Identificação Paciente:	—	E-mail:	—
Data de Nascimento:	10 dez 1958	Sexo:	—

Histórico de Prescrições

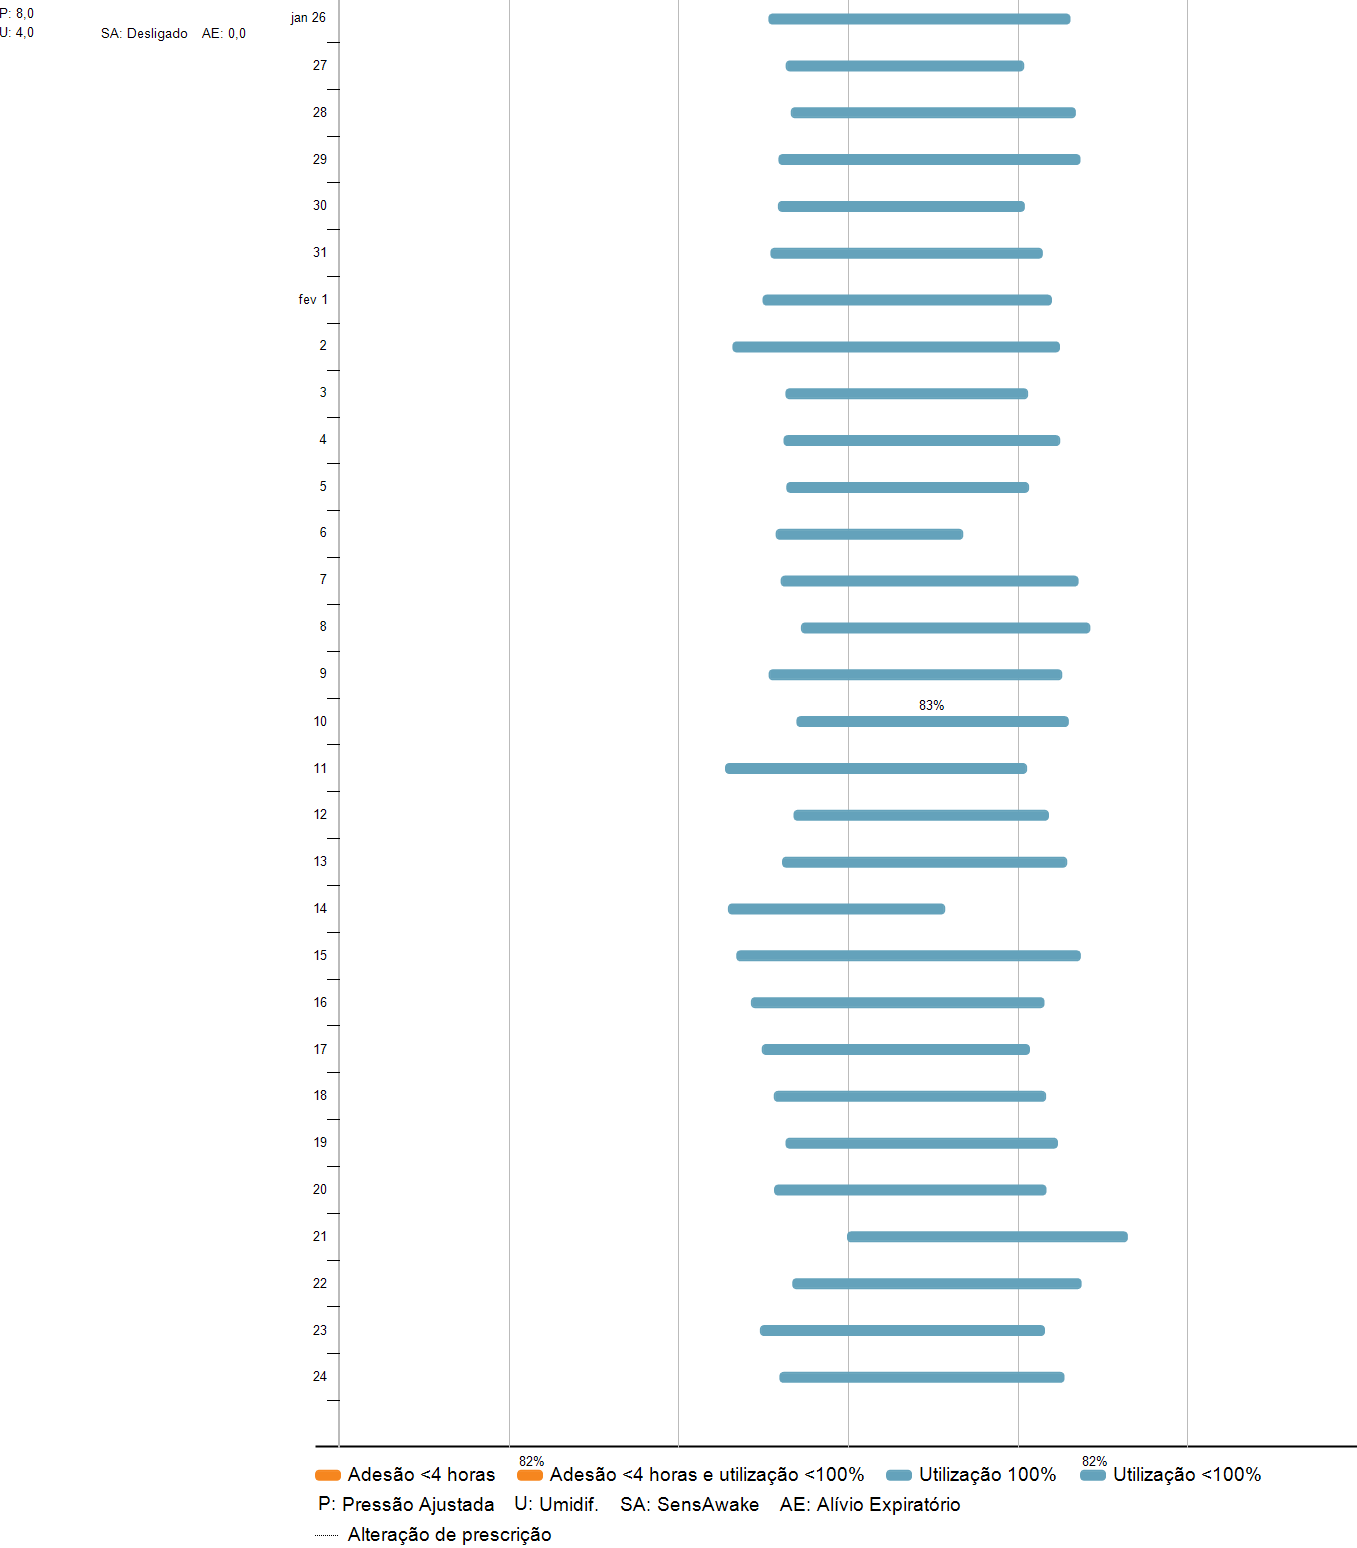

ANÁLISE DE 30 DIAS

Nome: JOAQUIM SEABRA Telefone: —
Identificação Paciente: — E-mail: —
Data de Nascimento: 10 dez 1958 Sexo: —

Data	Modo	Pressão Ajustada (cmH ₂ O)	Umidif.	Ativações da Rampa	Tempo Func. (h:min)	Tempo de Utilização (h:min)	IAH	IAC	Ativações do SensAwake	Pressão do SensAwake (cmH ₂ O)	Alívio Expiratório	Pressão de 90º Percentil (cmH ₂ O)	Pressão Máx Atingida (cmH ₂ O)	Vazamento no 90º Percentil (L/min)
26 jan 2026	CPAP	8,0	4,0	0	7:06	7:06	1,0	0,0	----	----	Desligado	----	----	58
27 jan 2026	CPAP	8,0	4,0	0	5:36	5:36	0,7	0,0	----	----	Desligado	----	----	58
28 jan 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:42	6:42	0,3	0,0	----	----	Desligado	----	----	59
29 jan 2026	CPAP	8,0	4,0	0	7:06	7:06	0,7	0,0	----	----	Desligado	----	----	57
30 jan 2026	CPAP	8,0	4,0	0	5:48	5:48	2,4	0,0	----	----	Desligado	----	----	43
31 jan 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:24	6:24	0,7	0,2	----	----	Desligado	----	----	49
01 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:48	6:48	2,3	0,0	----	----	Desligado	----	----	54
02 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	7:42	7:42	0,9	0,0	----	----	Desligado	----	----	55
03 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	5:42	5:42	2,1	0,0	----	----	Desligado	----	----	47
04 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:30	6:30	1,3	0,0	----	----	Desligado	----	----	53
05 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	5:42	5:42	1,1	0,0	----	----	Desligado	----	----	62
06 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	4:24	4:24	1,8	0,0	----	----	Desligado	----	----	60
07 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	7:00	7:00	0,7	0,0	----	----	Desligado	----	----	57
08 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:48	6:48	1,7	0,0	----	----	Desligado	----	----	57
09 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:54	6:54	2,0	0,0	----	----	Desligado	----	----	60
10 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:24	5:18	1,1	0,0	----	----	Desligado	----	----	77
11 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	7:06	7:06	1,5	0,0	----	----	Desligado	----	----	62
12 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:00	6:00	0,8	0,0	----	----	Desligado	----	----	61
13 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:42	6:42	1,4	0,1	----	----	Desligado	----	----	51
14 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	5:06	5:06	1,0	0,0	----	----	Desligado	----	----	61
15 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	8:06	8:06	0,6	0,0	----	----	Desligado	----	----	48
16 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:54	6:54	1,6	0,0	----	----	Desligado	----	----	54
17 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:18	6:18	2,1	0,0	----	----	Desligado	----	----	62
18 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:24	6:24	1,6	0,0	----	----	Desligado	----	----	60
19 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:24	6:24	1,7	0,0	----	----	Desligado	----	----	59
20 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:24	6:24	1,9	0,0	----	----	Desligado	----	----	58
21 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:36	6:36	1,7	0,0	----	----	Desligado	----	----	49
22 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:48	6:48	1,3	0,0	----	----	Desligado	----	----	54
23 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:42	6:42	0,8	0,0	----	----	Desligado	----	----	56
24 fev 2026	CPAP	8,0	4,0	0	6:42	6:42	1,1	0,0	----	----	Desligado	----	----	59