


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/11/2025 - 08/12/2025
Dias de utilização	24/24 dias (100%)	
>= 4 horas	24 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	255 horas 53 minutos	
Utilização média (total de dias)	10 horas 40 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	10 horas 40 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	11 horas 4 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/12/2025)	701 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260594
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.2	Percentil 95.º: 8.8	Máximo: 9.7	
Fugas — l/min	Mediana: 0.2	Percentil 95.º: 10.9	Máximo: 41.5	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.1	IAH: 0.9	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

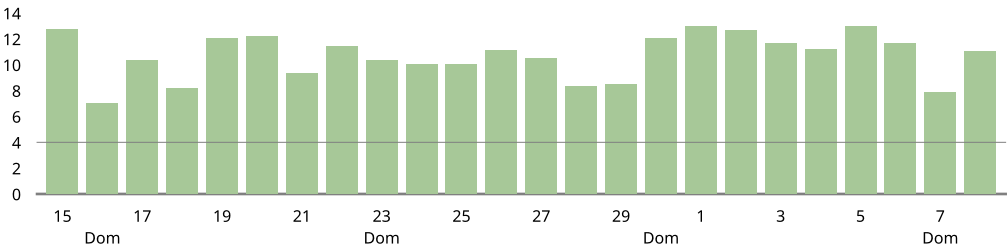


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260594


Utilização (horas)

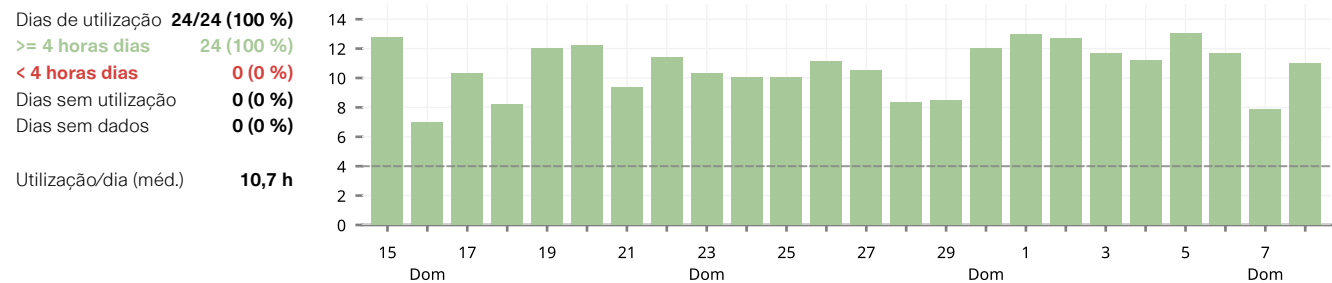

Fuga (l/min)

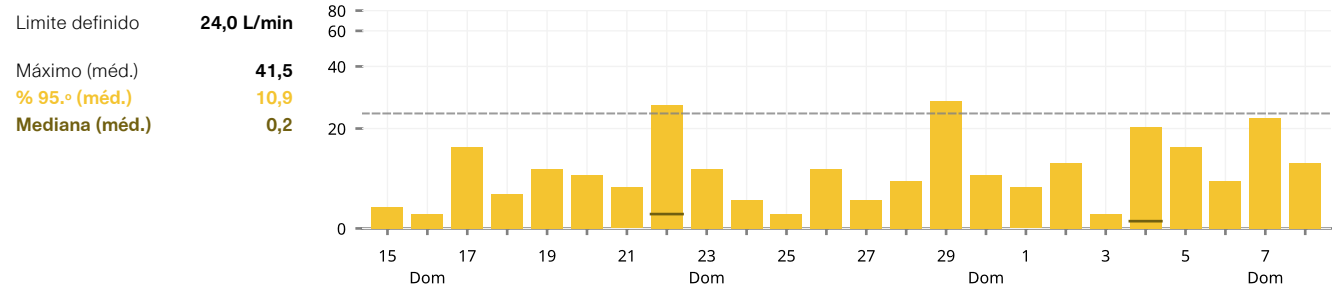

Pressão (cmH2O)

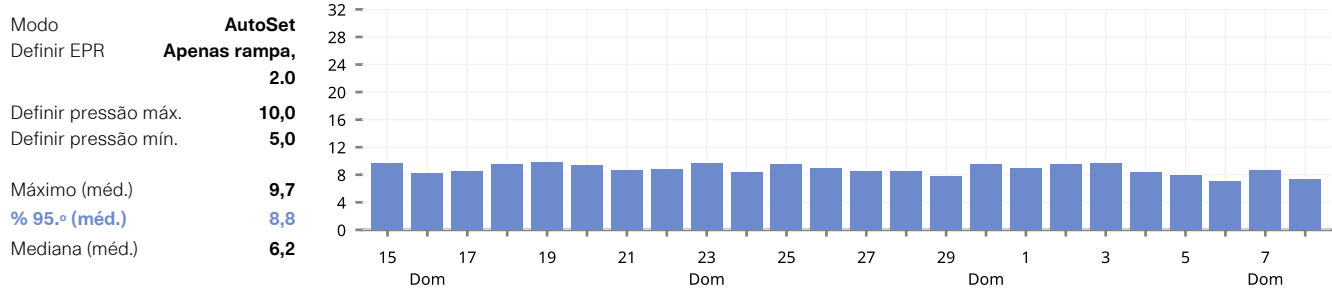

IAH (eventos/hora)

