


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/11/2025 - 07/12/2025
Dias de utilização	12/13 dias (92%)	
>= 4 horas	11 dias (85%)	
< 4 horas	1 dias (8%)	
Horas de utilização	81 horas 45 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 17 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 49 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 39 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/12/2025)	2,603 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292555
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.8	Percentil 95.º: 8.8	Máximo: 9.6	
Fugas — l/min	Mediana: 11.9	Percentil 95.º: 21.3	Máximo: 30.9	
Eventos por hora	IA: 0.9	IH: 1.5	IAH: 2.4	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

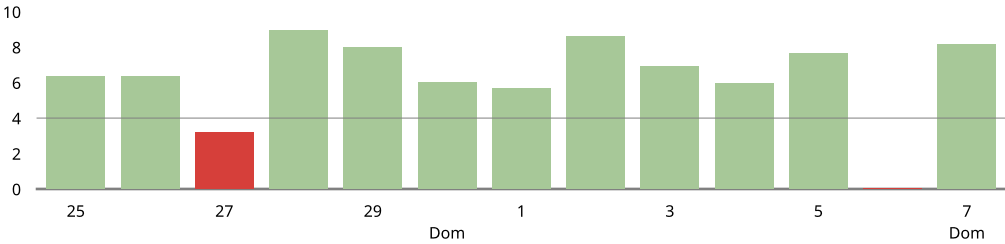


Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292555

Utilização (horas)

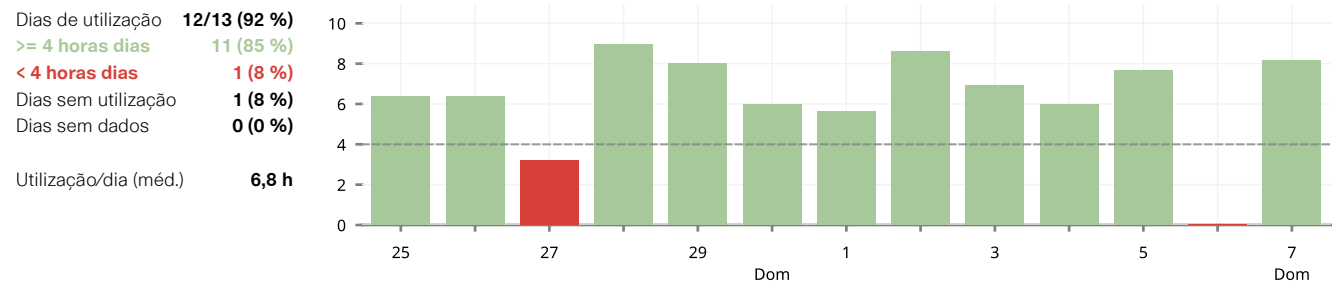

Fuga (l/min)

