


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		11/12/2025 - 04/01/2026
Dias de utilização	25/25 dias (100%)	
>= 4 horas	25 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	162 horas 48 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 31 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 35 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/01/2026)	2,457 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882350
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.0	Percentil 95.º: 7.2	Máximo: 7.7	
Fugas — l/min	Mediana: 4.2	Percentil 95.º: 15.7	Máximo: 77.8	
Eventos por hora	IA: 1.4	IH: 0.3	IAH: 1.7	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.9
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

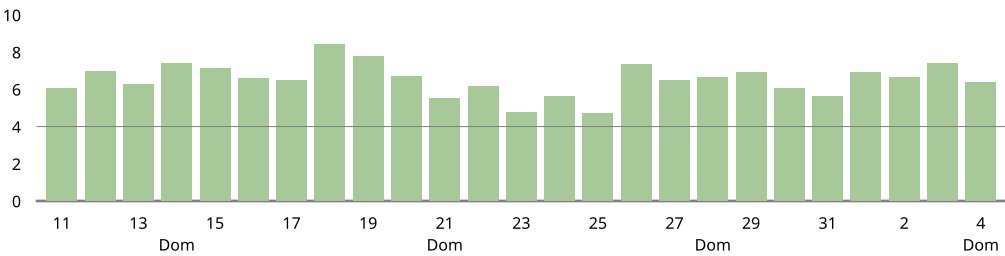


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882350


Utilização (horas)

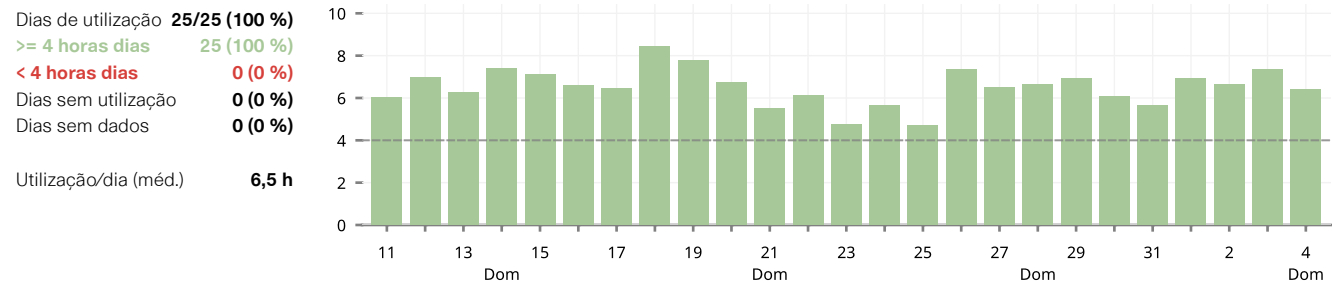

Fuga (l/min)

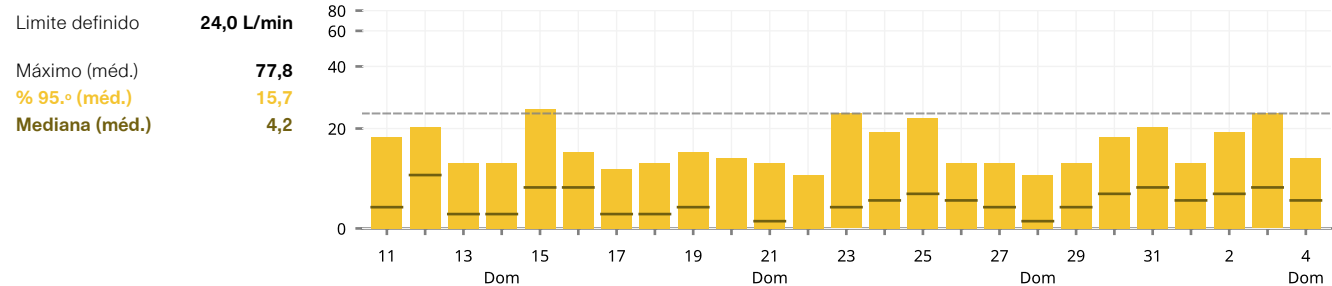

Pressão (cmH2O)

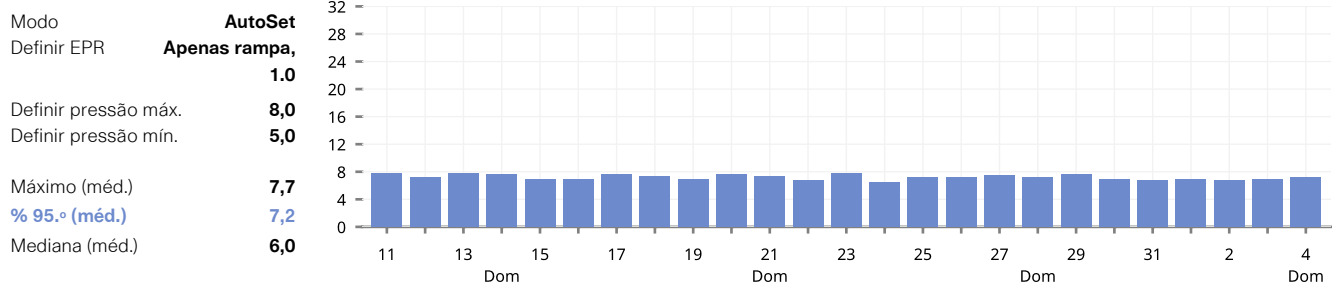

IAH (eventos/hora)

