


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		27/11/2025 - 02/12/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (83%)	
< 4 horas	1 dias (17%)	
Horas de utilização	29 horas 1 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 50 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 50 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 55 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/12/2025)	29 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260584
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.7	Percentil 95.º: 7.8	Máximo: 9.1	
Fugas — l/min	Mediana: 2.4	Percentil 95.º: 15.6	Máximo: 28.8	
Eventos por hora	IA: 8.9	IH: 0.8	IAH: 9.7	
Índice de apneia	Central: 6.3	Obstrutiva: 1.7	Desconhecid	0.8
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

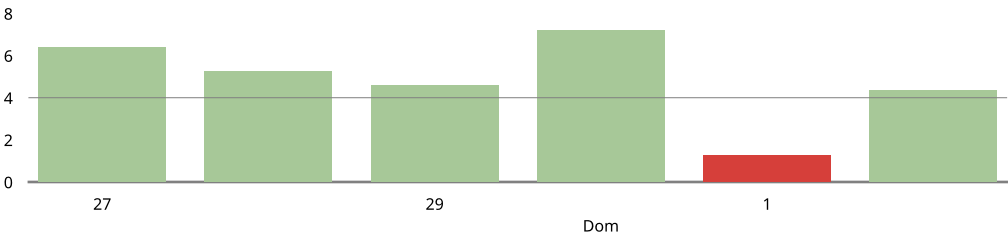


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260584


Utilização (horas)

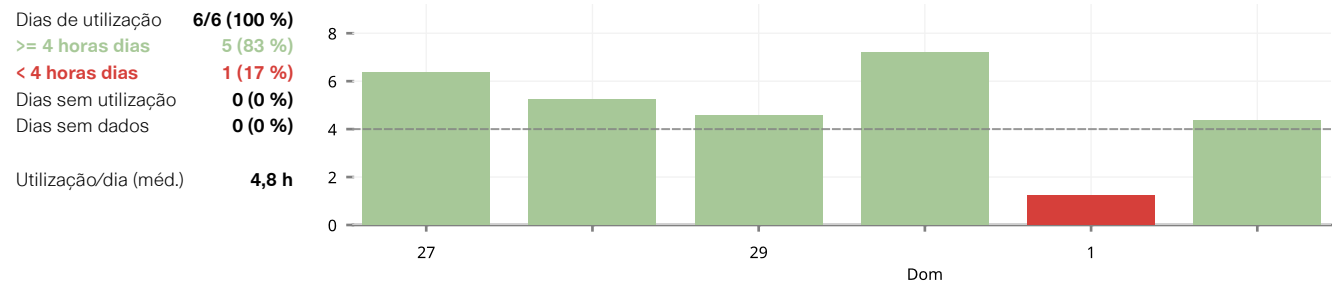

Fuga (l/min)

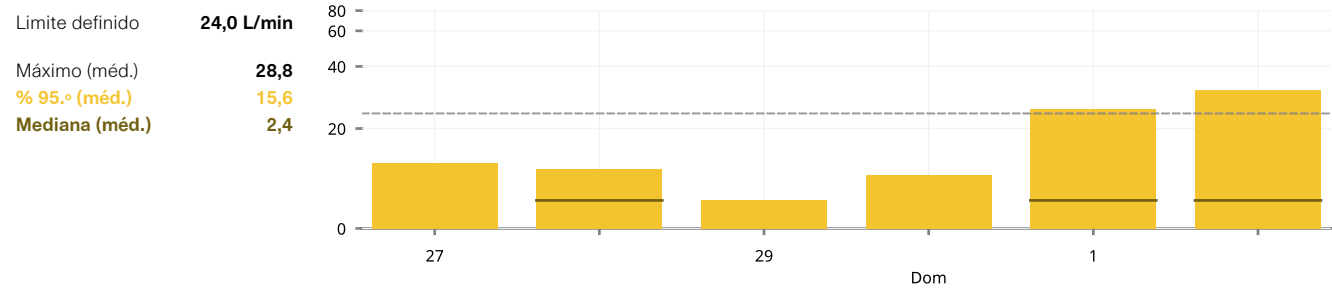

Pressão (cmH2O)

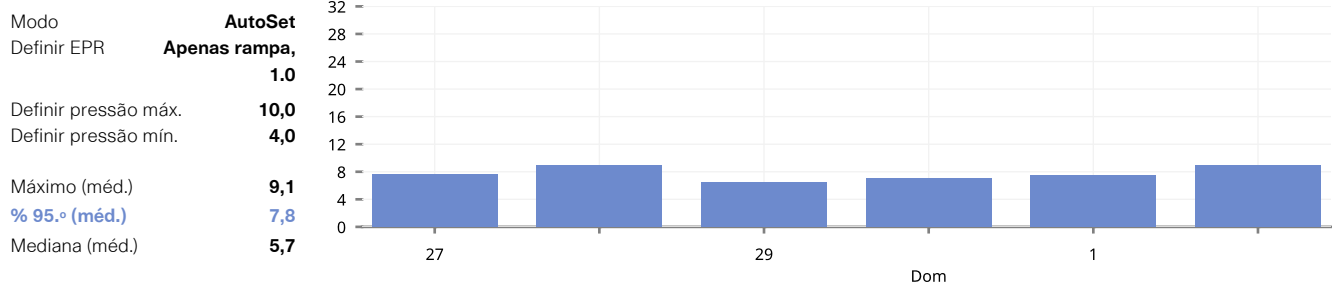

IAH (eventos/hora)

