


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/12/2025 - 07/12/2025
Dias de utilização		3/4 dias (75%)
>= 4 horas		3 dias (75%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		19 horas 42 minutos
Utilização média (total de dias)		4 horas 56 minutos
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 34 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 41 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/12/2025)		51 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260584
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.6	Percentil 95.º: 7.8	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 2.8	Percentil 95.º: 20.0	Máximo: 40.8	
Eventos por hora	IA: 3.3	IH: 0.8	IAH: 4.1	
Índice de apneia	Central: 1.7	Obstrutiva: 1.4	Desconhecid	0.1
Índice RERA				0.1
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

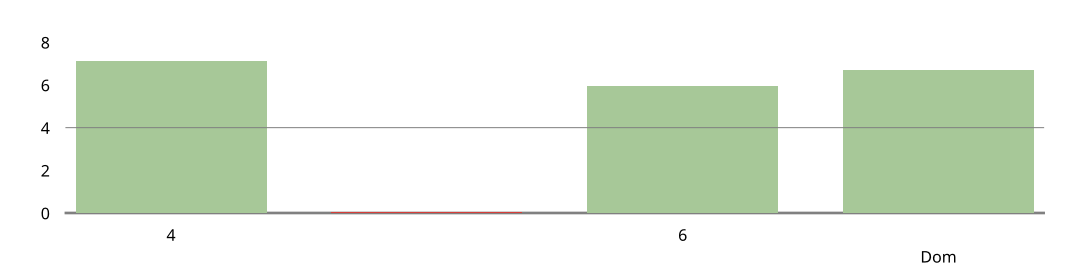


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260584


Utilização (horas)

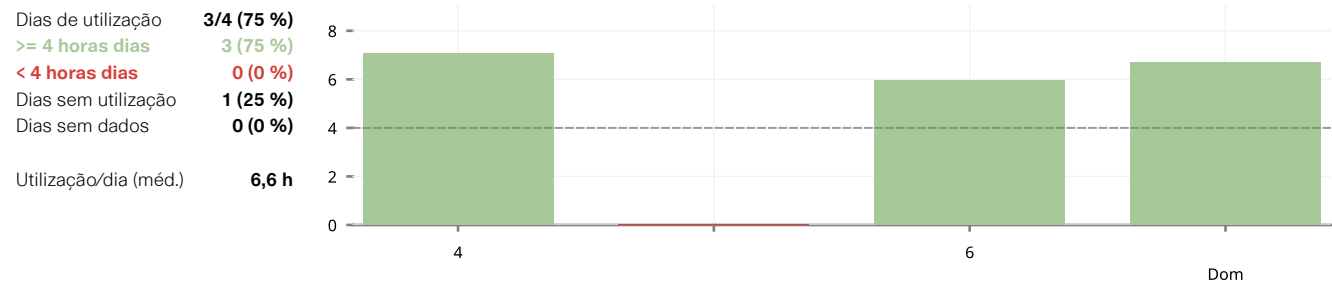

Fuga (l/min)

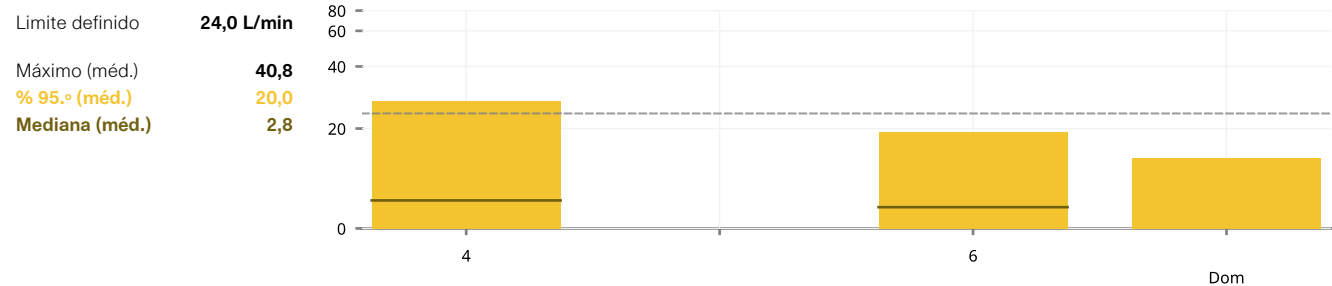

Pressão (cmH2O)

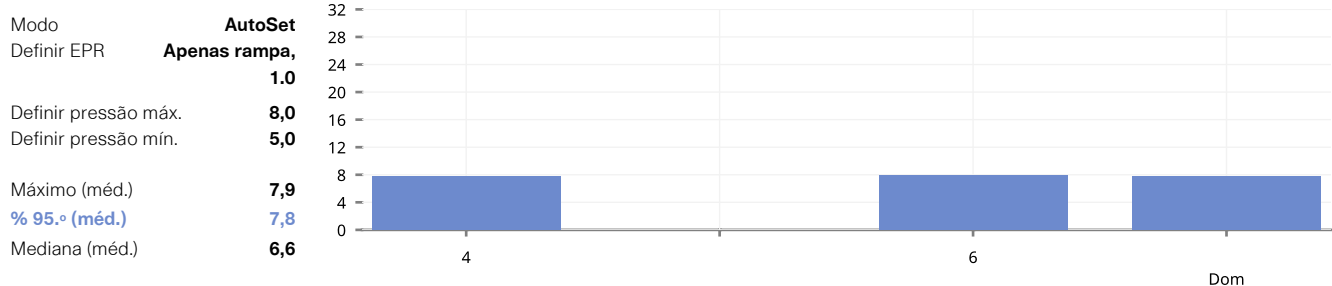

IAH (eventos/hora)

