


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		29/11/2025 - 01/12/2025
Dias de utilização		3/3 dias (100%)
>= 4 horas		3 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		24 horas 1 minutos
Utilização média (total de dias)		8 horas 0 minutos
Utilização média (dias de utilização)		8 horas 0 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 35 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 01/12/2025)		4,122 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292587
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	13 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 11.0	Percentil 95.º: 12.8	Máximo: 13.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 0.0	Máximo: 4.4	
Eventos por hora	IA: 7.5	IH: 0.4	IAH: 7.9	
Índice de apneia	Central: 1.9	Obstrutiva: 5.6	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.5
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

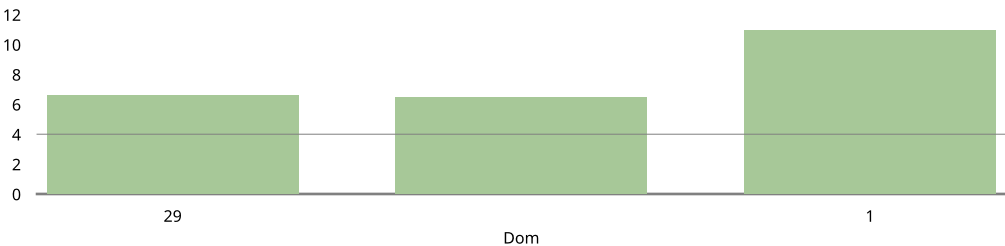


Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292587


Utilização (horas)

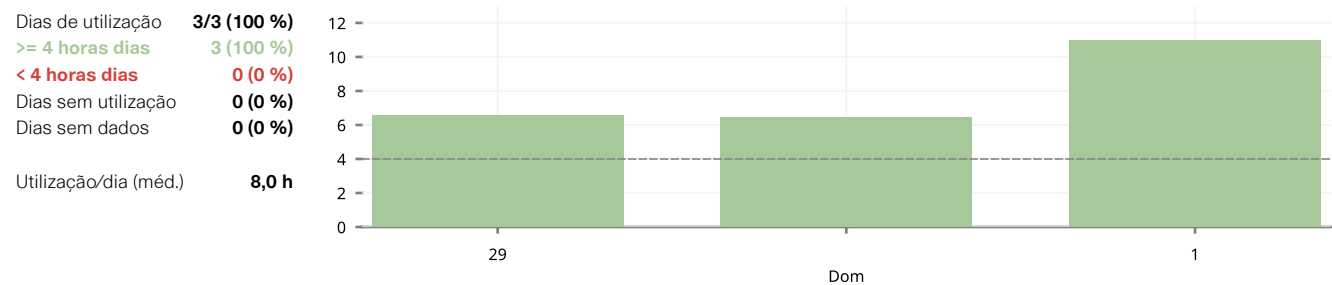

Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)

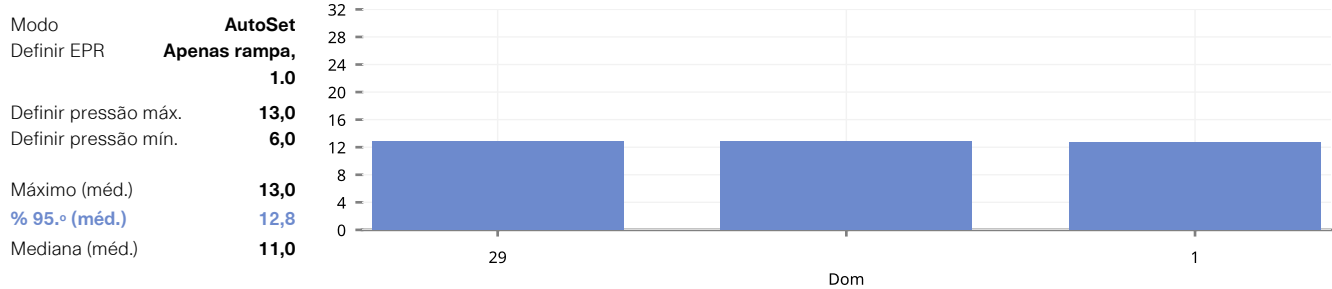

IAH (eventos/hora)

