

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. MARCIO JOSE DE CARVSLHO**
Identificação do paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **15 julho 1978** Idade: **47**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **19/12/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

12/12/2025 - 18/12/2025		Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22222292587)	
Parâmetros do dispositivo			
Modo de terapia: CPAP	Pressão programada: 11,0 cmH20	APE: RAMP_ONLY	
Nível APE: 1,0 cmH20	Activar APE: ON	Activação paciente APE: ON	
Activação subida: ON	Tempo de rampa: 5,0 Minutos	Acesso: LIGADO	
Fuga - l/min			
Mediana: 0,0	Percentil 95: 0,0	Máximo/a: 3,6	
Índices respiratórios - eventos/hora			
Índice de apneia: 4,4	Índice de hipopneia: 0,7	AHI: 5,1	
Obstrutiva: 3,0	Central: 1,4	Desconhecida: 0,0	
Índice RERA: 0,5	% tempo em CSR: 0,0		
Utilização Total			
Dias de Uso >= 4 horas : 7	Dias de Uso < 4 horas : 0	% Dias de Uso >= 4 horas : 100	
Dias de não utilização: 0	Totalidade de dias: 7	Horas de utilização: 56:00	
Mediana do uso diário: 8:21	Média de uso diário: 8:00		


Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário


12/12/2025 - 18/12/2025

Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 2222292587)


Pressão

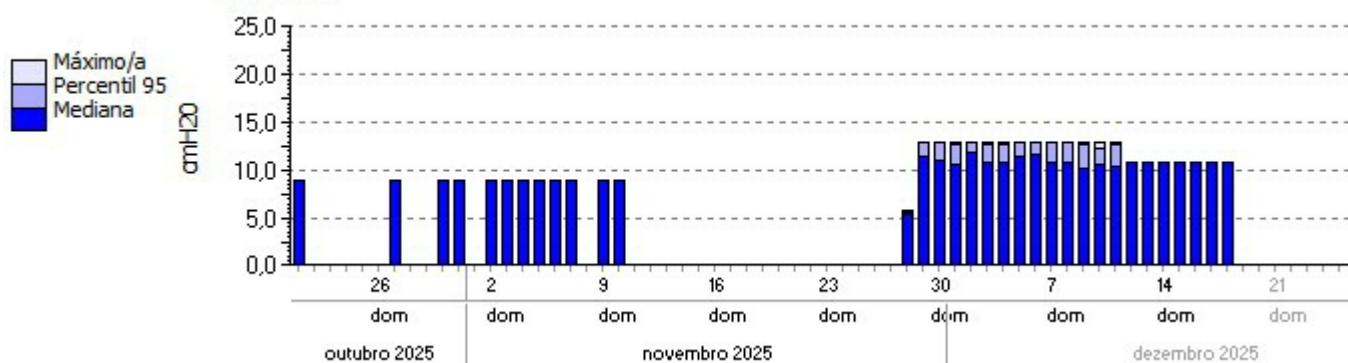


Fuga

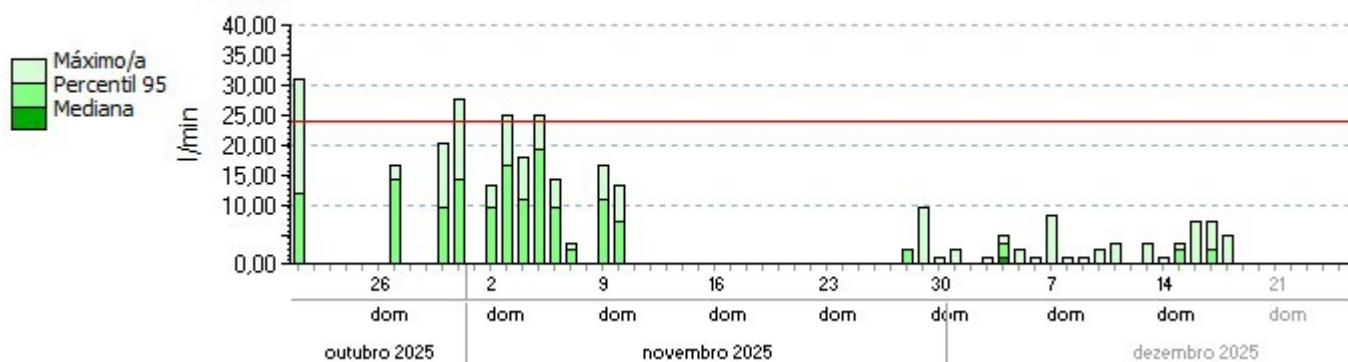

IAH & IA

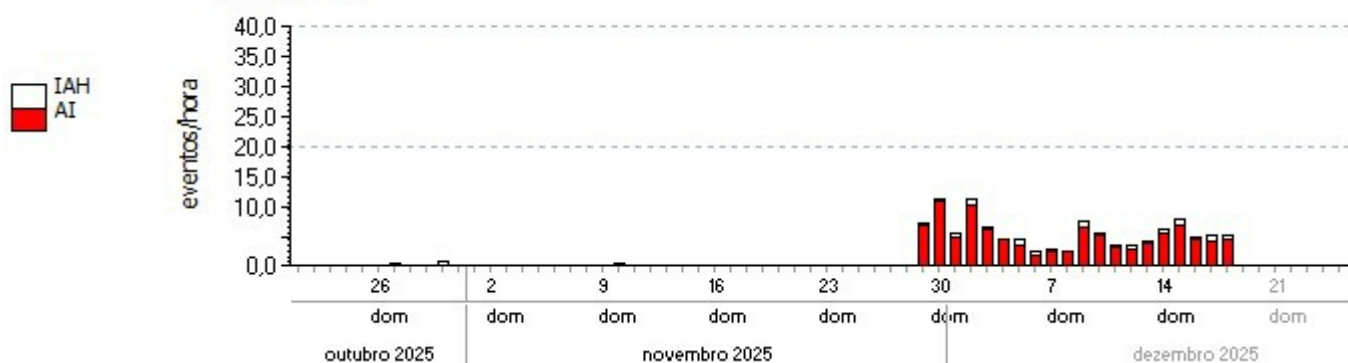

Uso

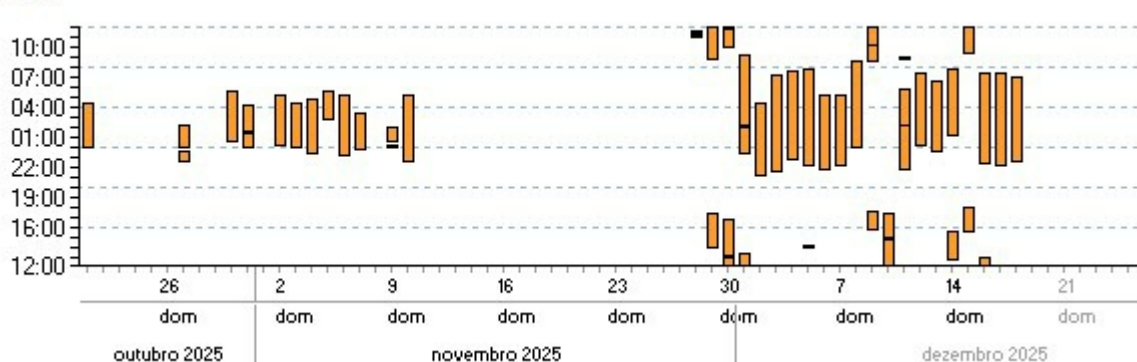

Utilização total e Cheyne-Stokes

