


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		14/02/2026 - 15/03/2026
Dias de utilização	21/30 dias (70%)	
>= 4 horas	19 dias (63%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	147 horas 13 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 54 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 1 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 37 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/03/2026)	6,597 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221830366
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.7	Percentil 95.º: 7.0	Máximo: 7.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 3.2	Máximo: 11.6	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.8	IAH: 1.6	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

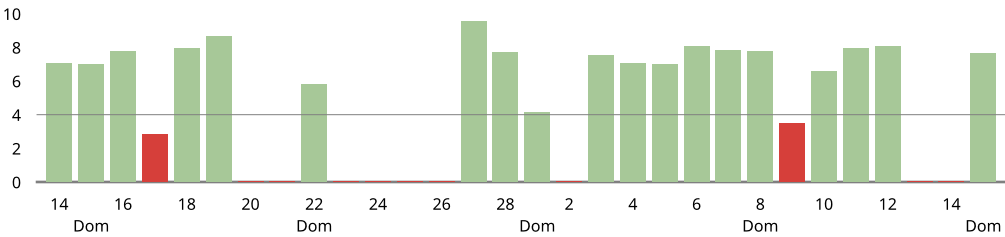


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221830366


Utilização (horas)

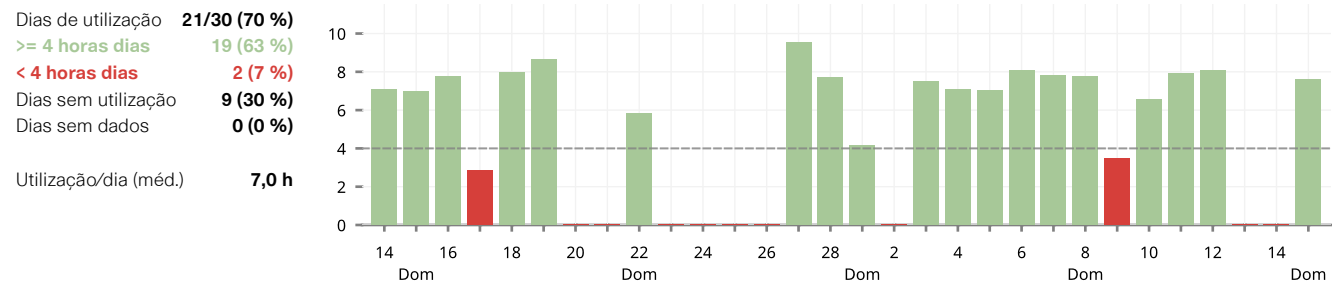

Fuga (l/min)

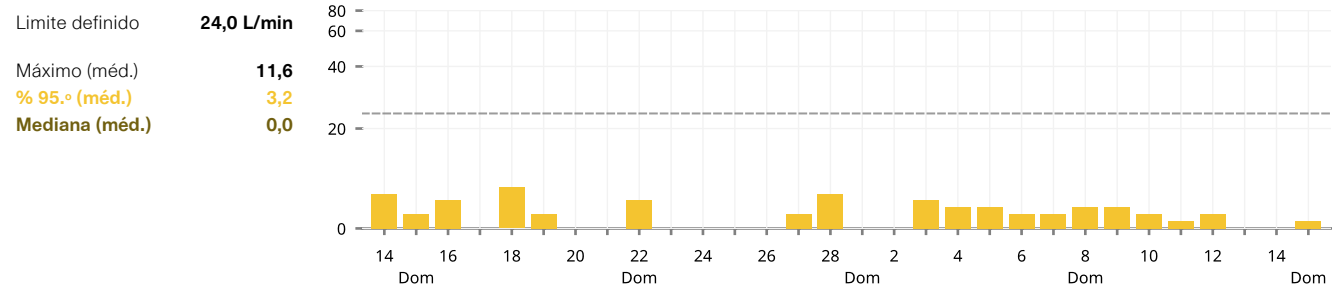

Pressão (cmH2O)

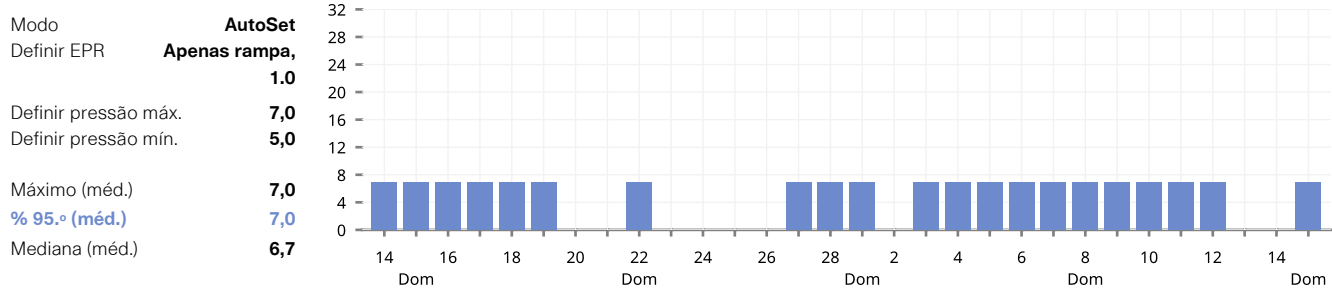

IAH (eventos/hora)

