

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

26/01/2026 - 09/02/2026

Dias de utilização	15/15 dias (100%)
>= 4 horas	2 dias (13%)
< 4 horas	13 dias (87%)
Horas de utilização	41 horas 56 minutos
Utilização média (total de dias)	2 horas 48 minutos
Utilização média (dias de utilização)	2 horas 48 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 21 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 09/02/2026)	4,592 horas


AirSense 10 AutoSet

Número de série	22201153161
Modo	AutoSet
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 10.8	Percentil 95.º: 11.6	Máximo: 11.6
Fugas — l/min	Mediana: 17.2	Percentil 95.º: 27.8	Máximo: 52.7
Eventos por hora	IA: 14.7	IH: 0.1	IAH: 14.8
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 10.1	Desconhecid 4.3
Índice RERA	0.7		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)		

Horas de utilização

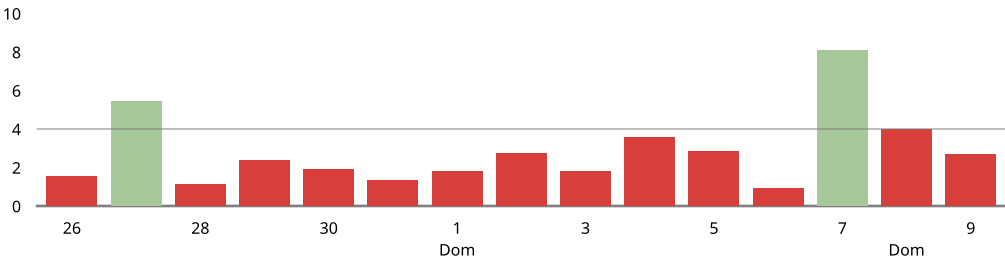


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22201153161


Utilização (horas)

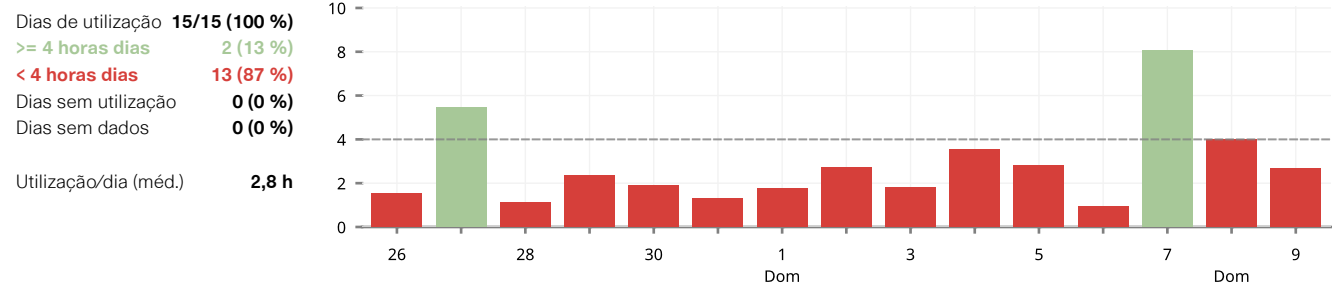

Fuga (l/min)

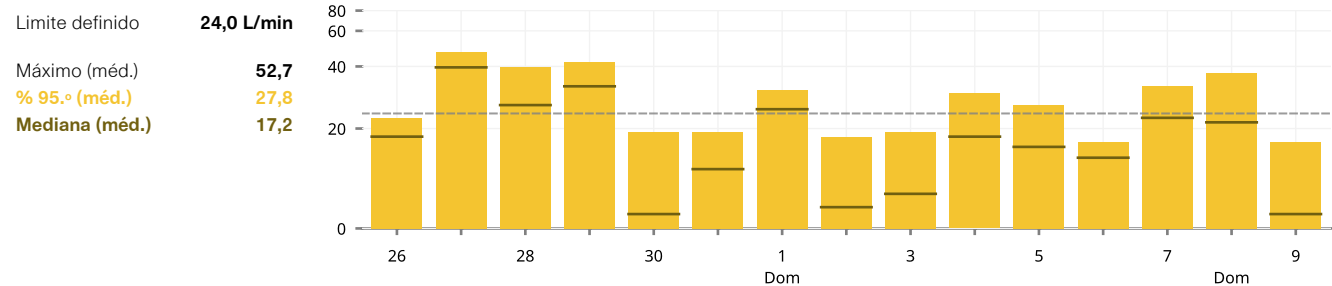

Pressão (cmH2O)

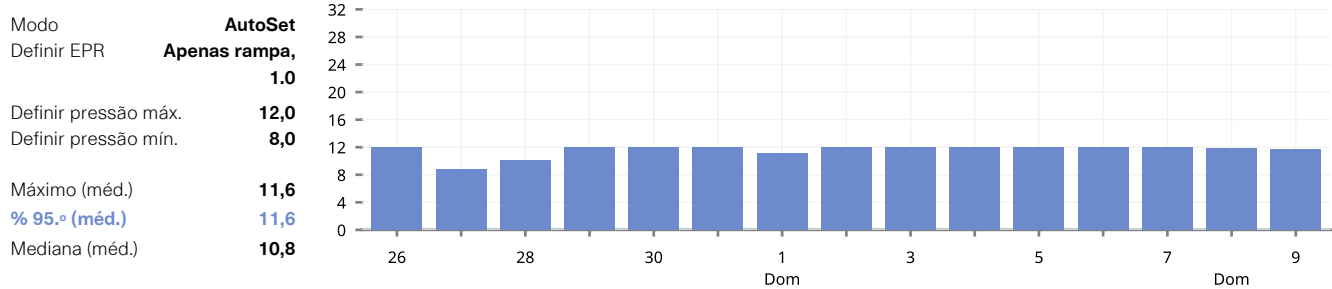

IAH (eventos/hora)

