

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. HELTON ALVES DE SOUSA**
Identificação do paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **26 dezembro 1980** Idade: **44**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **17/03/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
		Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados:	Não	

Estatísticas


11/11/2025 - 11/12/2025		Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 23222818271)	
Parâmetros do dispositivo			
Modo de terapia: AutoSet	APE: RAMP_ONLY	Nível APE: 2,0 cmH2O	
Activar APE: ON	Activação paciente APE: ON	Activação subida: OFF	
Tempo de rampa: 5,0 Minutos	Acesso: LIGADO	Resposta: SUAVE	
Pressão mínima: 6,0 cmH2O	Pressão máxima: 10,0 cmH2O		
Pressão - cmH2O			
Mediana: 9,6	Percentil 95: 10,0	Máximo/a: 10,0	
Fuga - l/min			
Mediana: 0,0	Percentil 95: 9,6	Máximo/a: 13,2	
Índices respiratórios - eventos/hora			
Índice de apneia: 0,4	Índice de hipopneia: 0,2	AHI: 0,6	
Obstrutiva: 0,4	Central: 0,0	Desconhecida: 0,0	
Índice RERA: 1,7	% tempo em CSR: 0,0		
Utilização Total			
Dias de Uso >= 4 horas : 30	Dias de Uso < 4 horas : 1	% Dias de Uso >= 4 horas : 96	
Dias de não utilização: 0	Totalidade de dias: 31	Horas de utilização: 183:22	
Mediana do uso diário: 5:40	Média de uso diário: 5:54		

Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário

11/11/2025 - 11/12/2025

Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 23222818271)

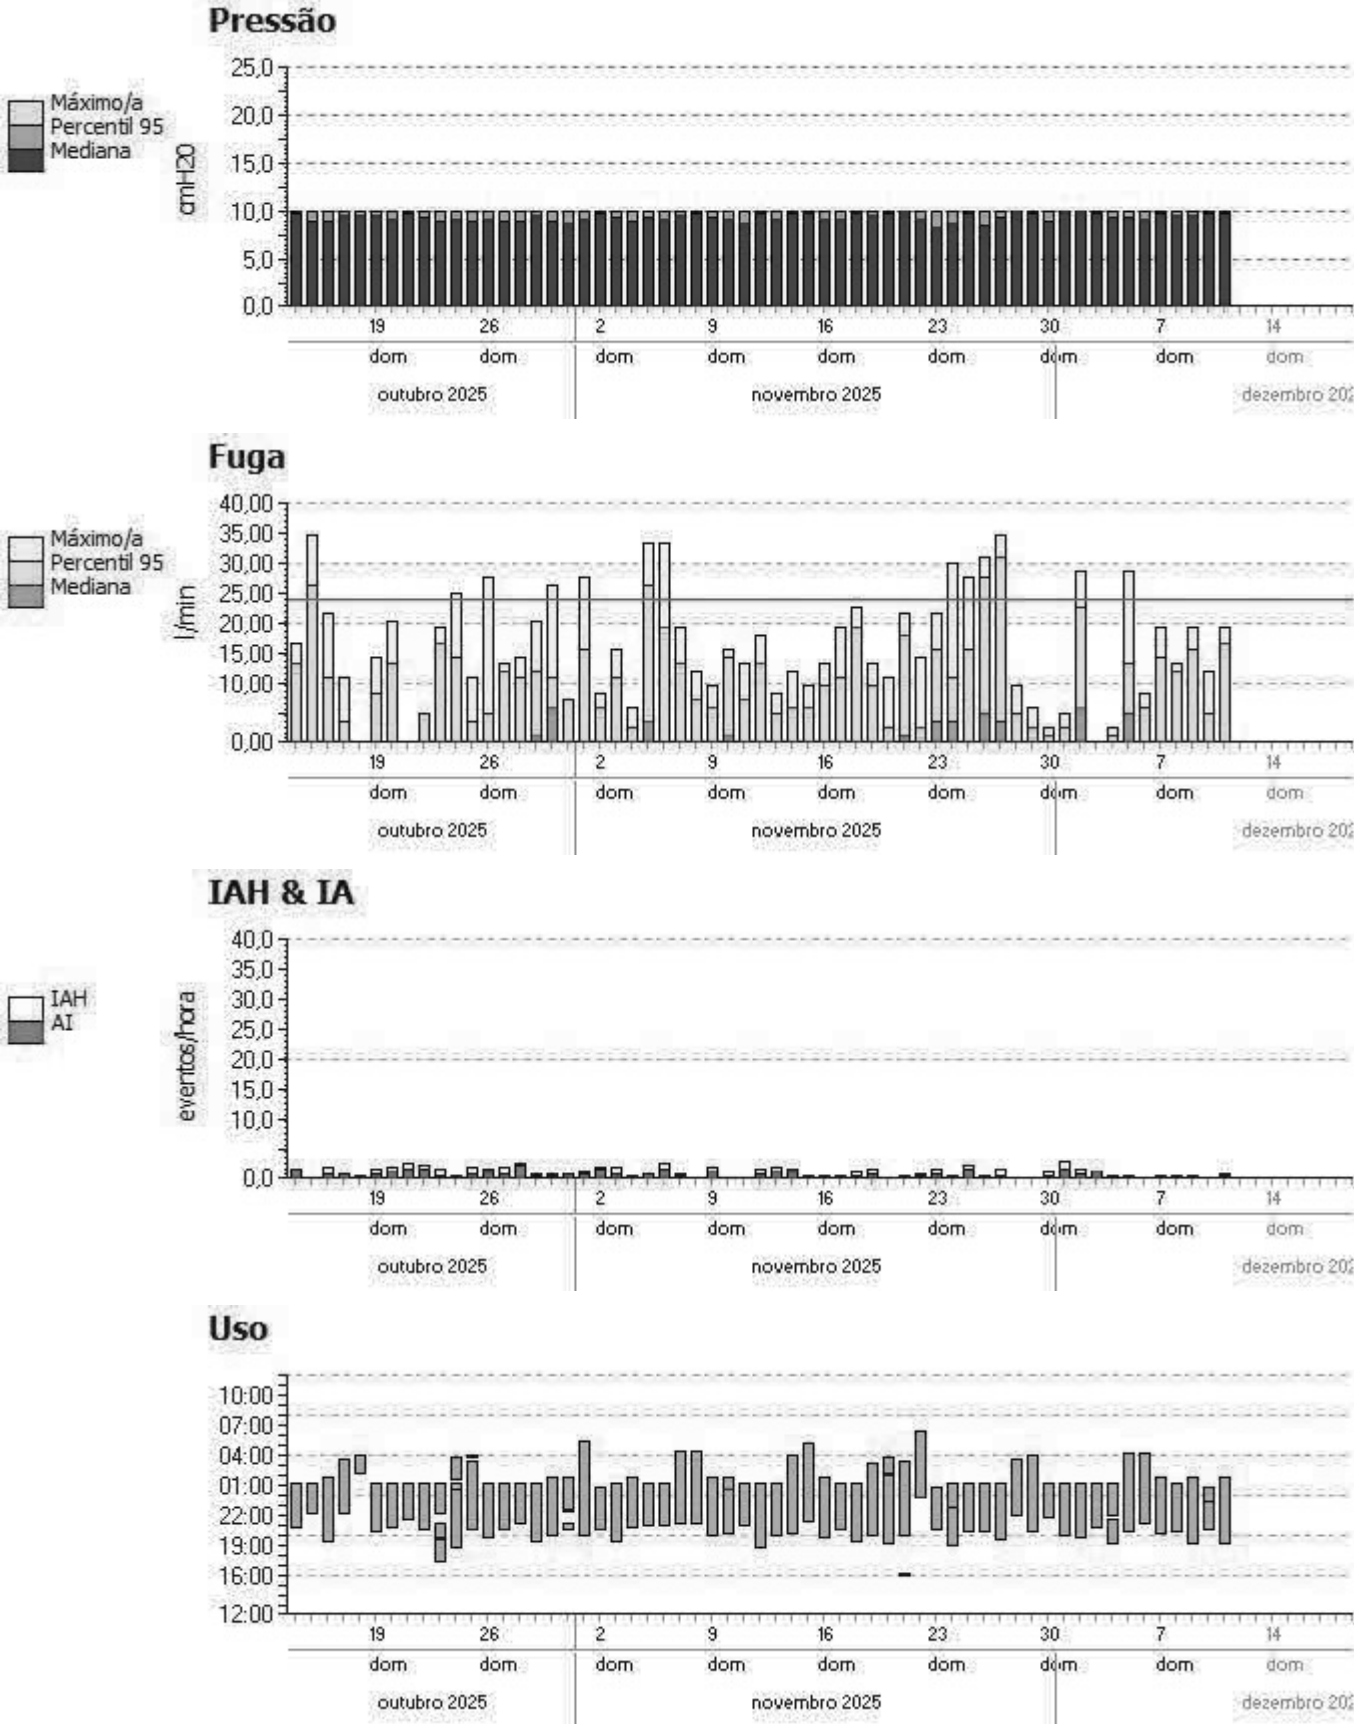

Utilização total e Cheyne-Stokes

