

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. STEPHANIE MENEZES HENRIQUE**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **10 outubro 1990** Idade: **35**
Sexo:

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **12/12/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas


12/11/2025 - 11/12/2025		Dispositivo: S9 Elite (S/N: 22121641539)	
Parâmetros do dispositivo			
Modo de terapia: CPAP	Pressão programada: 11,4 cmH2O	APE: RAMP_ONLY	
Nível APE: 1,0 cmH2O			
Fuga - l/min			
Mediana: 0,0	Percentil 95: 0,0	Máximo/a: 9,0	
Índices respiratórios - eventos/hora			
Índice de apneia: 0,5	Índice de hipopneia: 0,1	AHI: 0,5	
Obstrutiva: 0,3	Central: 0,0	Desconhecida: 0,0	
Utilização Total			
Dias de Uso >= 4 horas : 30	Dias de Uso < 4 horas : 0	% Dias de Uso >= 4 horas : 100	
Dias de não utilização: 0	Totalidade de dias: 30	Horas de utilização: 238:18	
Mediana do uso diário: 7:57	Média de uso diário: 7:56		

Gráficos em sumário


12/11/2025 - 11/12/2025

Dispositivo: S9 Elite (S/N: 22121641539)


Pressão

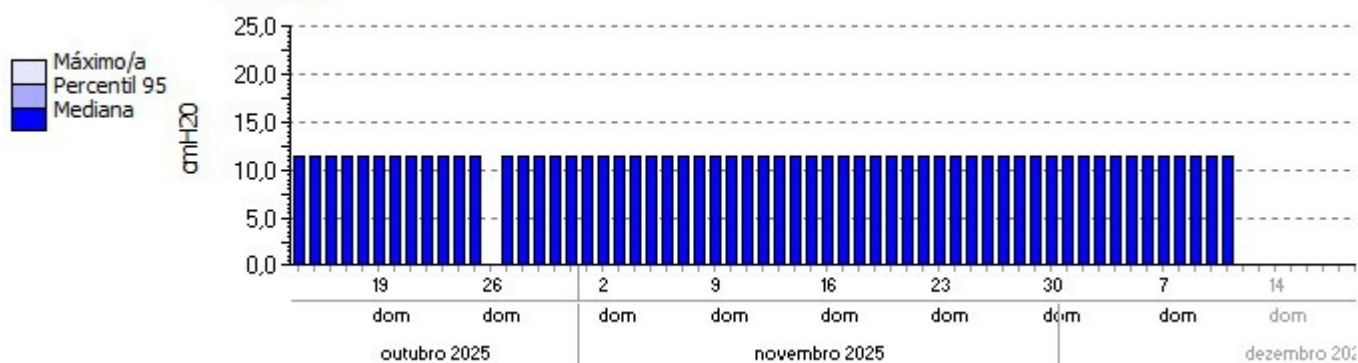

Fuga

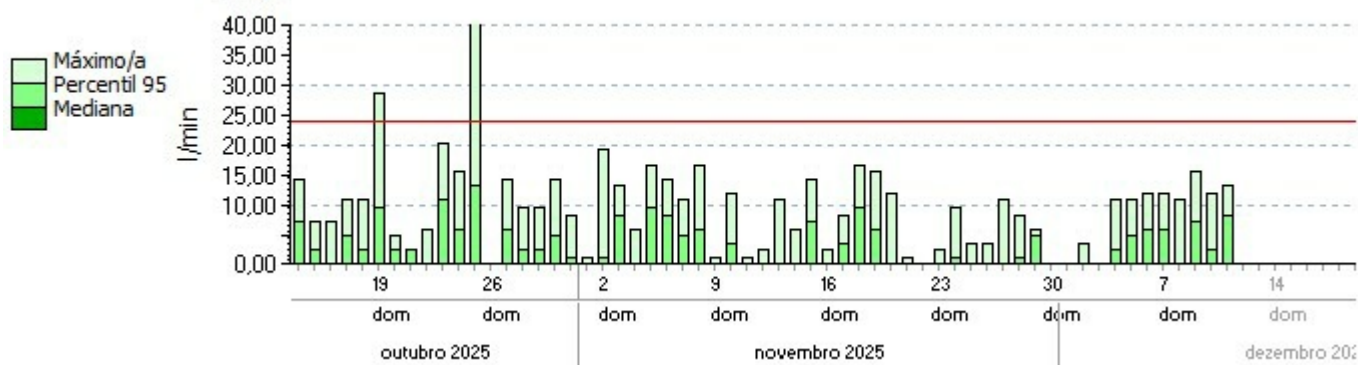

IAH & IA

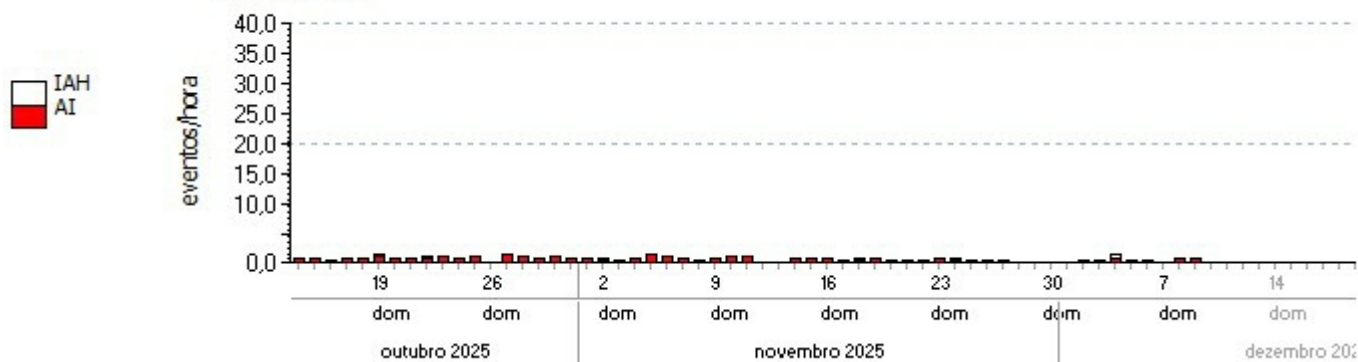

Uso

