

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. SILVIO DA COSTA**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **31 março 1969** Idade: **56**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **07/01/2026**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados:	Não	

Estatísticas

08/12/2025 - 06/01/2026		Dispositivo: AirSense 10 Elite (S/N: 22191471246)	
Parâmetros do dispositivo			
Modo de terapia: CPAP	Pressão programada: 6,0 cmH20	APE: RAMP_ONLY	
Nível APE: 1,0 cmH20	Activar APE: ON	Activação paciente APE: ON	
Activação subida: ON	Tempo de rampa: 5,0 Minutos	Acesso: LIGADO	
Fuga - l/min			
Mediana: 0,0	Percentil 95: 13,2	Máximo/a: 20,4	
Índices respiratórios - eventos/hora			
Índice de apneia: 0,2	Índice de hipopneia: 1,4	AHI: 1,6	
Obstrutiva: 0,1	Central: 0,0	Desconhecida: 0,0	
Índice RERA: 0,5	% tempo em CSR: 0,0		
Utilização Total			
Dias de Uso >= 4 horas : 29	Dias de Uso < 4 horas : 0	% Dias de Uso >= 4 horas : 96	
Dias de não utilização: 1	Totalidade de dias: 30	Horas de utilização: 195:38	
Mediana do uso diário: 6:57	Média de uso diário: 6:31		


Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário


08/12/2025 - 06/01/2026

Dispositivo: AirSense 10 Elite (S/N: 22191471246)


Pressão

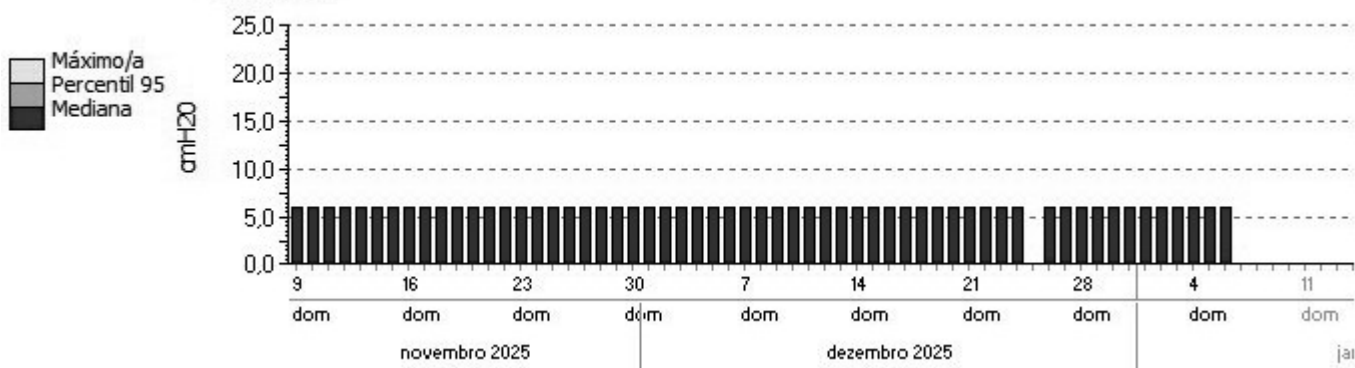

Fuga

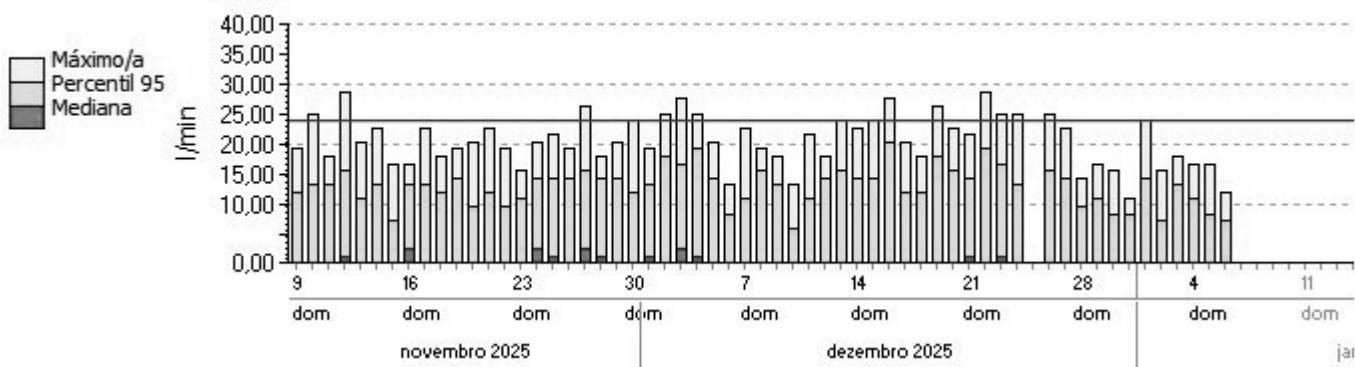

IAH & IA

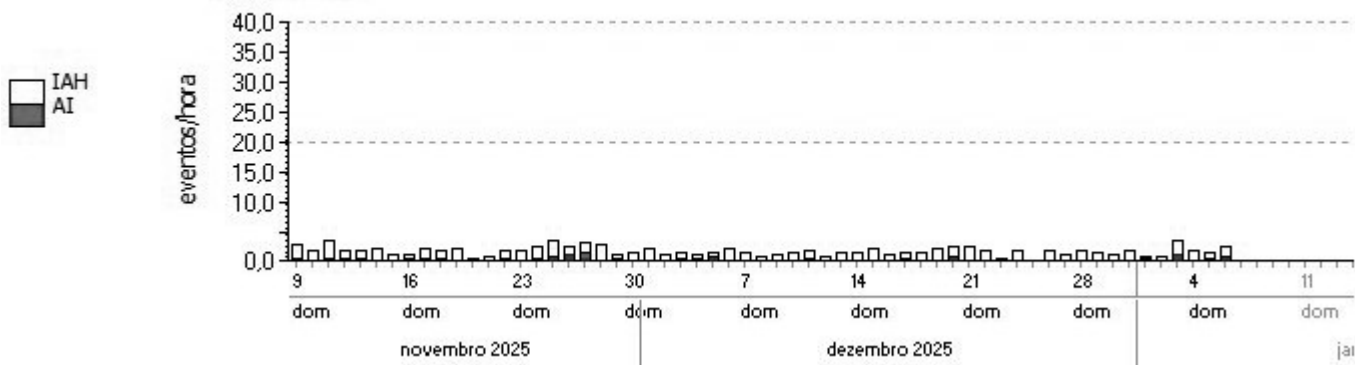

Uso

