


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		20/12/2025 - 27/12/2025
Dias de utilização		7/8 dias (88%)
>= 4 horas		7 dias (88%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		49 horas 57 minutos
Utilização média (total de dias)		6 horas 15 minutos
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 8 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 30 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/12/2025)		832 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22242260594
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.5	Percentil 95.º: 8.0	Máximo: 8.8	
Fugas — l/min	Mediana: 6.9	Percentil 95.º: 12.3	Máximo: 16.8	
Eventos por hora	IA: 1.1	IH: 0.2	IAH: 1.3	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.1
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

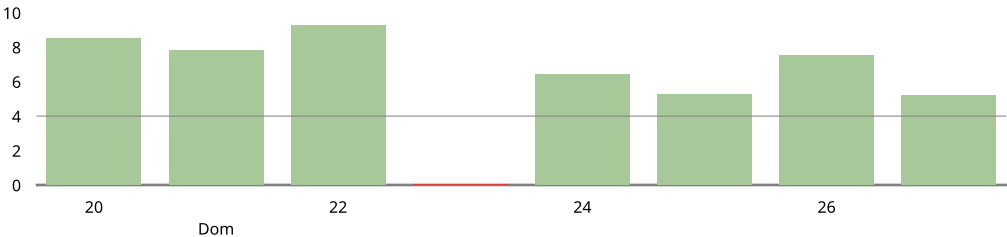


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22242260594


Utilização (horas)

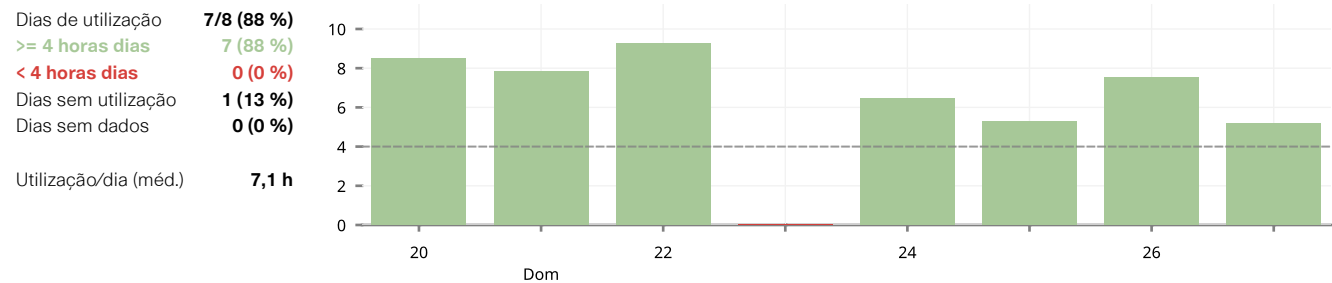

Fuga (l/min)

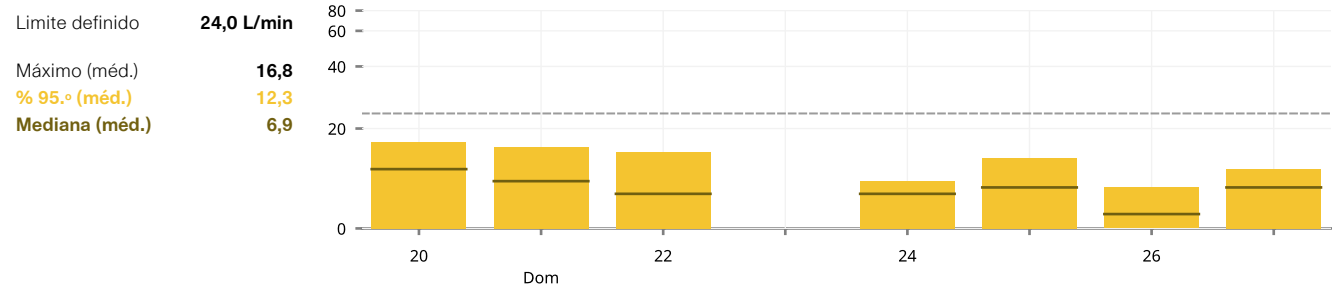

Pressão (cmH2O)

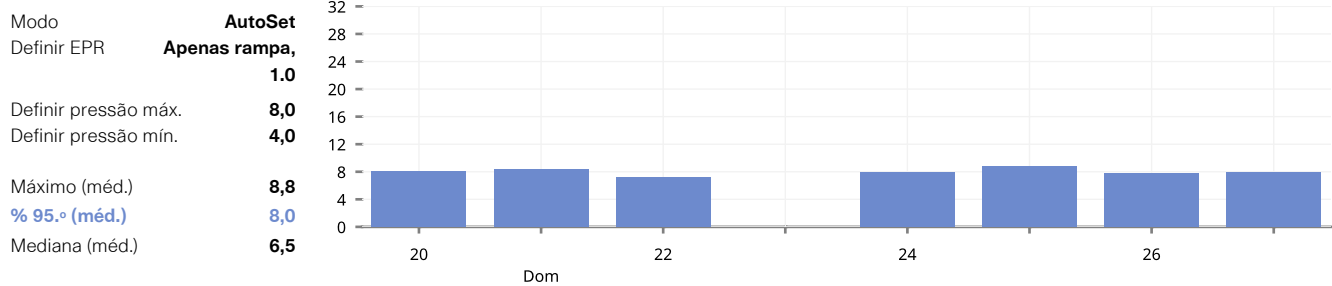

IAH (eventos/hora)

