


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		29/12/2025 - 08/01/2026
Dias de utilização	6/11 dias (55%)	
>= 4 horas	2 dias (18%)	
< 4 horas	4 dias (36%)	
Horas de utilização	19 horas 20 minutos	
Utilização média (total de dias)	1 horas 45 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 13 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 35 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/01/2026)	3,957 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292573
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.1	Percentil 95.º: 6.9	Máximo: 7.2	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 8.2	Máximo: 21.4	
Eventos por hora	IA: 3.5	IH: 0.4	IAH: 3.9	
Índice de apneia	Central: 2.8	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.2
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

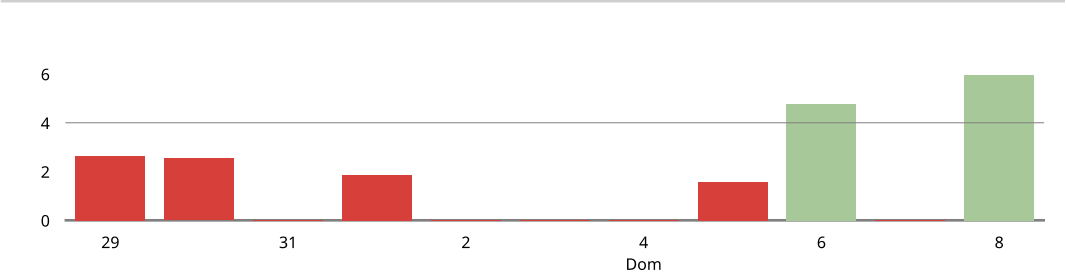


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292573


Utilização (horas)

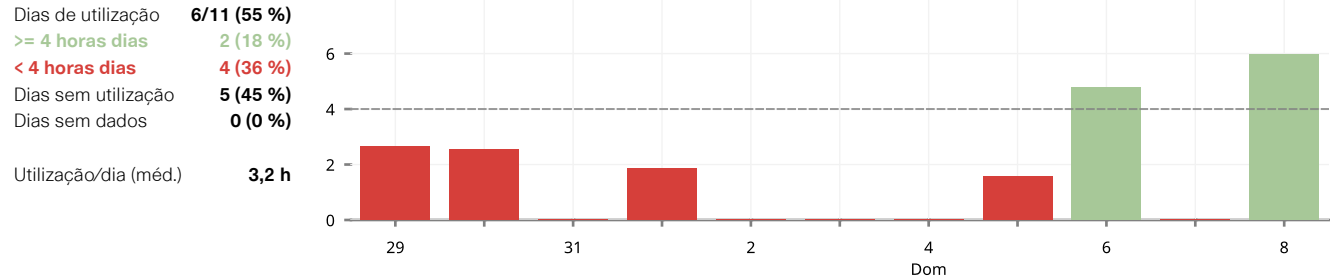

Fuga (l/min)

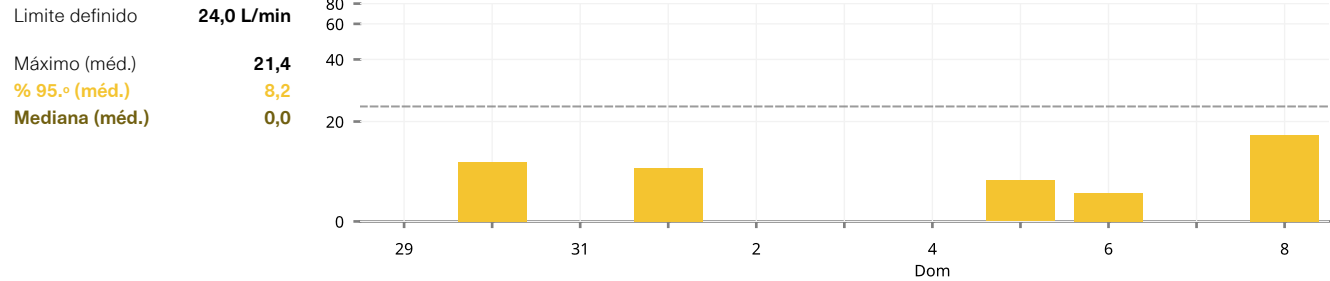

Pressão (cmH2O)

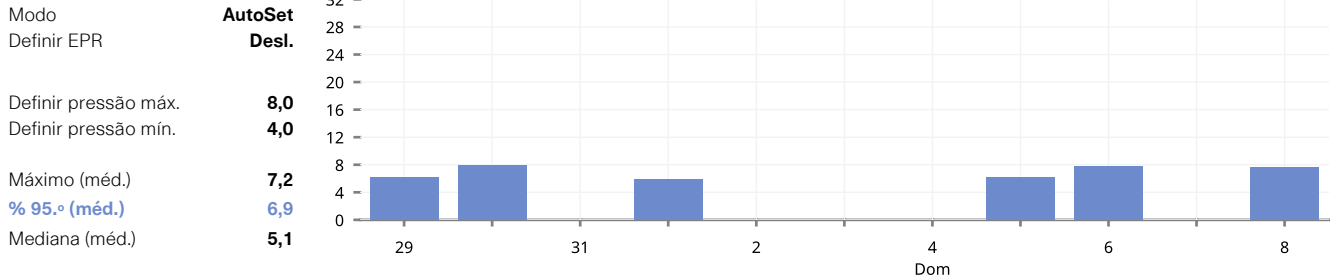

IAH (eventos/hora)

