


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		29/12/2025 - 14/01/2026
Dias de utilização	12/17 dias (71%)	
>= 4 horas	4 dias (24%)	
< 4 horas	8 dias (47%)	
Horas de utilização	41 horas 3 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 25 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 25 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 55 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/01/2026)	3,979 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292573
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	5.3	Percentil 95.º:	7.1	Máximo:	7.5
Fugas — l/min	Mediana:	0.0	Percentil 95.º:	6.7	Máximo:	34.5
Eventos por hora	IA:	3.4	IH:	0.5	IAH:	3.9
Índice de apneia	Central:	2.3	Obstrutiva:	0.4	Desconhecid	0.6
Índice RERA						0.1
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização

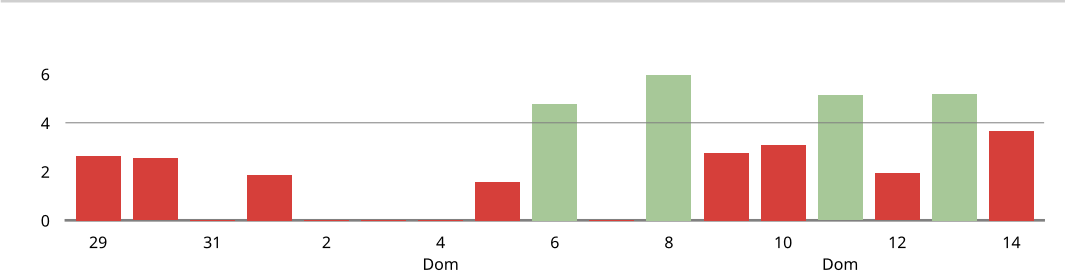

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292573

Utilização (horas)


Dias de utilização **12/17 (71 %)**
>= 4 horas dias **4 (24 %)**
< 4 horas dias **8 (47 %)**
Dias sem utilização **5 (29 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **3,4 h**

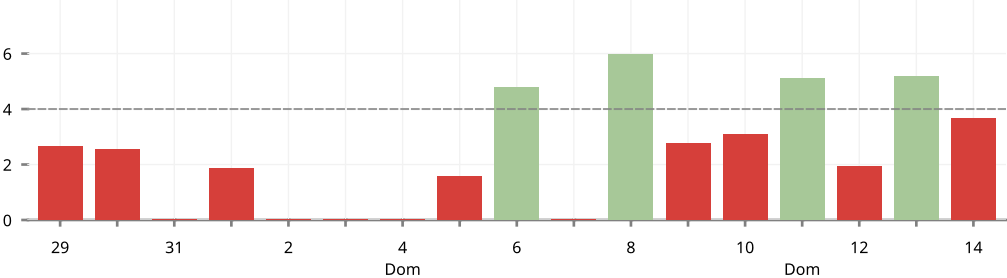

Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **34,5**
% 95.º (méd.) **6,7**
Mediana (méd.) **0,0**

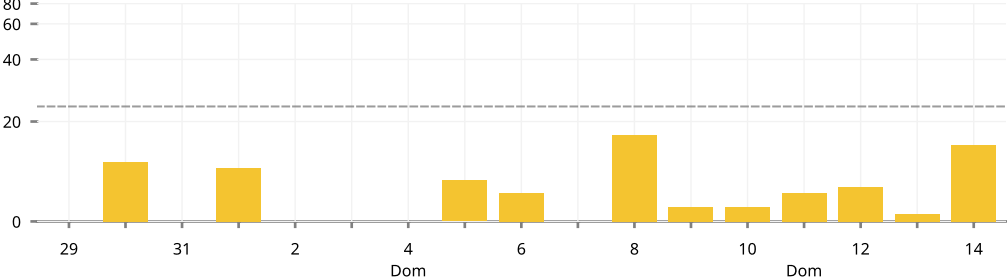


Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Desl.**

Definir pressão máx. **8,0**
Definir pressão mín. **4,0**

Máximo (méd.) **7,5**
% 95.º (méd.) **7,1**
Mediana (méd.) **5,3**

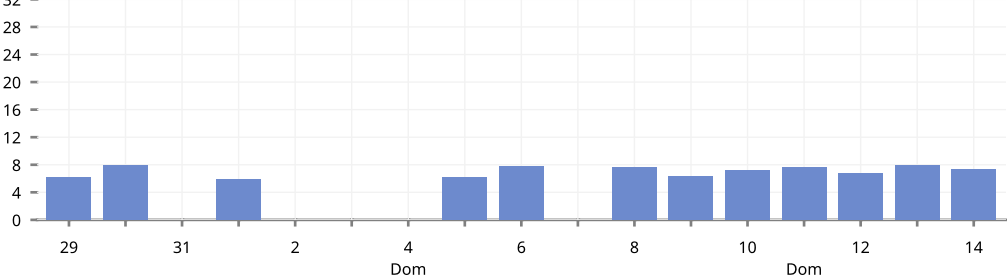

IAH (eventos/hora)

IAH **3.9**
IH **0.5**
IA **3.4**
IAC **2.3**
IAO **0.4**
IAD **0.6**
RERA **0.1**
%RCS (méd.) **0.0**

