


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/01/2026 - 21/01/2026
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	4 dias (57%)	
< 4 horas	3 dias (43%)	
Horas de utilização	36 horas 36 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 14 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 14 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 8 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/01/2026)	4,015 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292573
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	6 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.6	Percentil 95.º: 5.9	Máximo: 6.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 6.9	Máximo: 42.3	
Eventos por hora	IA: 2.5	IH: 0.5	IAH: 3.0	
Índice de apneia	Central: 1.3	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	0.5
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

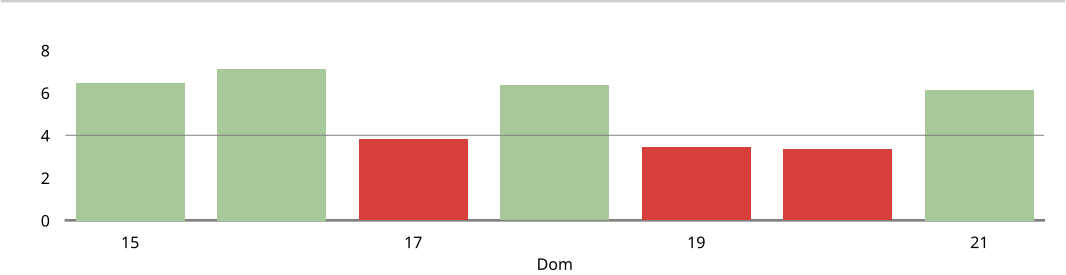


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292573


Utilização (horas)

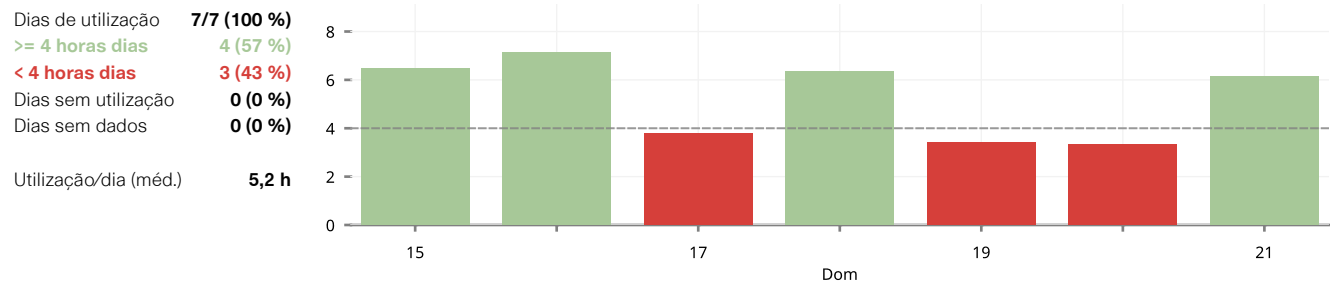

Fuga (l/min)

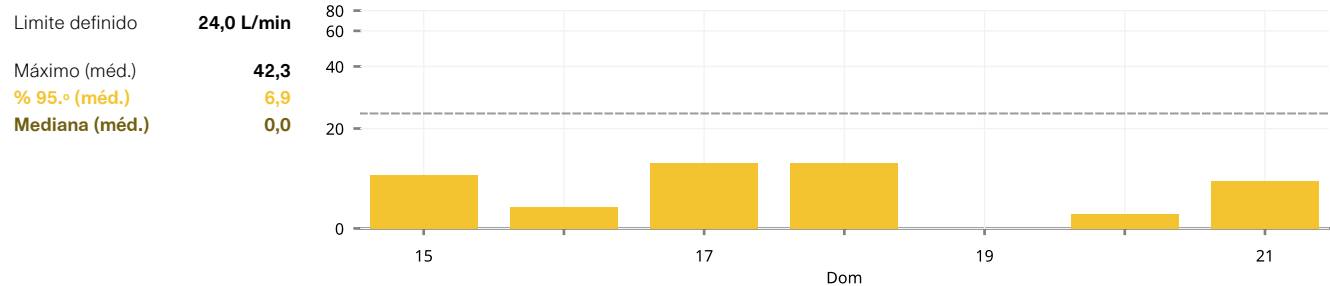

Pressão (cmH2O)

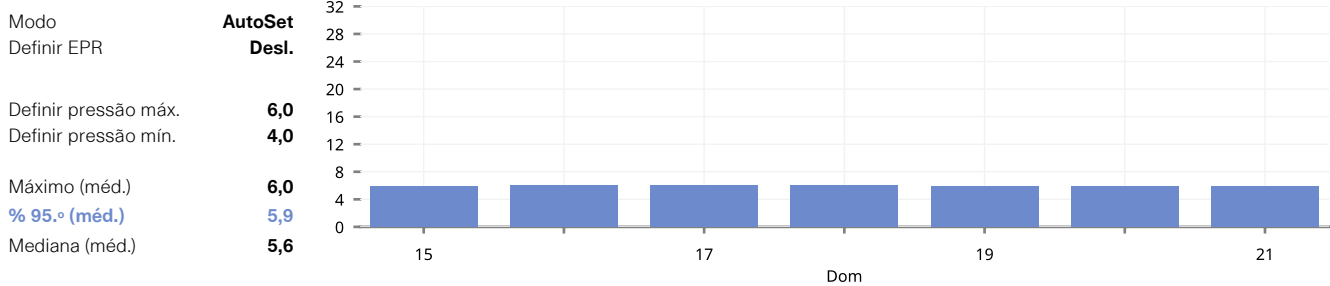

IAH (eventos/hora)

