

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sra. IZABEL DAS DORES DE SOUZA**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **25 maio 1962** Idade: **63**
Sexo: **Feminino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **22/12/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

22/12/2025 - 25/12/2025 Dispositivo: AirSense 10 AutoSet For Her (S/N: 22191726661)

Parâmetros do dispositivo		
Modo de terapia: AutoSet For Her	APE: RAMP_ONLY	Nível APE: 1,0 cmH20
Activar APE: ON	Activação paciente APE: ON	Activação subida: OFF
Tempo de rampa: 5,0 Minutos	Acesso: LIGADO	Pressão mínima: 7,0 cmH20
Pressão máxima: 12,0 cmH20		
Pressão - cmH20		
Mediana: 7,2	Percentil 95: 7,6	Máximo/a: 7,7
Fuga - l/min		
Mediana: 41,4	Percentil 95: 57,6	Máximo/a: 63,0
Índices respiratórios - eventos/hora		
Índice de apneia: 2,6	Índice de hipopneia: 0,2	AHI: 2,8
Obstrutiva: 0,0	Central: 0,8	Desconhecida: 1,2
Índice RERA: 0,0	% tempo em CSR: 0,0	
Utilização Total		
Dias de Uso >= 4 horas : 0	Dias de Uso < 4 horas : 4	% Dias de Uso >= 4 horas : 0
Dias de não utilização: 0	Totalidade de dias: 4	Horas de utilização: 11:02
Mediana do uso diário: 3:05	Média de uso diário: 2:45	


Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário


22/12/2025 - 25/12/2025

Dispositivo: AirSense 10 AutoSet For Her (S/N: 22191726661)


Pressão

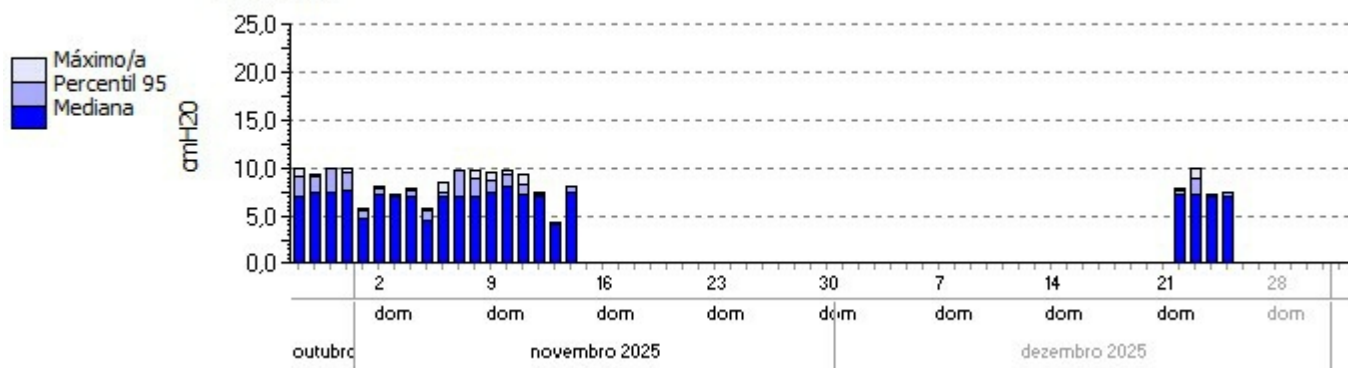


Fuga

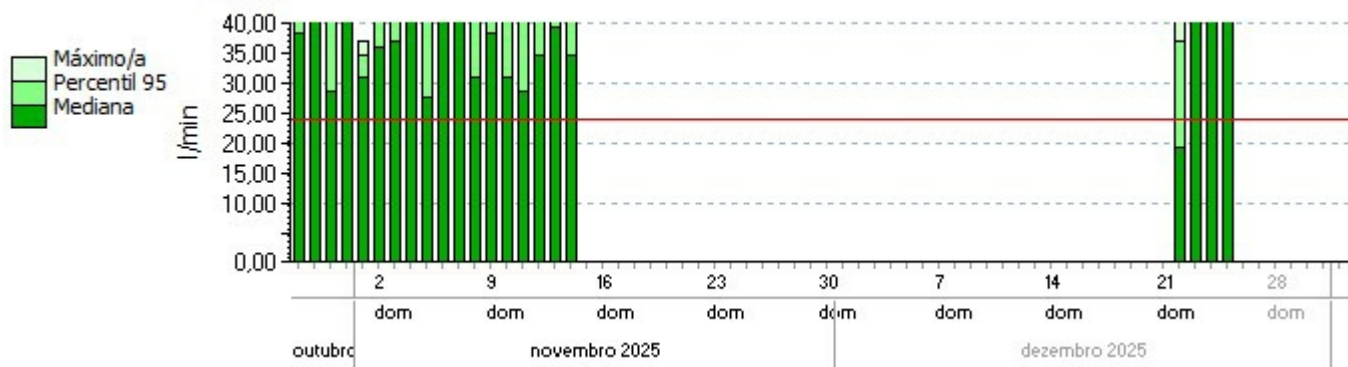

IAH & IA

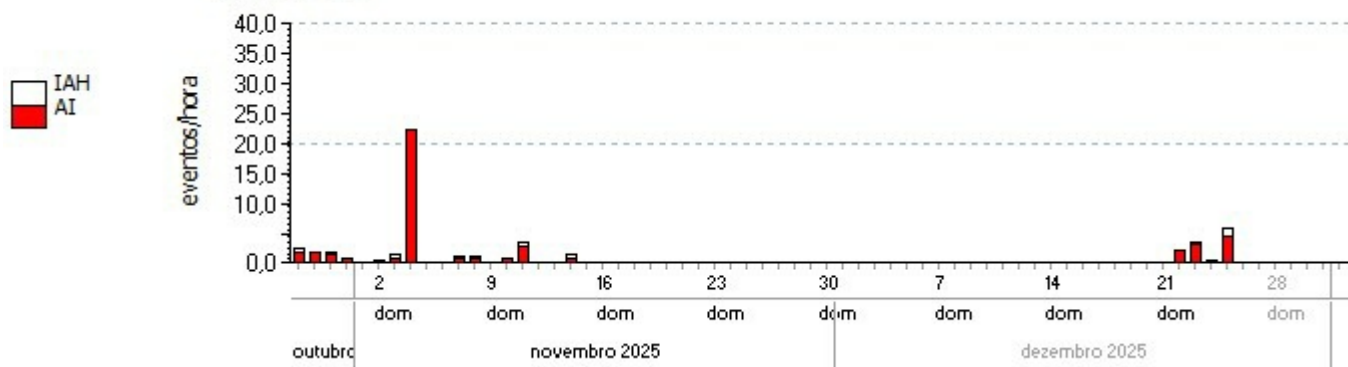

Uso

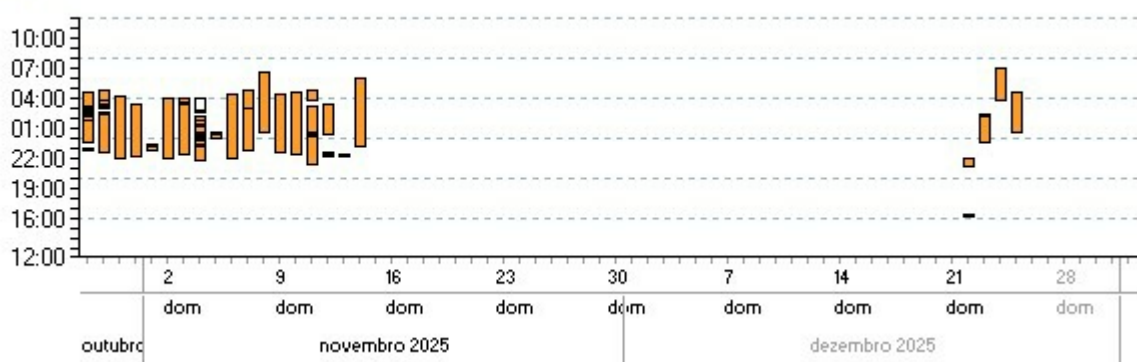

Utilização total e Cheyne-Stokes

