


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		30/12/2025 - 04/01/2026
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	46 horas 59 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 50 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 50 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 21 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/01/2026)	6,060 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221837381
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.2	Percentil 95.º: 9.8	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 1.8	Percentil 95.º: 16.8	Máximo: 36.8	
Eventos por hora	IA: 1.9	IH: 0.4	IAH: 2.3	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 1.7	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

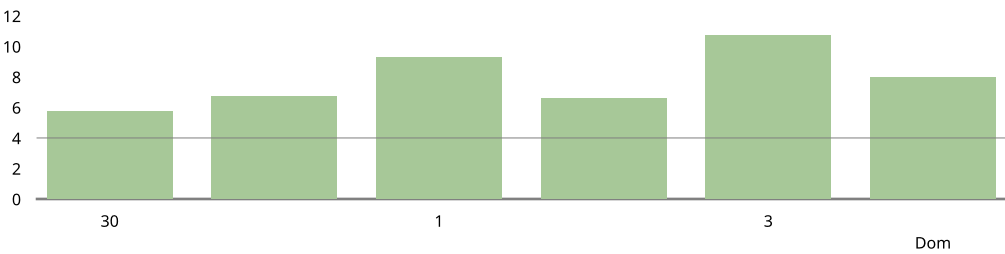


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221837381


Utilização (horas)

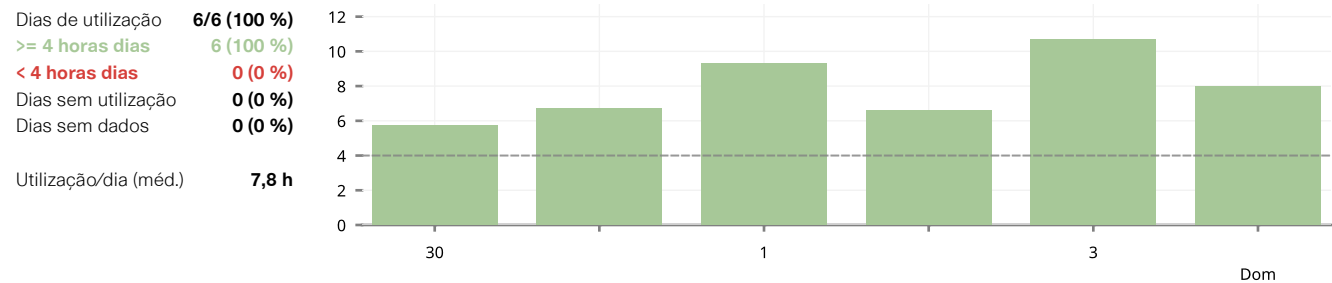

Fuga (l/min)

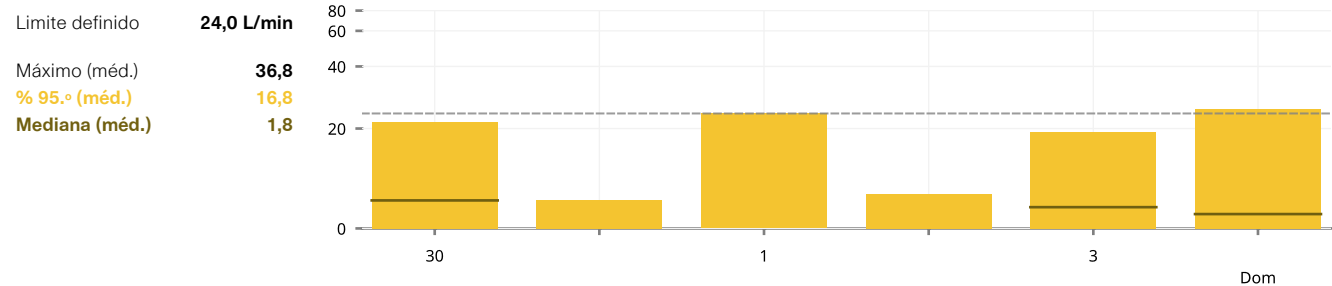

Pressão (cmH2O)

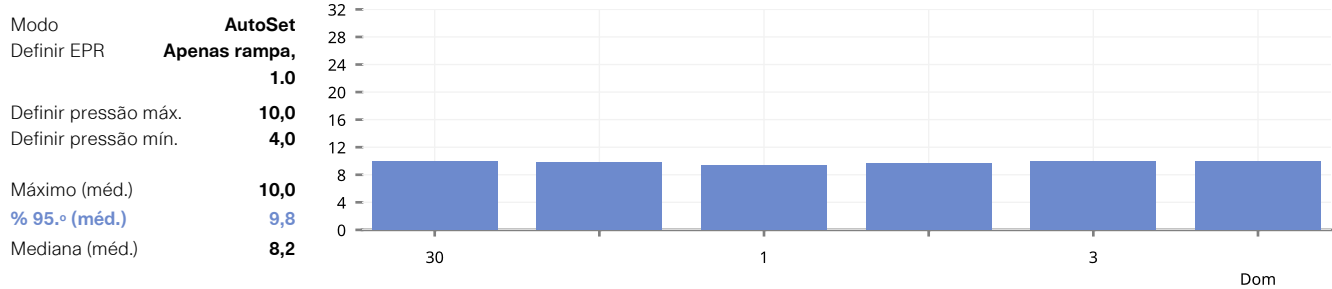

IAH (eventos/hora)

